

**ANALISE TÉCNICA - PROCESSO LICITATÓRIO nº 067/2025 – PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 048/2025- EDITAL Nº 054/2025**

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA E FOCO CIRURGICO DE TETO COM CAMERA (RESOLUÇÃO SESNº8.904) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GILALVES NO MUNICÍPIO DE BOCAIUVA-MG.

Em atenção à proposta enviada pela empresa **MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**, segue análise técnica:

**EQUIPAMENTO OFERTADO: FOCO CIRURGICO DE TETO COM
CAMERA- MODELO OFERTADO: FL-2000 TL:**

Edital solicita: A PROFUNDIDADE DE CAMPO (L1 + L2) SEJA NO MÍNIMO 105CM,


Conforme a página 21 do manual Anvisa, a profundidade da iluminação do foco FL-2000 TL é 507mm, ficando claro o não atendimento da solicitação em edital

Profundidade da iluminação (L1 + L2) 60%	507 mm
--	--------

Edital solicita: DILUIÇÃO DE SOMBRAS, ATINGINDO NO MÍNIMO 60% COM UMA MÁSCARA E 55% COM DUAS MÁSCARAS.

Conforme a página 21 do manual Anvisa, a diluição de sombras do foco FL-2000 TL com uma máscara é 58% e com duas mascara 52%, ficando claro o não atendimento da solicitação em edital

Iluminância remanescente com obstrução de uma máscara	58% de Ec
Iluminância remanescente com obstrução de duas máscaras	52% de Ec

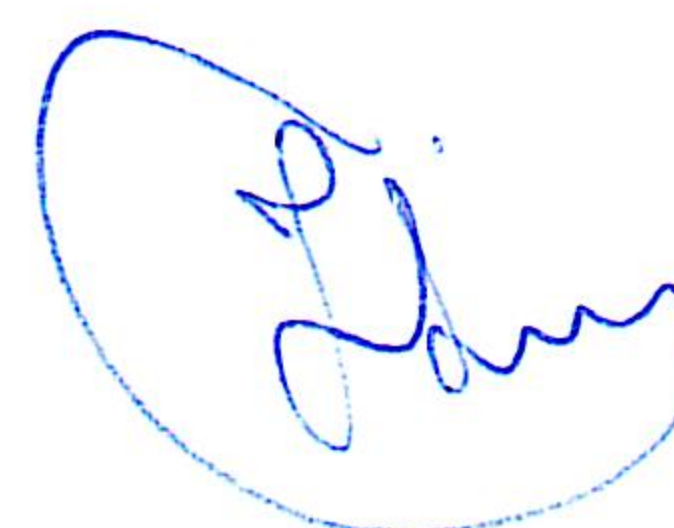

Neste sentido, o equipamento ofertado não atende as especificações do edital.

Bocaiúva, 08 de agosto de 2025.



José Hélio Leite

Diretor Executivo

Portaria 11/2025

Hospital Municipal Dr. Gil Alves

Bocaiúva-MG

José Hélio Leite
Diretor Executivo

