

**ANALISE TÉCNICA - PROCESSO LICITATÓRIO nº 067/2025 – PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 048/2025- EDITAL Nº 054/2025**

OBJETO:


REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA E FOCO CIRURGICO DE TETO COM CAMERA (RESOLUÇÃO SESNº8.904) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GILALVES NO MUNICÍPIO DE BOCAIUVA-MG.

Em atenção à proposta enviada pela empresa **RJN COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA**, segue análise técnica:

EQUIPAMENTO OFERTADO: FOCO CIRURGICO DE TETO COM CAMERA- MODELO OFERTADO: SKYLED 160/160:

Edital solicita: 5 MODOS DE LUMINOSIDADE CIRÚRGICA.

Conforme a página 53 e 54 do manual Anvisa, o foco **SKYLED 160/160** possui modo Endo, ficando claro o não atendimento da solicitação em edital.

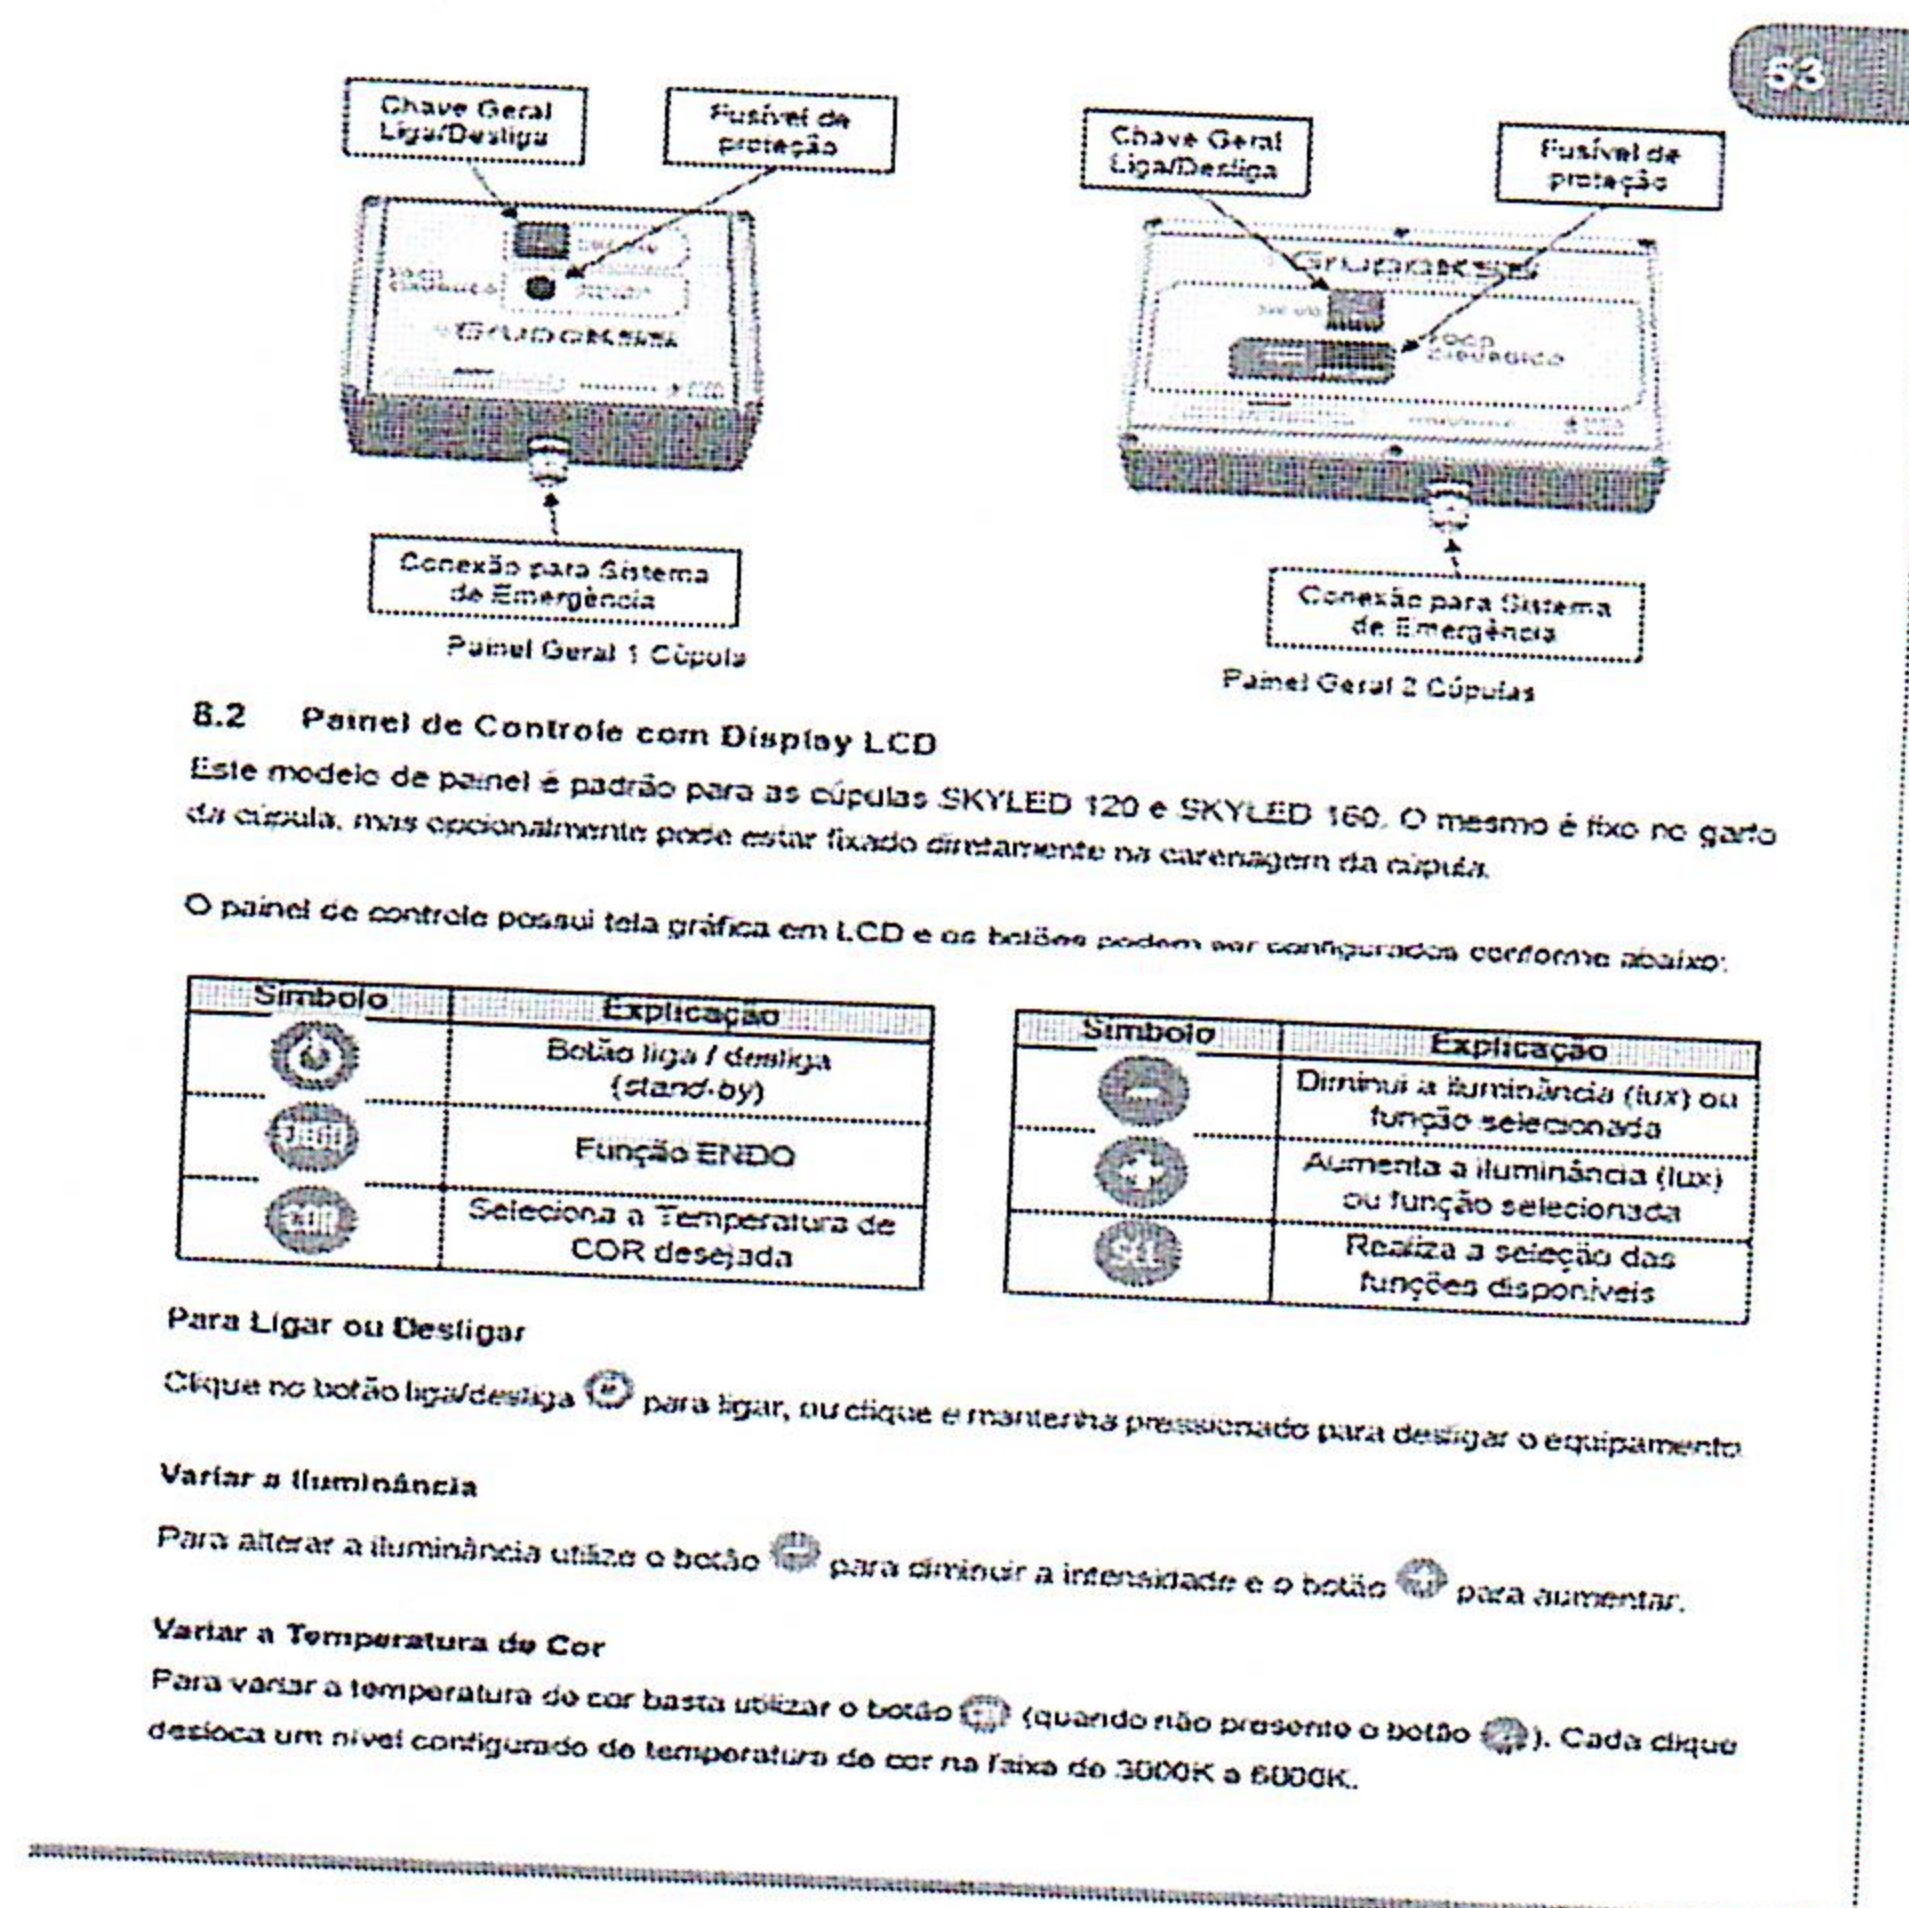

Função Selecionar: Variar Iluminância, Temperatura de Cor e Diâmetro do Campo Luminoso
Selecionar a função desejada até que a mesma fique destacada clicando no botão caso presente no modelo utilizado. Para alterar os valores utilize o botão para diminuir e o botão para aumentar.


Modo ENDO

Para ativar o modo ENDO basta clicar no botão . Neste modo a cúpula irá ligar com pequena intensidade de luz. Como função opcional, pode ser ajustada utilizando o botão para diminuir e o botão para aumentar seu nível de intensidade de 100 a 8000 lux. Para desativar basta pressionar o botão novamente.

Edital solicita: TELA TOUCH PARA AJUSTE DO FOCO.

Conforme informação no site, o painel de controle do foco **SKYLED 160+160** é estilo teclado de membrana, ficando claro o não atendimento da solicitação em edital.

<https://grupokss.com.br/produto/foco-cirurgico-skyled-de-teto-dois-bracos-160-160-160000>

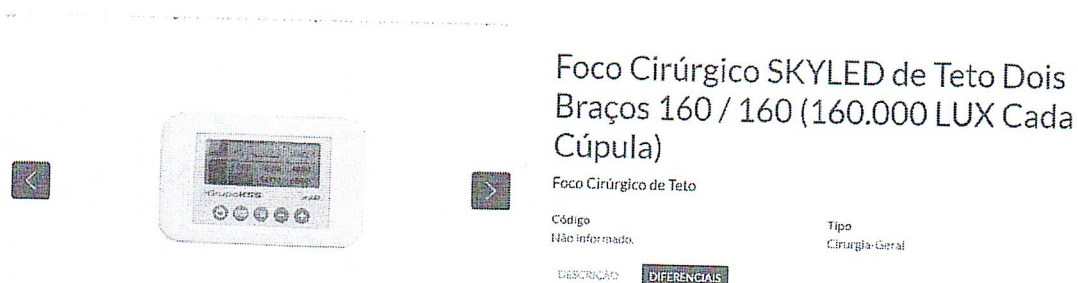

Edital solicita: DILUIÇÃO DE SOMBRAS, ATINGINDO NO MÍNIMO 55% COM DUAS MÁSCARAS.

Conforme a página 18 do manual Anvisa, a diluição de sombras do foco **SKYLED 160+160** com duas mascara 46%, ficando claro o não atendimento da solicitação em edital.

Diluição de Sombra	SKYLED 65	SKYLED 120	SKYLED 160	TOLERÂNCIA
Com uma máscara	0%	18%	78%	±10%
Com duas máscaras	62%	43%	46%	±10%
Na base do tubo	100%	100%	100%	±10%
Na base do tubo com uma máscara	0%	18%	78%	±10%
Na base do tubo com duas máscaras	62%	43%	46%	±10%

Edital solicita: REPRODUÇÃO DE CORES R9 E RA IGUAIS OU SUPERIORES A 97.

Conforme a página 18 do manual Anvisa, a reprodução de cores do foco **SKYLED 160+160** é RA é 96 e R9 97, ficando claro o não atendimento da solicitação em edital.

Neste sentido, o equipamento ofertado não atende as especificações do edital.

Bocaiúva, 14 de agosto de 2025.


José Hélio Leite
Diretor Executivo
Portaria 11/2025
~~Hospital Municipal Dr. Gil Alves~~
~~Bocaiúva-MG~~
José Hélio Leite
Diretor Executivo