



Secretaria da Saúde

Of. nº. 162/2024-SEAFI

Fortaleza-CE, 19 de janeiro de 2024


Ilm^ª. Sr. (a)
Carlos Alberto Coelho Leitão
Pregoeiro (a) da Procuradoria-Geral do Estado
Centro Administrativo Bárbara de Alencar
Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 – Edson Queiroz
60811-500 – Fortaleza/CE

Assunto: Pregão 20231521

Senhor (a) Pregoeiro (a),


Atendendo solicitação de V.S^ª, formulada por meio do e-mail da Central de Licitações, encaminho anexo, Parecer Técnico conclusivo, atinente ao Pregão Eletrônico Registro de Preços – nº 20231521.

Atenciosamente,


Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
Secretário-Executivo Administrativo – Financeiro



Recebido em
25:45h
79/01/2024
CM
Carlos Alberto Coelho Leitão
Central de Licitações
PREGÃO

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Saúde	PARECER TÉCNICO Nº 3529/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1521/2023 PROCESSO Nº 05480290/2023 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 5913/2023 DATA: 18/01/2024



ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA- OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 5913/2023			
Item	Código	Quant.	Especificação
02	676180	460	FIO GUIA HIDROFÍLICO, TIPO SUPER STIFF, DIÂMETRO 0,035, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL OU NITINOL, FORMATO PONTA CURVA, COMPRIMENTO DE 260 CM A 300 CM, ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVIOVÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. DISPONIBILIZAR ETIQUETA DE RASTREABILIDADE
Empresa: SELLMED			
Marca: ACCOAT		Referência:	
Fabricante: SP MEDICAL		Registro da Anvisa: 80152120013	

CONCLUSÃO	
() FAVORÁVEL	(X) DESFAVORÁVEL
Justificativa: Item não aceito. A amostra não foi entregue em tempo hábil, conforme estabelecido na cláusula editalícia. 4.2. DAS AMOSTRAS: 4.2.1. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra, no prazo de cinco (05) dias, contados a partir do recebimento da solicitação do órgão demandante da licitação, na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, situada na Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema - CEP: 60.060-440 - Fortaleza/Ceará, Telefone (85)3101.5197 (CECOM), no horário de 8:00 às 11:00 e de 14h00 às 17h00 (horário local), de segunda a sexta-feira, para ser realizada inspeção técnica. 4.2.1.1. É facultada a prorrogação do prazo acima estabelecido, desde que solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito pelo contratante. 4.2.2. Quando as amostras não forem entregues no prazo acima estabelecido, a licitante deverá enviar para o endereço eletrônico institucional (propostasmmh@gmail.com), o qual a amostra foi solicitada, o comprovante do envio (ex. código de rastreamento) referente ao envio da citada amostra. Declaramos, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal no 12.813/2013.	

Elaborado por:  Emannuella Arruda Rangel ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 479.070 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras	Elaborado por:  Raquel Fernandes Alves de Almeida ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 550963 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras
Elaborado por:  Alcyone Maria Nascimento da Silva ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 271273 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras	Elaborado por:  Licia Silva Teixeira ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 488.884 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras

Check list Análise de parecer técnico - Lei 14.133/2021

A licitante deverá anexar no sistema junto à proposta de preços:

C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
X			Nome comercial e técnico do produto;	
X			Documento ANVISA pertinente;	
X			Referência e marca do produto;	
X			Registro do produto;	
		X	Declaração de Isenção do Registro;	
X			Cadastro do produto;	
		X	Notificação simplificada;	
X			Cópia legível da publicação no Diário Oficial da União do mesmo;	
		X	Documento pertinente à ANVISA vencido ? Anexar cópia do protocolo de revalidação emitido à ANVISA, dentro do prazo previsto de 6 (seis) meses de antecedência ao vencimento;	
		X	Produto não sujeito ao Regime da Vigilância Sanitária? Apresentada Declaração formal da sua não sujeição ao Regime da Vigilância Sanitária, sob as penas cabíveis;	
		X	Diligência realizada a empresa ?	
X			Manual, catálogos figurativos ou folders do fabricante, impressos ou eletrônicos em língua portuguesa, contendo informações técnicas e instruções de uso completas dos materiais ofertados.	

LEGENDA:

C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA

Qualificação Técnica				
C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
X			Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica em nome da matriz ou da filial do licitante, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado com somatório equivalente a, no mínimo, 8% do quantitativo total por item.	
X			Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE para a(s) atividade(s) que desempenha dentro da cadeia de suprimentos para saúde	
		X	Produto importado? Acrescentado AFE de importação devendo ter sido expedida pela ANVISA nos termos do art. 50 a 52 da Lei Federal No 6.360/1976 e em conformidade com a RDC nº 16 de 1º de Abril de 2014/ANVISA - Seção III Abrangência	
X			Licença de funcionamento, emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede da licitante, de acordo com art. 51 da Lei Federal No 6.360/1976.	
LEGENDA: C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA				


Emanuella Arruda Rangel
Enfermeira
COREN-CE 479 070


Licia Silva
Enfermeira
COREN - CE 488.661


Aleyone da Silva
COREN-CE 423.545 - EMF


Paulo Roberto
Enfermeiro
COREN-CE 423.545 - EMF



Emanuella Arruda Rangel <emanuella.rangel@saude.ce.gov.br>

**SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA REFERENTE PE20231521 ITEM 2**

1 mensagem

Propostas MMH <propostas.mmh@saude.ce.gov.br>

Para: licitacao@sellmedne.com.br

Cco: propostas.mmh@saude.ce.gov.br

11 de dezembro de 2023 às 08:21

Solicitamos o envio da amostra, no prazo de 5 dias corridos, referente ao PE 20231521 ITEM 2, para darmos andamento a fase de habilitação das propostas.

A amostra deverá ser enviada para o endereço: Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, CEP 60.060-440, Município: Fortaleza - CE, no setor: CECOM, telefones: (85)3101.5197 nos horários de 08 horas às 11 horas e de 14 horas às 17 horas em dias úteis. Conforme cláusula editalícia:

4.2. Das amostras: 4.2.1. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra no prazo de 05(cinco) dia(s), contados a partir do recebimento da solicitação do órgão demandante da licitação, no endereço Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, CEP 60.060-440, Município: Fortaleza - CE, no setor: CECOM, telefones: (85)3101.5197 nos horários de 08 horas às 11 horas e de 14 horas às 17 horas em dias úteis, para que seja realizada inspeção técnica.

Parecer Técnico-MMH
COPLA/SESA

Fone: (85) 3101.5197

E-mail: propostas.mmh@saude.ce.gov.br

Secretaria da Saúde do
Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema

CEP: 60060-440 | Fortaleza/CE

Fone: (85) 3101.5123



www.saude.ce.gov.br

A
GOVERNO DO CEARÁ - SECRETARIA DA SAÚDE DO CEARÁ - CE
À Comissão Permanente de Licitação
PREGÃO ELETRONICO Nº 20231521 PROCESSO Nº 05480290/2023

segunda-feira, 6 de novembro de 2023

ABERTURA: 06/11/2023

HORA: 09:00

OBJETO: O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Material Médico Hospitalar, nas condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

2	FIO GUIA HIDROFÍLICO, TIPO SUPER STIFF, DIÂMETRO 0,035, COMPRIMENTO DE 260 CM A 300 CM.	ACCOAT	UNID	460	R\$	130,00	R\$	59.800,00
	FIO GUIA HIDROFÍLICO, TIPO SUPER STIFF, DIÂMETRO 0,035, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL OU NITINOL, FORMATO PONTA CURVA, COMPRIMENTO DE 260 CM A 300 CM. ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. COD: 676180							
REG. MS	80152120013							
VL.UNIT	CENTO E TRINTA REAIS							
VL.TOT.	CINQUENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS REAIS							

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 59.800,00

CINQUENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS REAIS

Entrega: 10 DIAS

Validade da Proposta: 90 DIAS

Pagamento: 30 DIAS

BANCO DO BRASIL AG: 8240-6 C/C: 685-8

Declaramos para os devidos fins que estamos de acordo com todas as normas e exigências contidas no edital. Declaramos que nos preços ofertados da proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas, embalagens, frete, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos e que a alíquota do ICMS é de 18%. Declaramos ainda que a validade dos produtos é de 12 meses. Informamos que de acordo com o decreto da Anvisa 3.029, 16 de Abril de 1999 (Retificado pelo DOU nº 91, de 15 de maio de 2006). Estamos impossibilitados de fracionar caixa dos medicamentos, por esse motivo atentar nas quantidades solicitadas referente com a nossa descrição das caixas.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DE CONTRATO

NOME ERICK GOMES VIEIRA DE MELO

RG 7.692.568 - SDS/PE

CPF 059.873.894-02

ESTADO CIVIL SOLTEIRO

e-mail licitacao@sellmedne.com.br

TELEFONE: (81) 3071-7903 / (81) 99162-9475

SELLMED PRODUTOS
MEDICOS E
HOSPITALARES
LTDA:3743827400017
7

Assinado de forma digital
por SELLMED PRODUTOS
MEDICOS E HOSPITALARES
LTDA:3743827400017
Dados: 2023.11.06 10:53:45
-03'00'

Erick Gomes Vieira de Melo
Representante Legal
CPF: 059.873.894-02 RG 7692568 SDS PE

SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, Av. Caxangá, 205 Madalena, Recife/PE, CEP: 50.720-000 CNP: 37.438.274/0001-77
Insc.Estadual: 0892058-39 Insc. e-mail: licitacao@sellmedne.com.br - telefone 81-3071-7903 81 9-8193-9296 (André)

INSTRUÇÃO DE USO


FIO GUIA PTFE ACCOAT

Descrição

O Fio Guia PTFE ACCOAT é constituído por um tubo de aço inox radiopaco. A ponta tem um núcleo com perfil menor que o do corpo e é recoberta com um arame muito fino em formato de mola, com vários graus de flexibilidade, podendo ser ajustada pelo médico a formatos mais ou menos curvos.

O Fio Guia é recoberto com politetrafluoretileno (PTFE) para melhor lubricidade. Essas características construtivas dão ao fio guia condições de boa orientação mesmo em vasos tortuosos, visibilidade na radioscopia de todo o corpo e mais brilhante na ponta distal, resposta segura aos movimentos orientados feitos pelo médico, mobilidades sem atritos ou fricção no cateter ou vasos.

Esterilizado a óxido de etileno – validade da esterilização é de 5 anos a partir da data de esterilização

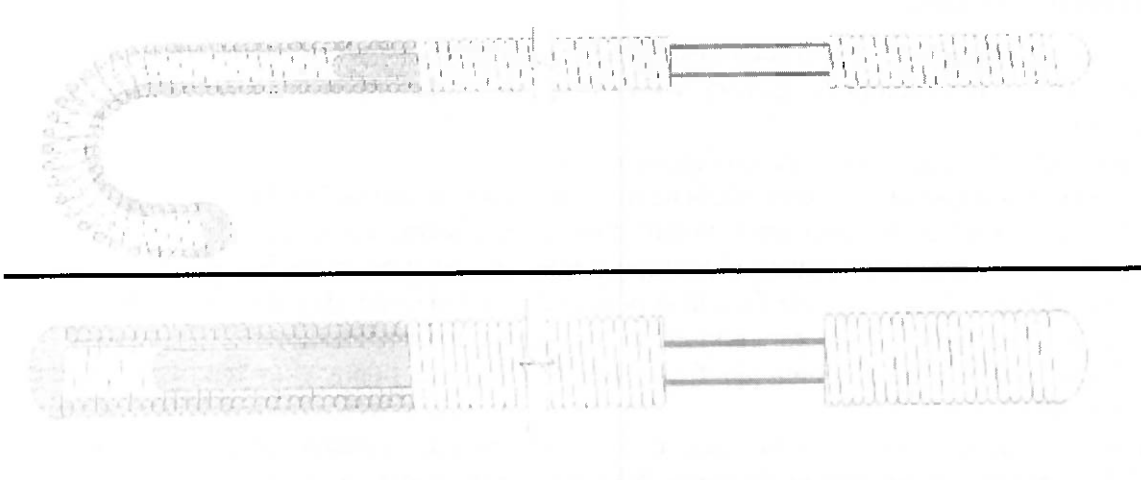

Características:

Ponteira formatável permite adaptar o fio guia às anatomias mais tortuosas.


Excelente manobrabilidade inclusive nas anatomias mais tortuosas.

A relação perfeita entre suporte, flexibilidade e resposta ao torque.

Fabricado em aço inoxidável, AISI 304, com diâmetro que varia de 0,018 de polegadas a 0,038 polegadas, 70 cm a 450 cm de comprimento. A variação destes parâmetros está especificada na relação de modelos.

Sua ponta distal é cônica. Essa ponta apresenta o mesmo diâmetro do corpo do arame e seu comprimento pode ser de 4cm, 4,5cm, 5cm, 7cm ou 10 cm., e é maleável.

Ponta Distal em “J”

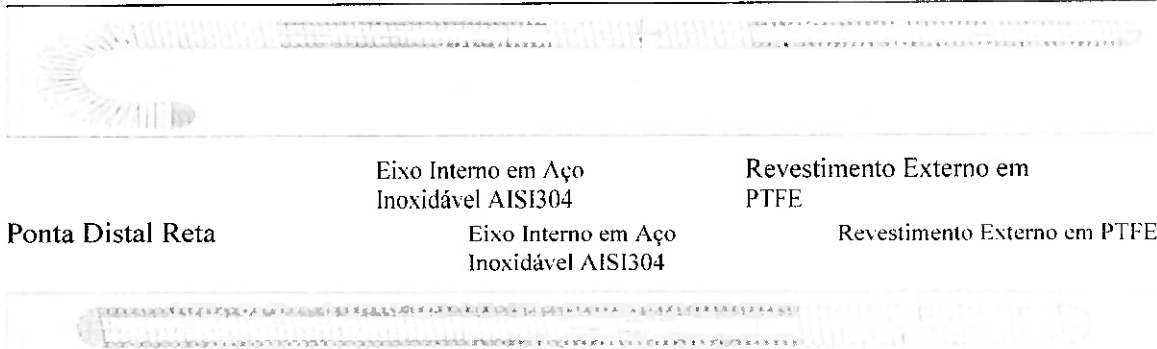

Indicação

É indicado para guiar um dispositivo de intervenção até a posição desejada durante um diagnóstico ou outro tratamento por intervenção, que necessite de acesso vascular temporário.

Forma de utilização

Antes do procedimento intervencionista, todo o equipamento a ser utilizado, incluindo o dispositivo intervencionista, deverá ser examinado cuidadosamente para verificação de defeitos.

Não utilizar qualquer equipamento defeituoso.


- Preparar o dispositivo intervencionista de acordo com as instruções do fabricante.
- Lavar o lúmen do fio guia antes de introduzir-lo no sistema vascular.
- Remover o fio guia do dispensador empurrando a seção exposta do fio para dentro do dispensador até que a ponta do fio e uma porção do núcleo saiam da extremidade do arco. Então pegar o núcleo do fio para removê-lo totalmente do dispensador.
- Evite danos à frágil ponta do fio guia. Não pegar a ponta para remover o fio do dispensador.
- Se indicado, a ponta do fio guia poderá ser moldada cuidadosamente utilizando-se práticas padrão de moldagem de ponta. Não utilizar instrumento de moldagem com ponta aguda.

Precauções

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O PRODUTO, POIS A NÃO OBSERVÂNCIA PODE PROVOCAR COMPLICAÇÕES GRAVES AO PACIENTE.

Este produto somente deverá ser utilizado por médicos experientes e familiarizados com tratamento percutâneo e técnicas de intervenção no sistema vascular periférico.

- O fabricante recomenda USO ÚNICO, não pode ser retirado do corpo e reesterilizado.
- Não utilizar se a embalagem estiver violada ou com sinais de violação.
- Não utilizar com o prazo de validade vencido.



d) Os Fios Guia PTFE Accoat não foram projetados para serem utilizados no sistema circulatório central e circulação cardíaca.

Advertências

1. Leia o Manual de Uso do dispositivo de intervenção a ser usado em conjunto e confirme a sua compatibilidade com o Fio Guia.
2. Quando retirar o Fio Guia do tubo suporte, não manuseie excessivamente nem a puxe para fora abruptamente. Confirme se há alguma anormalidade tal como dobra ou torção do Fio Guia antes do uso.
2. Preste suficiente atenção quando usar o Fio Guia prevenindo sua torção ou dobra Quando ajustar a ponta preste atenção para evitar destaque do arame mola da ponta.
3. Confirme a posição das pontas dianteira – distal – e traseira – proximal – e esteja seguro de introduzir a ponta dianteira – distal.
4. Antes do procedimento, confirme e cheque as funções de todos os dispositivos e equipamentos a serem usados. Também confirme se há algum dano no pacote e se o Fio Guia é compatível com o dispositivo intervencionista a ser usado.
5. A seção de arame em formato de bola – ponta distal – é especialmente frágil, não deve ser excessivamente torcida ou puxada. Se isto ocorre há risco de danificar o Fio Guia.
6. Quando mover ou fazer rotação com o Fio Guia no vaso sanguíneo, esteja seguro de fazê-lo apropriadamente sob radioscopia enquanto confirma o movimento e posição da ponta. Se operar o Fio Guia sem confirmação, há risco de danificar o Fio ferir o vaso sanguíneo.
7. Se alguma resistência for sentida devido quebra ou dobramento do Fio Guia, ou espasmo durante a operação no vaso sanguíneo ou sua retirada, pare a operação e aja apropriadamente sem torcer a guia e após confirmar a causa sob radioscopia. Se o Fio Guia é movido excessivamente, há o risco de dano ou ruptura, deixando a parte rompida dentro do vaso sanguíneo ou ferindo o vaso sanguíneo.
8. Não empurre demasiadamente o Fio com o propósito de penetrar a parte estreita do vaso. Mesmo após penetrar não torça, empurre ou puxe repentinamente o Fio Guia.
9. O Fio Guia tem alta força perfuradora contra tecido vascular. Não use Fio guia em lesões que são tratáveis com as guias de arame usuais.
10. Não molhe este Fio Guia usando solução orgânica como álcool.

Condições de armazenamento conservação :

O produto deve ser armazenado em local fresco e seco, ao abrigo da luz e em temperatura abaixo de 30 .C. Evite contato com a luz solar, pois pode influenciar negativamente no funcionamento do produto.

Apresentação

O produto é acondicionado em tubo plástico de polipropileno semi rígido, dispenser, montado em forma espiralada e mantido em forma circular por clips de plástico rígido. Todos estes polímeros têm composição atóxica e grau médico. Este tubo protege o Fio Guia e também permite sua introdução nos instrumentos componentes do conjunto de dilatação. Dessa forma a guia não sofre risco de dobra ou torção, o que seria possível dada a sua alta flexibilidade. Cada tubo espiral é acondicionado em blister de papel grau cirúrgico e filme plástico grau médico, termo selado e etiquetados no verso da embalagem.

São acondicionados em 10 peças por caixa de papelão e etiquetados novamente com as indicações do produto.

São apresentados nos seguintes tamanhos;

Seldinger			
J3-C-018-145	J15-C-018-145	J6-C-018-145	S-C-018-145
J3-C-018-150	J15-C-018-150	J6-C-018-150	S-C-018-150
J3-C-018-180	J15-C-018-180	J6-C-018-180	S-C-018-180
J3-C-018-260	J15-C-018-260	J6-C-018-260	S-C-018-260
J3-C-018-300	J15-C-018-300	J6-C-018-300	S-C-018-300
J3-C-018-400	J15-C-018-400	J6-C-018-400	S-C-018-400
J3-C-018-450	J15-C-018-450	J6-C-018-450	S-C-018-450
J3-C-021-145	J15-C-021-145	J6-C-021-145	S-C-021-145
J3-C-021-150	J15-C-021-150	J6-C-021-150	S-C-021-150
J3-C-021-180	J15-C-021-180	J6-C-021-180	S-C-021-180
J3-C-021-260	J15-C-021-260	J6-C-021-260	S-C-021-260
J3-C-021-300	J15-C-021-300	J6-C-021-300	S-C-021-300
J3-C-021-400	J15-C-021-400	J6-C-021-400	S-C-021-400
J3-C-021-450	J15-C-021-450	J6-C-021-450	S-C-021-450
J3-C-025-145	J15-C-025-145	J6-C-025-145	S-C-025-145
J3-C-025-150	J15-C-025-150	J6-C-025-150	S-C-025-150
J3-C-025-180	J15-C-025-180	J6-C-025-180	S-C-025-180
J3-C-025-260	J15-C-025-260	J6-C-025-260	S-C-025-260
J3-C-025-300	J15-C-025-300	J6-C-025-300	S-C-025-300
J3-C-025-400	J15-C-025-400	J6-C-025-400	S-C-025-400
J3-C-025-450	J15-C-025-450	J6-C-025-450	S-C-025-450
J3-C-028-145	J15-C-028-145	J6-C-028-145	S-C-028-145
J3-C-028-150	J15-C-028-150	J6-C-028-150	S-C-028-150
J3-C-028-180	J15-C-028-180	J6-C-028-180	S-C-028-180
J3-C-028-260	J15-C-028-260	J6-C-028-260	S-C-028-260
J3-C-028-300	J15-C-028-300	J6-C-028-300	S-C-028-300
J3-C-028-400	J15-C-028-400	J6-C-028-400	S-C-028-400
J3-C-028-450	J15-C-028-450	J6-C-028-450	S-C-028-450



J3-C-032-145
J3-C-032-150
J3-C-032-180
J3-C-032-260
J3-C-032-300
J3-C-032-400
J3-C-032-450

J15-C-032-145
J15-C-032-150
J15-C-032-180
J15-C-032-260
J15-C-032-300
J15-C-032-400
J15-C-032-450

J6-C-032-145
J6-C-032-150
J6-C-032-180
J6-C-032-260
J6-C-032-300
J6-C-032-400
J6-C-032-450

S-C-032-145
S-C-032-150
S-C-032-180
S-C-032-260
S-C-032-300
S-C-032-400
S-C-032-450

J3-C-035-145
J3-C-035-150
J3-C-035-180
J3-C-035-260
J3-C-035-300
J3-C-035-400
J3-C-035-450

J15-C-035-145
J15-C-035-150
J15-C-035-180
J15-C-035-260
J15-C-035-300
J15-C-035-400
J15-C-035-450

J6-C-035-145
J6-C-035-150
J6-C-035-180
J6-C-035-260
J6-C-035-300
J6-C-035-400
J6-C-035-450

S-C-035-145
S-C-035-150
S-C-035-180
S-C-035-260
S-C-035-300
S-C-035-400
S-C-035-450

J3-C-038-145
J3-C-038-150
J3-C-038-180
J3-C-038-260
J3-C-038-300
J3-C-038-400
J3-C-038-450

J15-C-038-145
J15-C-038-150
J15-C-038-180
J15-C-038-260
J15-C-038-300
J15-C-038-400
J15-C-038-450

J6-C-038-145
J6-C-038-150
J6-C-038-180
J6-C-038-260
J6-C-038-300
J6-C-038-400
J6-C-038-450

S-C-038-145
S-C-038-150
S-C-038-180
S-C-038-260
S-C-038-300
S-C-038-400
S-C-038-450

H-J3-C-018-145
H-J3-C-018-150
H-J3-C-018-180
H-J3-C-018-260
H-J3-C-018-300
H-J3-C-018-400
H-J3-C-018-450

H-J15-C-018-145
H-J15-C-018-150
H-J15-C-018-180
H-J15-C-018-260
H-J15-C-018-300
H-J15-C-018-400
H-J15-C-018-450

H-J6-C-018-145
H-J6-C-018-150
H-J6-C-018-180
H-J6-C-018-260
H-J6-C-018-300
H-J6-C-018-400
H-J6-C-018-450

H-S-C-018-145
H-S-C-018-150
H-S-C-018-180
H-S-C-018-260
H-S-C-018-300
H-S-C-018-400
H-S-C-018-450

H-J3-C-021-145
H-J3-C-021-150
H-J3-C-021-180
H-J3-C-021-260
H-J3-C-021-300

H-J15-C-021-145
H-J15-C-021-150
H-J15-C-021-180
H-J15-C-021-260
H-J15-C-021-300

H-J6-C-021-145
H-J6-C-021-150
H-J6-C-021-180
H-J6-C-021-260
H-J6-C-021-300

H-S-C-021-145
H-S-C-021-150
H-S-C-021-180
H-S-C-021-260
H-S-C-021-300

H-J3-C-021-400	H-J15-C-021-400	H-J6-C-021-400	H-S-C-021-400
H-J3-C-021-450	H-J15-C-021-450	H-J6-C-021-450	H-S-C-021-450
H-J3-C-025-145	H-J15-C-025-145	H-J6-C-025-145	H-S-C-025-145
H-J3-C-025-150	H-J15-C-025-150	H-J6-C-025-150	H-S-C-025-150
H-J3-C-025-180	H-J15-C-025-180	H-J6-C-025-180	H-S-C-025-180
H-J3-C-025-260	H-J15-C-025-260	H-J6-C-025-260	H-S-C-025-260
H-J3-C-025-300	H-J15-C-025-300	H-J6-C-025-300	H-S-C-025-300
H-J3-C-025-400	H-J15-C-025-400	H-J6-C-025-400	H-S-C-025-400
H-J3-C-025-450	H-J15-C-025-450	H-J6-C-025-450	H-S-C-025-450
H-J3-C-028-145	H-J15-C-028-145	H-J6-C-028-145	H-S-C-028-145
H-J3-C-028-150	H-J15-C-028-150	H-J6-C-028-150	H-S-C-028-150
H-J3-C-028-180	H-J15-C-028-180	H-J6-C-028-180	H-S-C-028-180
H-J3-C-028-260	H-J15-C-028-260	H-J6-C-028-260	H-S-C-028-260
H-J3-C-028-300	H-J15-C-028-300	H-J6-C-028-300	H-S-C-028-300
H-J3-C-028-400	H-J15-C-028-400	H-J6-C-028-400	H-S-C-028-400
H-J3-C-028-450	H-J15-C-028-450	H-J6-C-028-450	H-S-C-028-450
H-J3-C-032-145	H-J15-C-032-145	H-J6-C-032-145	H-S-C-032-145
H-J3-C-032-150	H-J15-C-032-150	H-J6-C-032-150	H-S-C-032-150
H-J3-C-032-180	H-J15-C-032-180	H-J6-C-032-180	H-S-C-032-180
H-J3-C-032-260	H-J15-C-032-260	H-J6-C-032-260	H-S-C-032-260
H-J3-C-032-300	H-J15-C-032-300	H-J6-C-032-300	H-S-C-032-300
H-J3-C-032-400	H-J15-C-032-400	H-J6-C-032-400	H-S-C-032-400
H-J3-C-032-450	H-J15-C-032-450	H-J6-C-032-450	H-S-C-032-450
H-J3-C-035-145	H-J15-C-035-145	H-J6-C-035-145	H-S-C-035-145
H-J3-C-035-150	H-J15-C-035-150	H-J6-C-035-150	H-S-C-035-150
H-J3-C-035-180	H-J15-C-035-180	H-J6-C-035-180	H-S-C-035-180
H-J3-C-035-260	H-J15-C-035-260	H-J6-C-035-260	H-S-C-035-260
H-J3-C-035-300	H-J15-C-035-300	H-J6-C-035-300	H-S-C-035-300
H-J3-C-035-400	H-J15-C-035-400	H-J6-C-035-400	H-S-C-035-400
H-J3-C-035-450	H-J15-C-035-450	H-J6-C-035-450	H-S-C-035-450
H-J3-C-038-145	H-J15-C-038-145	H-J6-C-038-145	H-S-C-038-145
H-J3-C-038-150	H-J15-C-038-150	H-J6-C-038-150	H-S-C-038-150
H-J3-C-038-180	H-J15-C-038-180	H-J6-C-038-180	H-S-C-038-180



H-J3-C-038-260
H-J3-C-038-300
H-J3-C-038-400
H-J3-C-038-450

H-J15-C-038-260
H-J15-C-038-300
H-J15-C-038-400
H-J15-C-038-450

H-J6-C-038-260
H-J6-C-038-300
H-J6-C-038-400
H-J6-C-038-450

H-S-C-038-260
H-S-C-038-300
H-S-C-038-400
H-S-C-038-450

H-X-J3-C-018-145
H-X-J3-C-018-150
H-X-J3-C-018-180
H-X-J3-C-018-260
H-X-J3-C-018-300
H-X-J3-C-018-400
H-X-J3-C-018-450

H-X-J15-C-018-145
H-X-J15-C-018-150
H-X-J15-C-018-180
H-X-J15-C-018-260
H-X-J15-C-018-300
H-X-J15-C-018-400
H-X-J15-C-018-450

H-X-J6-C-018-145
H-X-J6-C-018-150
H-X-J6-C-018-180
H-X-J6-C-018-260
H-X-J6-C-018-300
H-X-J6-C-018-400
H-X-J6-C-018-450

H-X-S-C-018-145
H-X-S-C-018-150
H-X-S-C-018-180
H-X-S-C-018-260
H-X-S-C-018-300
H-X-S-C-018-400
H-X-S-C-018-450

H-X-J3-C-021-145
H-X-J3-C-021-150
H-X-J3-C-021-180
H-X-J3-C-021-260
H-X-J3-C-021-300
H-X-J3-C-021-400
H-X-J3-C-021-450

H-X-J15-C-021-145
H-X-J15-C-021-150
H-X-J15-C-021-180
H-X-J15-C-021-260
H-X-J15-C-021-300
H-X-J15-C-021-400
H-X-J15-C-021-450

H-X-J6-C-021-145
H-X-J6-C-021-150
H-X-J6-C-021-180
H-X-J6-C-021-260
H-X-J6-C-021-300
H-X-J6-C-021-400
H-X-J6-C-021-450

H-X-S-C-021-145
H-X-S-C-021-150
H-X-S-C-021-180
H-X-S-C-021-260
H-X-S-C-021-300
H-X-S-C-021-400
H-X-S-C-021-450

H-X-J3-C-025-145
H-X-J3-C-025-150
H-X-J3-C-025-180
H-X-J3-C-025-260
H-X-J3-C-025-300
H-X-J3-C-025-400
H-X-J3-C-025-450

H-X-J15-C-025-145
H-X-J15-C-025-150
H-X-J15-C-025-180
H-X-J15-C-025-260
H-X-J15-C-025-300
H-X-J15-C-025-400
H-X-J15-C-025-450

H-X-J6-C-025-145
H-X-J6-C-025-150
H-X-J6-C-025-180
H-X-J6-C-025-260
H-X-J6-C-025-300
H-X-J6-C-025-400
H-X-J6-C-025-450

H-X-S-C-025-145
H-X-S-C-025-150
H-X-S-C-025-180
H-X-S-C-025-260
H-X-S-C-025-300
H-X-S-C-025-400
H-X-S-C-025-450

H-X-J3-C-028-145
H-X-J3-C-028-150
H-X-J3-C-028-180
H-X-J3-C-028-260
H-X-J3-C-028-300
H-X-J3-C-028-400
H-X-J3-C-028-450

H-X-J15-C-028-145
H-X-J15-C-028-150
H-X-J15-C-028-180
H-X-J15-C-028-260
H-X-J15-C-028-300
H-X-J15-C-028-400
H-X-J15-C-028-450

H-X-J6-C-028-145
H-X-J6-C-028-150
H-X-J6-C-028-180
H-X-J6-C-028-260
H-X-J6-C-028-300
H-X-J6-C-028-400
H-X-J6-C-028-450

H-X-S-C-028-145
H-X-S-C-028-150
H-X-S-C-028-180
H-X-S-C-028-260
H-X-S-C-028-300
H-X-S-C-028-400
H-X-S-C-028-450

H-X-J3-C-032-145

H-X-J15-C-032-145

H-X-J6-C-032-145

H-X-S-C-032-145

H-X-J3-C-032-150	H-X-J15-C-032-150	H-X-J6-C-032-150	H-X-S-C-032-150
H-X-J3-C-032-180	H-X-J15-C-032-180	H-X-J6-C-032-180	H-X-S-C-032-180
H-X-J3-C-032-260	H-X-J15-C-032-260	H-X-J6-C-032-260	H-X-S-C-032-260
H-X-J3-C-032-300	H-X-J15-C-032-300	H-X-J6-C-032-300	H-X-S-C-032-300
H-X-J3-C-032-400	H-X-J15-C-032-400	H-X-J6-C-032-400	H-X-S-C-032-400
H-X-J3-C-032-450	H-X-J15-C-032-450	H-X-J6-C-032-450	H-X-S-C-032-450
H-X-J3-C-035-145	H-X-J15-C-035-145	H-X-J6-C-035-145	H-X-S-C-035-145
H-X-J3-C-035-150	H-X-J15-C-035-150	H-X-J6-C-035-150	H-X-S-C-035-150
H-X-J3-C-035-180	H-X-J15-C-035-180	H-X-J6-C-035-180	H-X-S-C-035-180
H-X-J3-C-035-260	H-X-J15-C-035-260	H-X-J6-C-035-260	H-X-S-C-035-260
H-X-J3-C-035-300	H-X-J15-C-035-300	H-X-J6-C-035-300	H-X-S-C-035-300
H-X-J3-C-035-400	H-X-J15-C-035-400	H-X-J6-C-035-400	H-X-S-C-035-400
H-X-J3-C-035-450	H-X-J15-C-035-450	H-X-J6-C-035-450	H-X-S-C-035-450
H-X-J3-C-038-145	H-X-J15-C-038-145	H-X-J6-C-038-145	H-X-S-C-038-145
H-X-J3-C-038-150	H-X-J15-C-038-150	H-X-J6-C-038-150	H-X-S-C-038-150
H-X-J3-C-038-180	H-X-J15-C-038-180	H-X-J6-C-038-180	H-X-S-C-038-180
H-X-J3-C-038-260	H-X-J15-C-038-260	H-X-J6-C-038-260	H-X-S-C-038-260
H-X-J3-C-038-300	H-X-J15-C-038-300	H-X-J6-C-038-300	H-X-S-C-038-300
H-X-J3-C-038-400	H-X-J15-C-038-400	H-X-J6-C-038-400	H-X-S-C-038-400
H-X-J3-C-038-450	H-X-J15-C-038-450	H-X-J6-C-038-450	H-X-S-C-038-450
H-XX-J3-C-018-145	H-XX-J15-C-018-145	H-XX-J6-C-018-145	H-XX-S-C-018-145
H-XX-J3-C-018-150	H-XX-J15-C-018-150	H-XX-J6-C-018-150	H-XX-S-C-018-150
H-XX-J3-C-018-180	H-XX-J15-C-018-180	H-XX-J6-C-018-180	H-XX-S-C-018-180
H-XX-J3-C-018-260	H-XX-J15-C-018-260	H-XX-J6-C-018-260	H-XX-S-C-018-260
H-XX-J3-C-018-300	H-XX-J15-C-018-300	H-XX-J6-C-018-300	H-XX-S-C-018-300
H-XX-J3-C-018-400	H-XX-J15-C-018-400	H-XX-J6-C-018-400	H-XX-S-C-018-400
H-XX-J3-C-018-450	H-XX-J15-C-018-450	H-XX-J6-C-018-450	H-XX-S-C-018-450
H-XX-J3-C-021-145	H-XX-J15-C-021-145	H-XX-J6-C-021-145	H-XX-S-C-021-145
H-XX-J3-C-021-150	H-XX-J15-C-021-150	H-XX-J6-C-021-150	H-XX-S-C-021-150
H-XX-J3-C-021-180	H-XX-J15-C-021-180	H-XX-J6-C-021-180	H-XX-S-C-021-180
H-XX-J3-C-021-260	H-XX-J15-C-021-260	H-XX-J6-C-021-260	H-XX-S-C-021-260
H-XX-J3-C-021-300	H-XX-J15-C-021-300	H-XX-J6-C-021-300	H-XX-S-C-021-300
H-XX-J3-C-021-400	H-XX-J15-C-021-400	H-XX-J6-C-021-400	H-XX-S-C-021-400
H-XX-J3-C-021-450	H-XX-J15-C-021-450	H-XX-J6-C-021-450	H-XX-S-C-021-450



H-XX-J3-C-025-145
H-XX-J3-C-025-150
H-XX-J3-C-025-180
H-XX-J3-C-025-260
H-XX-J3-C-025-300
H-XX-J3-C-025-400
H-XX-J3-C-025-450

H-XX-J15-C-025-145
H-XX-J15-C-025-150
H-XX-J15-C-025-180
H-XX-J15-C-025-260
H-XX-J15-C-025-300
H-XX-J15-C-025-400
H-XX-J15-C-025-450

H-XX-J6-C-025-145
H-XX-J6-C-025-150
H-XX-J6-C-025-180
H-XX-J6-C-025-260
H-XX-J6-C-025-300
H-XX-J6-C-025-400
H-XX-J6-C-025-450

H-XX-S-C-025-145
H-XX-S-C-025-150
H-XX-S-C-025-180
H-XX-S-C-025-260
H-XX-S-C-025-300
H-XX-S-C-025-400
H-XX-S-C-025-450

H-XX-J3-C-028-145
H-XX-J3-C-028-150
H-XX-J3-C-028-180
H-XX-J3-C-028-260
H-XX-J3-C-028-300
H-XX-J3-C-028-400
H-XX-J3-C-028-450

H-XX-J15-C-028-145
H-XX-J15-C-028-150
H-XX-J15-C-028-180
H-XX-J15-C-028-260
H-XX-J15-C-028-300
H-XX-J15-C-028-400
H-XX-J15-C-028-450

H-XX-J6-C-028-145
H-XX-J6-C-028-150
H-XX-J6-C-028-180
H-XX-J6-C-028-260
H-XX-J6-C-028-300
H-XX-J6-C-028-400
H-XX-J6-C-028-450

H-XX-S-C-028-145
H-XX-S-C-028-150
H-XX-S-C-028-180
H-XX-S-C-028-260
H-XX-S-C-028-300
H-XX-S-C-028-400
H-XX-S-C-028-450

H-XX-J3-C-032-145
H-XX-J3-C-032-150
H-XX-J3-C-032-180
H-XX-J3-C-032-260
H-XX-J3-C-032-300
H-XX-J3-C-032-400
H-XX-J3-C-032-450

H-XX-J15-C-032-145
H-XX-J15-C-032-150
H-XX-J15-C-032-180
H-XX-J15-C-032-260
H-XX-J15-C-032-300
H-XX-J15-C-032-400
H-XX-J15-C-032-450

H-XX-J6-C-032-145
H-XX-J6-C-032-150
H-XX-J6-C-032-180
H-XX-J6-C-032-260
H-XX-J6-C-032-300
H-XX-J6-C-032-400
H-XX-J6-C-032-450

H-XX-S-C-032-145
H-XX-S-C-032-150
H-XX-S-C-032-180
H-XX-S-C-032-260
H-XX-S-C-032-300
H-XX-S-C-032-400
H-XX-S-C-032-450

H-XX-J3-C-035-145
H-XX-J3-C-035-150
H-XX-J3-C-035-180
H-XX-J3-C-035-260
H-XX-J3-C-035-300
H-XX-J3-C-035-400
H-XX-J3-C-035-450

H-XX-J15-C-035-145
H-XX-J15-C-035-150
H-XX-J15-C-035-180
H-XX-J15-C-035-260
H-XX-J15-C-035-300
H-XX-J15-C-035-400
H-XX-J15-C-035-450

H-XX-J6-C-035-145
H-XX-J6-C-035-150
H-XX-J6-C-035-180
H-XX-J6-C-035-260
H-XX-J6-C-035-300
H-XX-J6-C-035-400
H-XX-J6-C-035-450

H-XX-S-C-035-145
H-XX-S-C-035-150
H-XX-S-C-035-180
H-XX-S-C-035-260
H-XX-S-C-035-300
H-XX-S-C-035-400
H-XX-S-C-035-450

H-XX-J3-C-038-145
H-XX-J3-C-038-150
H-XX-J3-C-038-180
H-XX-J3-C-038-260
H-XX-J3-C-038-300

H-XX-J15-C-038-145
H-XX-J15-C-038-150
H-XX-J15-C-038-180
H-XX-J15-C-038-260
H-XX-J15-C-038-300

H-XX-J6-C-038-145
H-XX-J6-C-038-150
H-XX-J6-C-038-180
H-XX-J6-C-038-260
H-XX-J6-C-038-300

H-XX-S-C-038-145
H-XX-S-C-038-150
H-XX-S-C-038-180
H-XX-S-C-038-260
H-XX-S-C-038-300

H-XX-J3-C-038-400 H-XX-J3-C-038-450	H-XX-J15-C-038-400 H-XX-J15-C-038-450	H-XX-J6-C-038-400 H-XX-J6-C-038-450	H-XX-S-C-038-400 H-XX-S-C-038-450
Double Ended			
D-S-J3-C-025-145 D-S-J3-C-025-150 D-S-J3-C-025-180 D-S-J3-C-025-260 D-S-J3-C-025-300 D-S-J3-C-025-400	D-S-J15-C-025-145 D-S-J15-C-025-150 D-S-J15-C-025-180 D-S-J15-C-025-260 D-S-J15-C-025-300 D-S-J15-C-025-400	D-S-J6-C-025-145 D-S-J6-C-025-150 D-S-J6-C-025-180 D-S-J6-C-025-260 D-S-J6-C-025-300 D-S-J6-C-025-400	
D-S-J3-C-032-145 D-S-J3-C-032-150 D-S-J3-C-032-180 D-S-J3-C-032-260 D-S-J3-C-032-300 D-S-J3-C-032-400	D-S-J15-C-032-145 D-S-J15-C-032-150 D-S-J15-C-032-180 D-S-J15-C-032-260 D-S-J15-C-032-300 D-S-J15-C-032-400	D-S-J6-C-032-145 D-S-J6-C-032-150 D-S-J6-C-032-180 D-S-J6-C-032-260 D-S-J6-C-032-300 D-S-J6-C-032-400	
D-S-J3-C-035-145 D-S-J3-C-035-150 D-S-J3-C-035-180 D-S-J3-C-035-260 D-S-J3-C-035-300 D-S-J3-C-035-400	D-S-J15-C-035-145 D-S-J15-C-035-150 D-S-J15-C-035-180 D-S-J15-C-035-260 D-S-J15-C-035-300 D-S-J15-C-035-400	D-S-J6-C-035-145 D-S-J6-C-035-150 D-S-J6-C-035-180 D-S-J6-C-035-260 D-S-J6-C-035-300 D-S-J6-C-035-400	
D-S-J3-C-038-145 D-S-J3-C-038-150 D-S-J3-C-038-180 D-S-J3-C-038-260 D-S-J3-C-038-300 D-S-J3-C-038-400	D-S-J15-C-038-145 D-S-J15-C-038-150 D-S-J15-C-038-180 D-S-J15-C-038-260 D-S-J15-C-038-300 D-S-J15-C-038-400	D-S-J6-C-038-145 D-S-J6-C-038-150 D-S-J6-C-038-180 D-S-J6-C-038-260 D-S-J6-C-038-300 D-S-J6-C-038-400	
H-D-S-J3-C-025-145 H-D-S-J3-C-025-150 H-D-S-J3-C-025-180 H-D-S-J3-C-025-260 H-D-S-J3-C-025-300 H-D-S-J3-C-025-400	H-D-S-J15-C-025-145 H-D-S-J15-C-025-150 H-D-S-J15-C-025-180 H-D-S-J15-C-025-260 H-D-S-J15-C-025-300 H-D-S-J15-C-025-400	H-D-S-J6-C-025-145 H-D-S-J6-C-025-150 H-D-S-J6-C-025-180 H-D-S-J6-C-025-260 H-D-S-J6-C-025-300 H-D-S-J6-C-025-400	



H-D-S-J3-C-032-145	H-D-S-J15-C-032-145	H-D-S-J6-C-032-145	
H-D-S-J3-C-032-150	H-D-S-J15-C-032-150	H-D-S-J6-C-032-150	
H-D-S-J3-C-032-180	H-D-S-J15-C-032-180	H-D-S-J6-C-032-180	
H-D-S-J3-C-032-260	H-D-S-J15-C-032-260	H-D-S-J6-C-032-260	
H-D-S-J3-C-032-300	H-D-S-J15-C-032-300	H-D-S-J6-C-032-300	
H-D-S-J3-C-032-400	H-D-S-J15-C-032-400	H-D-S-J6-C-032-400	
H-D-S-J3-C-035-145	H-D-S-J15-C-035-145	H-D-S-J6-C-035-145	
H-D-S-J3-C-035-150	H-D-S-J15-C-035-150	H-D-S-J6-C-035-150	
H-D-S-J3-C-035-180	H-D-S-J15-C-035-180	H-D-S-J6-C-035-180	
H-D-S-J3-C-035-260	H-D-S-J15-C-035-260	H-D-S-J6-C-035-260	
H-D-S-J3-C-035-300	H-D-S-J15-C-035-300	H-D-S-J6-C-035-300	
H-D-S-J3-C-035-400	H-D-S-J15-C-035-400	H-D-S-J6-C-035-400	
H-D-S-J3-C-038-145	H-D-S-J15-C-038-145	H-D-S-J6-C-038-145	
H-D-S-J3-C-038-150	H-D-S-J15-C-038-150	H-D-S-J6-C-038-150	
H-D-S-J3-C-038-180	H-D-S-J15-C-038-180	H-D-S-J6-C-038-180	
H-D-S-J3-C-038-260	H-D-S-J15-C-038-260	H-D-S-J6-C-038-260	
H-D-S-J3-C-038-300	H-D-S-J15-C-038-300	H-D-S-J6-C-038-300	
H-D-S-J3-C-038-400	H-D-S-J15-C-038-400	H-D-S-J6-C-038-400	
Movable			
M-J3-C-032-145	M-J6-C-032-145	M-S-C-032-145	
M-J3-C-032-150	M-J6-C-032-150	M-S-C-032-150	
M-J3-C-032-180	M-J6-C-032-180	M-S-C-032-180	
M-J3-C-032-260	M-J6-C-032-260	M-S-C-032-260	
M-J3-C-032-300	M-J6-C-032-300	M-S-C-032-300	
M-J3-C-032-450	M-J6-C-032-450	M-S-C-032-450	
M-J3-C-035-145	M-J6-C-035-145	M-S-C-035-145	
M-J3-C-035-150	M-J6-C-035-150	M-S-C-035-150	
M-J3-C-035-180	M-J6-C-035-180	M-S-C-035-180	
M-J3-C-035-260	M-J6-C-035-260	M-S-C-035-260	
M-J3-C-035-300	M-J6-C-035-300	M-S-C-035-300	
M-J3-C-035-450	M-J6-C-035-450	M-S-C-035-450	
M-J3-C-038-145	M-J6-C-038-145	M-S-C-038-145	

M-J3-C-038-150	M-J6-C-038-150	M-S-C-038-150	
M-J3-C-038-180	M-J6-C-038-180	M-S-C-038-180	
M-J3-C-038-260	M-J6-C-038-260	M-S-C-038-260	
M-J3-C-038-300	M-J6-C-038-300	M-S-C-038-300	
M-J3-C-038-450	M-J6-C-038-450	M-S-C-038-450	
H-M-J3-C-032-145	H-M-J6-C-032-145	H-M-S-C-032-145	
H-M-J3-C-032-150	H-M-J6-C-032-150	H-M-S-C-032-150	
H-M-J3-C-032-180	H-M-J6-C-032-180	H-M-S-C-032-180	
H-M-J3-C-032-260	H-M-J6-C-032-260	H-M-S-C-032-260	
H-M-J3-C-032-300	H-M-J6-C-032-300	H-M-S-C-032-300	
H-M-J3-C-032-450	H-M-J6-C-032-450	H-M-S-C-032-450	
H-M-J3-C-035-145	H-M-J6-C-035-145	H-M-S-C-035-145	
H-M-J3-C-035-150	H-M-J6-C-035-150	H-M-S-C-035-150	
H-M-J3-C-035-180	H-M-J6-C-035-180	H-M-S-C-035-180	
H-M-J3-C-035-260	H-M-J6-C-035-260	H-M-S-C-035-260	
H-M-J3-C-035-300	H-M-J6-C-035-300	H-M-S-C-035-300	
H-M-J3-C-035-450	H-M-J6-C-035-450	H-M-S-C-035-450	
H-M-J3-C-038-145	H-M-J6-C-038-145	H-M-S-C-038-145	
H-M-J3-C-038-150	H-M-J6-C-038-150	H-M-S-C-038-150	
H-M-J3-C-038-180	H-M-J6-C-038-180	H-M-S-C-038-180	
H-M-J3-C-038-260	H-M-J6-C-038-260	H-M-S-C-038-260	
H-M-J3-C-038-300	H-M-J6-C-038-300	H-M-S-C-038-300	
H-M-J3-C-038-450	H-M-J6-C-038-450	H-M-S-C-038-450	
Lunderquist			
PTC-J3-F5-025-70	PTC-J15-F5-025-70	PTC-J6-F5-025-70	PTC-S-F5-025-70
PTC-J3-F5-025-90	PTC-J15-F5-025-90	PTC-J6-F5-025-90	PTC-S-F5-025-90
PTC-J3-F5-025-100	PTC-J15-F5-025-100	PTC-J6-F5-025-100	PTC-S-F5-025-100
PTC-J3-F5-025-120	PTC-J15-F5-025-120	PTC-J6-F5-025-120	PTC-S-F5-025-120
PTC-J3-F5-025-150	PTC-J15-F5-025-150	PTC-J6-F5-025-150	PTC-S-F5-025-150
PTC-J3-F7-025-70	PTC-J15-F7-025-70	PTC-J6-F7-025-70	PTC-S-F7-025-70
PTC-J3-F7-025-90	PTC-J15-F7-025-90	PTC-J6-F7-025-90	PTC-S-F7-025-90
PTC-J3-F7-025-100	PTC-J15-F7-025-100	PTC-J6-F7-025-100	PTC-S-F7-025-100
PTC-J3-F7-025-120	PTC-J15-F7-025-120	PTC-J6-F7-025-120	PTC-S-F7-025-120



PTC-J3-F7-025-150	PTC-J15-F7-025-150	PTC-J6-F7-025-150	PTC-S-F7-025-150
PTC-J3-F10-025-70	PTC-J15-F10-025-70	PTC-J6-F10-025-70	PTC-S-F10-025-70
PTC-J3-F10-025-90	PTC-J15-F10-025-90	PTC-J6-F10-025-90	PTC-S-F10-025-90
PTC-J3-F10-025-100	PTC-J15-F10-025-100	PTC-J6-F10-025-100	PTC-S-F10-025-100
PTC-J3-F10-025-120	PTC-J15-F10-025-120	PTC-J6-F10-025-120	PTC-S-F10-025-120
PTC-J3-F10-025-150	PTC-J15-F10-025-150	PTC-J6-F10-025-150	PTC-S-F10-025-150
PTC-J3-F5-035-70	PTC-J15-F5-035-70	PTC-J6-F5-035-70	PTC-S-F5-035-70
PTC-J3-F5-035-90	PTC-J15-F5-035-90	PTC-J6-F5-035-90	PTC-S-F5-035-90
PTC-J3-F5-035-100	PTC-J15-F5-035-100	PTC-J6-F5-035-100	PTC-S-F5-035-100
PTC-J3-F5-035-120	PTC-J15-F5-035-120	PTC-J6-F5-035-120	PTC-S-F5-035-120
PTC-J3-F5-035-150	PTC-J15-F5-035-150	PTC-J6-F5-035-150	PTC-S-F5-035-150
PTC-J3-F7-035-70	PTC-J15-F7-035-70	PTC-J6-F7-035-70	PTC-S-F7-035-70
PTC-J3-F7-035-90	PTC-J15-F7-035-90	PTC-J6-F7-035-90	PTC-S-F7-035-90
PTC-J3-F7-035-100	PTC-J15-F7-035-100	PTC-J6-F7-035-100	PTC-S-F7-035-100
PTC-J3-F7-035-120	PTC-J15-F7-035-120	PTC-J6-F7-035-120	PTC-S-F7-035-120
PTC-J3-F7-035-150	PTC-J15-F7-035-150	PTC-J6-F7-035-150	PTC-S-F7-035-150
PTC-J3-F10-035-70	PTC-J15-F10-035-70	PTC-J6-F10-035-70	PTC-S-F10-035-70
PTC-J3-F10-035-90	PTC-J15-F10-035-90	PTC-J6-F10-035-90	PTC-S-F10-035-90
PTC-J3-F10-035-100	PTC-J15-F10-035-100	PTC-J6-F10-035-100	PTC-S-F10-035-100
PTC-J3-F10-035-120	PTC-J15-F10-035-120	PTC-J6-F10-035-120	PTC-S-F10-035-120
PTC-J3-F10-035-150	PTC-J15-F10-035-150	PTC-J6-F10-035-150	PTC-S-F10-035-150
Schüller			
PTC-SCH-J3-F5-30-60-035-80	PTC-SCH-J15-F5-30-60-035-80	PTC-SCH-J6-F5-30-60-035-80	PTC-SCH-S-F5-30-60-035-80
PTC-SCH-J3-F5-30-60-035-100	PTC-SCH-J15-F5-30-60-035-100	PTC-SCH-J6-F5-30-60-035-100	PTC-SCH-S-F5-30-60-035-100
PTC-SCH-J3-F7-30-60-035-80	PTC-SCH-J15-F7-30-60-035-80	PTC-SCH-J6-F7-30-60-035-80	PTC-SCH-S-F7-30-60-035-80
PTC-SCH-J3-F7-30-60-035-100	PTC-SCH-J15-F7-30-60-035-100	PTC-SCH-J6-F7-30-60-035-100	PTC-SCH-S-F7-30-60-035-100
PTC-SCH-J3-F10-30-60-035-80	PTC-SCH-J15-F10-30-60-035-80	PTC-SCH-J6-F10-30-60-035-80	PTC-SCH-S-F10-30-60-035-80
PTC-SCH-J3-F10-30-60-035-100	PTC-SCH-J15-F10-30-60-035-100	PTC-SCH-J6-F10-30-60-035-100	PTC-SCH-S-F10-30-60-035-100

H = Heavy duty shaft

J1,5 = J-tip of 1,5mm radius

J3 = J-tip of 3mm radius

D = double-ended

X = Heavy Duty (Stiff)

XX = Extra Heavy Duty (Extra

J6 = J-tip of 6mm radius	Stiff)
S = Straight tip	PTC = product type
C = PTFE coated	F5 = flexible distal tip (5cm)
018 = diam. 0,018" (inch)	F7 = flexivel distal tip (7cm)
021 = diam. 0,021" (inch)	F10 = flexivel distal tip (10cm)
025 = diam. 0,025" (inch)	SCH = Schüller - double ended
028 = diam. 0,028" (inch)	30 = Stiff part (30cm)
032 = diam. 0,032" (inch)	60 = Stiff flexible proximal end (60cm)
035 = diam. 0,035" (inch)	M = movable
038 = diam. 0,038" (inch)	
70 = lenght 70cm	
90 = lenght 90cm	
100 = lenght 100cm	
120 = lenght 120cm	
145 = lenght 145cm	
150 = lenght 150cm	
180 = lenght 180cm	
260 = lenght 260cm	
300 = lenght 300cm	
400 = lenght 400cm	
450 = lenght 450cm	

PRODUTO MÉDICO HOSPITALAR.
 ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO
 O FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO.
 DESTRUIR APÓS O USO.
 NÃO REESTERILIZAR.

A esterilidade do produto é garantida enquanto a embalagem unitária do produto não seja violada ou apresente problemas antes de sua utilização.

FABRICADO POR: SP MEDICAL A/S - Dinamarca

IMPORTADO e DISTRIBUIDO POR: Neomex Hospitalar Ltda – Rua Manoel Francisco Mendes, 73 – Jardim do Trevo – Campinas – São Paulo. CNPJ: 02809310/0001-87 – SAC: (19) 3274-0044

RESPONSÁVEL TÉCNICO – Adriano César Gomes Ribeiro CRF/SP: 25461

REGISTRO ANVISA:



Representante Legal

Fernando Antonio Saraiva Filho

Responsável Técnico

Adriano Cesar Gomes Ribeiro



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	NEOMEX HOSPITALAR LTDA		
CNPJ	02.809.310/0001-87	Autorização	8.01.521-2
Produto	FIO GUIA PTFE ACCOAT		

Modelo Produto Médico

Double Ended: D-S-J3-C-025-145; D-S-J15-C-025-145; D-S-J6-C-025-145; D-S-J3-C-025-150; D-S-J15-C-025-150; D-S-J6-C-025-150; D-S-J3-C-025-180; D-S-J15-C-025-180; D-S-J6-C-025-180; D-S-J3-C-025-260; D-S-J15-C-025-260; D-S-J6-C-025-260; D-S-J3-C-025-300; D-S-J15-C-025-300; D-S-J6-C-025-300; D-S-J3-C-025-400; D-S-J15-C-025-400; D-S-J6-C-025-400; D-S-J3-C-032-145; D-S-J15-C-032-145; D-S-J6-C-032-145; D-S-J3-C-032-150; D-S-J15-C-032-150; D-S-J6-C-032-150; D-S-J3-C-032-180; D-S-J15-C-032-180; D-S-J6-C-032-180; D-S-J3-C-032-260; D-S-J15-C-032-260; D-S-J6-C-032-260; D-S-J3-C-032-300; D-S-J15-C-032-300; D-S-J6-C-032-300; D-S-J3-C-032-400; D-S-J15-C-032-400; D-S-J6-C-032-400; D-S-J3-C-035-145; D-S-J15-C-035-145; D-S-J6-C-035-145; D-S-J3-C-035-150; D-S-J15-C-035-150; D-S-J6-C-035-150; D-S-J3-C-035-180; D-S-J15-C-035-180; D-S-J6-C-035-180; D-S-J3-C-035-260; D-S-J15-C-035-260; D-S-J6-C-035-260; D-S-J3-C-035-300; D-S-J15-C-035-300; D-S-J6-C-035-300; D-S-J3-C-035-400; D-S-J15-C-035-400; D-S-J6-C-035-400; D-S-J3-C-038-145; D-S-J15-C-038-145; D-S-J6-C-038-145; D-S-J3-C-038-150; D-S-J15-C-038-150; D-S-J6-C-038-150; D-S-J3-C-038-180; D-S-J15-C-038-180; D-S-J6-C-038-180; D-S-J3-C-038-260; D-S-J15-C-038-260; D-S-J6-C-038-260; D-S-J3-C-038-300; D-S-J15-C-038-300; D-S-J6-C-038-300; D-S-J3-C-038-400; D-S-J15-C-038-400; D-S-J6-C-038-400; H-D-S-J3-C-025-145; H-D-S-J15-C-025-145; H-D-S-J6-C-025-145; H-D-S-J3-C-025-150; H-D-S-J15-C-025-150; H-D-S-J6-C-025-150; H-D-S-J3-C-025-180; H-D-S-J15-C-025-180; H-D-S-J6-C-025-180; H-D-S-J3-C-025-260; H-D-S-J15-C-025-260; H-D-S-J6-C-025-260; H-D-S-J3-C-025-300; H-D-S-J15-C-025-300; H-D-S-J6-C-025-300; H-D-S-J3-C-025-400; H-D-S-J15-C-025-400; H-D-S-J6-C-025-400; H-D-S-J3-C-032-145; H-D-S-J15-C-032-145; H-D-S-J6-C-032-145; H-D-S-J3-C-032-150; H-D-S-J15-C-032-150; H-D-S-J6-C-032-150; H-D-S-J3-C-032-180; H-D-S-J15-C-032-180; H-D-S-J6-C-032-180; H-D-S-J3-C-032-260; H-D-S-J15-C-032-260; H-D-S-J6-C-032-260; H-D-S-J3-C-032-300; H-D-S-J15-C-032-300; H-D-S-J6-C-032-300; H-D-S-J3-C-032-400; H-D-S-J15-C-032-400; H-D-S-J6-C-032-400; H-D-S-J3-C-035-145; H-D-S-J15-C-035-145; H-D-S-J6-C-035-145; H-D-S-J3-C-035-150; H-D-S-J15-C-035-150; H-D-S-J6-C-035-150; H-D-S-J3-C-035-180; H-D-S-J15-C-035-180; H-D-S-J6-C-035-180; H-D-S-J3-C-035-260; H-D-S-J15-C-035-260; H-D-S-J6-C-035-260; H-D-S-J3-C-035-300; H-D-S-J15-C-035-300; H-D-S-J6-C-035-300; H-D-S-J3-C-035-400; H-D-S-J15-C-035-400; H-D-S-J6-C-035-400; H-D-S-J3-C-038-145; H-D-S-J15-C-038-145; H-D-S-J6-C-038-145; H-D-S-J3-C-038-150; H-D-S-J15-C-038-150; H-D-S-J6-C-038-150; H-D-S-J3-C-038-180; H-D-S-J15-C-038-180; H-D-S-J6-C-038-180; H-D-S-J3-C-038-260; H-D-S-J15-C-038-260; H-D-S-J6-C-038-260; H-D-S-J3-C-038-300; H-D-S-J15-C-038-300; H-D-S-J6-C-038-300; H-D-S-J3-C-038-400; H-D-S-J15-C-038-400; H-D-S-J6-C-038-400;



Seldinger: J3-C-018-145; J15-C-018-145; J6-C-018-145; S-C-018-145 J3-C-018-150; J15-C-018-150; J6-C-018-150; S-C-018-150; J3-C-018-180; J15-C-018-180; J6-C-018-180; S-C-018-180; J3-C-018-260; J15-C-018-260; J6-C-018-260; S-C-018-260; J3-C-018-300; J15-C-018-300; J6-C-018-300; S-C-018-300; J3-C-018-400; J15-C-018-400; J6-C-018-400; S-C-018-400; J3-C-018-450; J15-C-018-450; J6-C-018-450; S-C-018-450; J3-C-021-145; J15-C-021-145; J6-C-021-145; S-C-021-145; J3-C-021-150; J15-C-021-150; J6-C-021-150; S-C-021-150; J3-C-021-180; J15-C-021-180; J6-C-021-180; S-C-021-180; J3-C-021-260; J15-C-021-260; J6-C-021-260; S-C-021-260; J3-C-021-300; J15-C-021-300; J6-C-021-300; S-C-021-300; J3-C-021-400; J15-C-021-400; J6-C-021-400; S-C-021-400; J3-C-021-450; J15-C-021-450; J6-C-021-450; S-C-021-450; J3-C-025-145; J15-C-025-145; J6-C-025-145; S-C-025-145; J3-C-025-150; J15-C-025-150; J6-C-025-150; S-C-025-150; J3-C-025-180; J15-C-025-180; J6-C-025-180; S-C-025-180; J3-C-025-260; J15-C-025-260; J6-C-025-260; S-C-025-260; J3-C-025-300; J15-C-025-300; J6-C-025-300; S-C-025-300; J3-C-025-400; J15-C-025-400; J6-C-025-400; S-C-025-400; J3-C-025-450; J15-C-025-450; J6-C-025-450; S-C-025-450; J3-C-028-145; J15-C-028-145; J6-C-028-145; S-C-028-145; J3-C-028-150; J15-C-028-150; J6-C-028-150; S-C-028-150; J3-C-028-180; J15-C-028-180; J6-C-028-180; S-C-028-180; J3-C-028-260; J15-C-028-260; J6-C-028-260; S-C-028-260; J3-C-028-300; J15-C-028-300; J6-C-028-300; S-C-028-300; J3-C-028-400; J15-C-028-400; J6-C-028-400; S-C-028-400; J3-C-028-450; J15-C-028-450; J6-C-028-450; S-C-028-450; J3-C-032-145; J15-C-032-145; J6-C-032-145; S-C-032-145; J3-C-032-150; J15-C-032-150; J6-C-032-150; S-C-032-150; J3-C-032-180; J15-C-032-180; J6-C-032-180; S-C-032-180; J3-C-032-260; J15-C-032-260; J6-C-032-260; S-C-032-260; J3-C-032-300; J15-C-032-300; J6-C-032-300; S-C-032-300; J3-C-032-400; J15-C-032-400; J6-C-032-400; S-C-032-400; J3-C-032-450; J15-C-032-450; J6-C-032-450; S-C-032-450; J3-C-035-145; J15-C-035-145; J6-C-035-145; S-C-035-145; J3-C-035-150; J15-C-035-150; J6-C-035-150; S-C-035-150; J3-C-035-180; J15-C-035-180; J6-C-035-180; S-C-035-180; J3-C-035-260; J15-C-035-260; J6-C-035-260; S-C-035-260; J3-C-035-300; J15-C-035-300; J6-C-035-300; S-C-035-300; J3-C-035-400; J15-C-035-400; J6-C-035-400; S-C-035-400; J3-C-035-450; J15-C-035-450; J6-C-035-450; S-C-035-450; J3-C-038-145; J15-C-038-145; J6-C-038-145; S-C-038-145; J3-C-038-150; J15-C-038-150; J6-C-038-150; S-C-038-150; J3-C-038-180; J15-C-038-180; J6-C-038-180; S-C-038-180; J3-C-038-260; J15-C-038-260; J6-C-038-260; S-C-038-260; J3-C-038-300; J15-C-038-300; J6-C-038-300; S-C-038-300; J3-C-038-400; J15-C-038-400; J6-C-038-400; S-C-038-400; J3-C-038-450; J15-C-038-450; J6-C-038-450; S-C-038-450;

Nome Técnico

Fio Guia

Registro

80152120013

Processo

25351.152944/2008-78

Origem do Produto

• FABRICANTE: SP MEDICAL A/S - DINAMARCA

Classificação de Risco

II - MEDIO RISCO

Vencimento do Registro


VIGENTE

[Voltar](#)



Prefeitura do Recife

Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano
Secretaria Executiva de Licenciamento e Urbanismo



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Alvará nº 8118343522

Data Validade: 10/03/2028

Tipo de Alvará: DEFINITIVO

A Diretoria Executiva de Licenciamento e Urbanismo, através da Central de Licenciamento, concede este **ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**, conforme dados abaixo:

1. Dados da Empresa

Razão Social: **SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**

CNPJ: **37.438.274/0001-77**

Inscrição Mercantil: **679.522-6**

Tipo	Sequencial	Endereço do cadastro imobiliário
Principal	461916.1	AV CAXANGA, 205 SALA 0201 EMP CAXANGA TRADE CENTER - MADALENA - RECIFE/PE
Correspondência	461916.1	AV CAXANGA, 205 SALA 0201 EMP CAXANGA TRADE CENTER - MADALENA - RECIFE/PE

2. Atividade(s):

* Atividade Principal

Código	Descrição
*4645101	*COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTR E MATER P/ USO MÉDICO, CIRÚRG, HOSP E DE LABORATÓRIOS
4618402	REPRESENTANTES COM E AGENTES DO COM DE INST E MAT ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA

3. Condicionante(s)

ESTA LICENÇA NÃO AUTORIZA QUALQUER ATIVIDADE POTENCIALMENTE GERADORA DE INCOMODIDADE (APGI) OU ATIVIDADE GERADORA DE IMPACTOS AMBIENTAIS PREVISTAS NA LEI 16289/97, LEI 16243/96, DECRETO 32094/19 E DEMAIS NORMAS EM VIGOR NO IMÓVEL EM TELA.

4. Atividade Incômoda no local

Não

5. Nível de incomodidade

DEFERIDO POR:

4161596480



MANTER ESTE DOCUMENTO EM LOCAL VISÍVEL



Hospital do
Tricentenário



Caruaru, 31 de maio de 2021.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação e participação em cotação, que a empresa SELLMED PRODUTOS MEDICINAIS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 37.438.274/0001-77, sediada na Av. Caxangá 205 – Empresarial Caxangá Trade Center – Sala 201 – Madalena - Recife/PE - CEP: 50.720-000, é fornecedora de materiais para hemodinâmica no Hospital do Tricentenário-Mestre Vitalino, CNPJ: 10.583.920/0008-00, localizado na Rodovia BR 104, N.º 756, se encontra dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, e passamos a declarar que não consta em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade.

Atenciosamente,

Ana Karolina F. Silva

Ana Karolina Silva
Compradora
CPF - 5456
HTRI - HOSPITAL MESTRE VITALINO

Infra os dados do ato em: [https://selodigital.tjpb.jus.br/ou/Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/164523105219711925148](https://selodigital.tjpb.jus.br/ou/Consulte%20o%20Documento%20em%20https%3A%2F%2Fazevedobastos.not.br/documento/164523105219711925148)



ARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 164523105219711925148-1
Data: 31/05/2021 13:59:12
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALO43215-OHCl:



N.º 05.876-D

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br

Valério Azevedo Bastos M. Cavalcanti



TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 31 de maio de 2021 14:00:47 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento



Dados da Empresa Nacional

Razão SocialSELLMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ

37.438.274/0001-77

Endereço Completo

- /

Telefone**Responsável Técnico**

THIAGO DOUBERIN DA SILVA.

Responsável Legal

HUGO LEONARDO ALBUQUERQUE DE VICTOR

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.20.999-3 (L022507L135Y)

Data do Cadastro

18/11/2020

Situação**Ativa****Nº do Processo**

25351.160043/2020-46

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes**Armazenar**

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Importar

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)**Empresa
Solicitante****Linhas de Certificação
Vigentes****Data de
Publicação****Vencimento do
Certificado**

Nenhum registro encontrado



Prefeitura do Recife

Secretaria de Saúde
Diretoria Executiva de Vigilância à Saúde
Gerência de Vigilância Sanitária



LICENÇA SANITÁRIA

Processo nº: 8112032021

Data Validade: 20/07/2023

A **Diretoria Executiva de Vigilância à Saúde**, **CONCEDE** a presente **LICENÇA SANITÁRIA**, processo nº **8112032021**, conforme dados abaixo:

1. Dados do Empreendedor

Nome/Razão: SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 37.438.274/0001-77
Endereço: AV CAXANGA, 205
SALA 0201 EMP CAXANGA TRADE CENTER
MADALENA - RECIFE/PE

Sequencial do Imóvel: **461916.1**

Inscrição Mercantil: **679.522-6**

Responsável Técnico: THIAGO DOUBERIN DA SILVA, CPF - 056.102.564-96, Orgão - CRF PE, Registro profissional - 4176

2. Atividade(s):

Código	Descrição
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTR E MATER P/ USO MÉDICO, CIRÚRG, HOSP E DE LABORATÓRIOS
4618402	REPRESENTANTES COM E AGENTES DO COM DE INST E MAT ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA

3. Condicionante(s) Geral(is)

4. Condicionante(s) Específica(s)

5. Informação(ões) Complementar(es)



Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o link <https://processos.recife.pe.gov.br/pcr-urbanistico/externo/exibircertificado/exibir-certificado.action> e digite o código existente no rodapé do selo



Prefeitura do Recife

Secretaria de Saúde
Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde
Gerência de Vigilância Sanitária

DECLARAÇÃO

Processo nº: 8033666223

A Gerência de Vigilância Sanitária, **CONCEDE** a presente **DECLARAÇÃO DE TRAMITAÇÃO**, processo nº **8033666223**, conforme dados abaixo:

1. Dados do Empreendimento

Nome/Razão SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 37.438.274/0001-77
Endereço: AV CAXANGA, 205
SALA 0201 EMP CAXANGA TRADE CENTER
MADALENA - RECIFE/PE

Sequencial do Imóvel: **461916.1**

Inscrição Mercantil: **679.522-6**

Saliente-se que esta declaração deve ser autenticada/validada através do selo ou link descrito abaixo, ficando a declarada obrigada a acompanhar o trâmite do *supra* referido processo de obtenção de sua Licença Sanitária(RENOVAÇÃO), velando pelo cumprimento das exigências que surjam para a consecução de tal fim, sob pena de incorrer em infração sanitária nos termos de legislação pertinente.

Data de solicitação: 02/05/2023

Data da emissão: 02/05/2023



Para verificar a autenticidade/validade deste documento, acesse o link <https://processos.recife.pe.gov.br/pcr-urbanistico/externo/exibircertificado/exibir-certificado.action> e digite o código existente no rodapé do selo

RECEBEMOS DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Recife - 37.438.274/0001-77		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 001440	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA	2.148,00
		DATA DE EMISSÃO	11/07/2022
		SÉRIE 1	

 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Avenida Caxanga, 205, sala 201 - Madalena Recife - PE - CEP 50 610-230 - FONE: (81) 3071-7903	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 1440 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2622 0737 4382 7400 0177 5500 1000 0014 4011 9331 5992 4433 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
		

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT DE AUTORIZAÇÃO 126220062084783 11/07/2022 17:43:57	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			
CPT (Código de Pagamento)		INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTARIA	
3 - Regime Normal		37.438.274/0001-77	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 089205839		CNPJ/CPF 10.583.920/0008-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL		10.583.920/0008-00		11/07/2022	
HOSPITAL DO TRICENTENARIO					
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	
RODOVIA BR 104, 756		LUIZ GONZAGA		55.015-901	
MUNICÍPIO		UF		PAÍS	
Caruaru		PE		Brasil	
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
(81)8725-7753				17:43:57	

FATURA		VALOR ORIGINAL		DESCONTO		VALOR LIQUIDO	
NUMERO FATURA		2.148,00		0,00		2.148,00	
1440							

DUPLICATA		VALOR		VALOR		VALOR	
NUMERO		10/08/2022		2.148,00			
001							

FORMA DE PAGAMENTO		VALOR		FORMA PAGAMENTO		VALOR	
Boleto Bancario		2.148,00					

CÁLCULO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		2.148,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO CEGUPO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		78,40	
								2.148,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ	
RAZÃO SOCIAL		REMETENTE								32.051.694/0001-82	
MOD LOG SERVICOS DE TRANSPORTES		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Rua Professor José Brasileiro Vila Nova 913 Galpão C Sala B		Recife						PE		080221785	
QUANTIDADE		ESPECIE		MAFCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
1						0		4,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS		NCM SH		ORIG.CST		CFOP		UNID		QTD		VLR UNIT		DESC		VLR TOTAL		V TRIB		BC ICMS		VLR ICMS		VLR IPI		ALÍQUOTAS ICMS		ALÍQUOTAS IPI	
CÓDIGO		DISC. DEB. DO PRODUTO																											
5310		GUIA DE TROCA P/ANGIOPLASTIA PTFE DS-B-035 PONTA J 0 035" 150CM		90183929		2/40		5102		UNID		100,0000		21,4800				2.148,00		78,40						0,00		0,00	
		- XIAMEN																											
		LT 32112011 Val 09/01/25 UNID 100																											

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Ref do Cliente OC14474-1010626			
Forma de PGT: BoletoBB			
Resumo por Listas			
Positiva R\$ 0,00			
Negativa R\$ 0,00			
Neutra R\$ 0,00			
Outras R\$ 0,00			
Item = 5310 ICMS ISENTA Conforme CONVENIO 01/99 LIVRO I, ART 9, UNC XCVIII, DEC 37699/97			

RECEBEMOS DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Recife - 37.438.274/0001-77		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 001460	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA	44,70
		DATA DE EMISSÃO	12/07/2022
		SÉRIE	1

 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Avenida Caxanga, 205, sala 201 - Madalena Recife - PE - CEP: 50.610-230 - FONE: (81) 3071-7903	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 1460 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO: 2622 0737 4382 7400 0177 5500 1000 0014 6014 4180 4073 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROT DE AUTOPIDÇÃO
Remessa de amostra gratis	126220082507401 12/07/2022 16:16:31
CPT (Codigo de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
3 - Regime Normal	089205839
	INSC. EST-DUAL SUBST. TRIBUTARIA
	37.438.274/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		10.583.920/0008-00	12/07/2022
HOSPITAL DO TRICENTENARIO			
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
RODOVIA BR 104, 756		LUIZ GONZAGA	55.015-901
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Caruaru	PE	Brasil	12/07/2022
		FONE/FAX	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		(81)8725-7753	16:16:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FORMA DE PAGAMENTO		VALOR	
FORMA PAGAMENTO		VALOR	
Sem Pagamento		0,00	
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		44,70	
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLP APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL E NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FFETE POR UNIDADE	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CEP
PAZÃO SOCIAL						
IOD LOG SERVICOS DE TRANSPORTES		REMETENTE	32.051.694/0001-82			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PE			
Rua Professor José Brasileiro Vila Nova 913 Galpão C Sala B		Recife	080221785			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1			0	0,200		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG. CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	VLR IPI	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
5316	SN03 - CANULA DE PUNCAO 18G x 70mm C/ALETA TOTAL - Total Life Com e Prod - SP LT 20211210 Val 30 11:24 UNID 2	90183929	2/40	5911	UNID	2,0000	14,9000		29,80				0,00	0,00	
5381	SN03a - CANULA DE PUNCAO 18G x 70mm S/ALETA TOTAL - Total Life Com e Prod - SP LT 20211210 Val 30 11:24 UNID 1	90183929	2/40	5911	UNID	1,0000	14,9000		14,90				0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref do Cliente - Forma de PGTO: BoletoBB Resumo por Listas Positiva: R\$ 0,00 Negativa: R\$ 0,00 Neutra: R\$ 0,00 Outras: R\$ 0,00 Item = 5316 - ISENTOS DE ICMS CONFORME CONVENIO 1/99 - PUBLICADO NO DOU 8/03/99 ALTERADO PELO CONVENIO ICMS 80/02 DE 05/07/2002 AR 14 DO ANEXO 1 - APROVADO PELO DEC 45 490/00 Item = 5381	

RECEBEMOS DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Recife - 37.438.274/0001-77		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 001579	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA	11.111,34
		DATA DE EMISSÃO	26/07/2022
		SÉRIE	1

 SELLMED SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Avenida Caxanga, 205, sala 201 - Madalena Recife - PE - CEP: 50.610-230 - FONE: (81) 3071-7903	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1579 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2622 0737 4382 7400 0177 5500 1000 0015 7919 4793 5000 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROT. DE AUTORIZAÇÃO 126220067599117 26/07/2022 17:00:17
CPT (Código de Pagamento) 3 - Regime Normal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 089205839
	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 37.438.274/0001-77

DESTINATÁRIO-REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DO TRICENTENARIO ENDEREÇO RODOVIA BR 104, 756 MUNICÍPIO Caruaru	UF PE	PAÍS Brasil	CNPJ/CFF 10.583.920/0008-00	DATA DE EMISSÃO 26/07/2022
			BAIRRO LUIZ GONZAGA	CEP 55.015-901
		FONE/FAX (81)8725-7753	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/07/2022
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:00:15

FATURA	NUMERO FATURA 1579	VALOR ORIGINAL 11.111,34	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 11.111,34
--------	-----------------------	-----------------------------	------------------	----------------------------

DUPLICATA	NUMERO 001	VENCIMENTO 25/08/2022	VALOR 11.111,34	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
-----------	---------------	--------------------------	--------------------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

FORMA DE PAGAMENTO	FORMA PAGAMENTO Boleto Bancario	VALOR 11.111,34	FORMA PAGAMENTO	VALOR
VALOR TROCO				

CÁLCULO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	11.111,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLP APROX DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,58
					VALOR TOTAL DA NOTA 11.111,34


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
P-ÇÃO SOCIAL IOD LOG SERVICOS DE TRANSPORTES					32.051.694/0001-82
ENDEREÇO Rua Professor José Brasileiro Vila Nova 913 Galpão C Sala B	MUNICÍPIO Recife			UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 080221785
QUANTIDADE 5	ESPECIE MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 20,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	ORIG. CST	CFOP	UNID	Q TDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00246	Cateter Diag AL 1 6F - NEW TECH LT 22031111 Val 10 02 25 UNID 5	90183929	2 / 40	5102	UNID	5,0000	38,0800		190,40	6,95		0,00	0,00	
00236	Cateter Diag AL 2 5F - NEW TECH LT 22031102 Val 10 02 25 UNID 3	90183929	2 / 40	5102	UNID	3,0000	38,0800		114,24	4,17		0,00	0,00	
00247	Cateter Diag AL 2 6F - NEW TECH LT 22031112 Val 10 02 25 UNID 5	90183929	2 / 40	5102	UNID	5,0000	38,0800		190,40	6,95		0,00	0,00	
00098	Cateter Diag JL 4 0 6F Alvision - ALVIMEDICA TIBBI LT 5210311083 Val 31 03 24 UNID 5	90183929	6 / 40	5102	UNID	5,0000	38,0800		190,40	6,95		0,00	0,00	
00242	Cateter Diag JR 4 0 5F - NEW TECH	90183929	2 / 40	5102	UNID	5,0000	38,0800		190,40	6,95		0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref do Cliente OC14474-1023054 Forma de PGTO BoletoBB Resumo por Listas Positiva R\$ 0,00 Negativa R\$ 0,00 Neutra R\$ 0,00 Outras R\$ 0,00 Item = 00246 Anexo Unico do Convenio ICMS 1/1999, PRORRGADO PELO CONV 28/21 ATE 31/03/2022 Item = 00236 Anexo Unico do Convenio ICMS 1/1999, PRORRGADO PELO CONV 28/21 ATE 31/03/2022 Item = 00247 Anexo Unico do Convenio ICMS 1/1999, PRORRGADO PELO CONV 28/21 ATE 31/03/2022 Item = 00098 Anexo Unico do Convenio ICMS 1/1999, PRORRGADO PELO CONV 28/21 ATE 31/03/2022 Item = 00242 Anexo Unico do Convenio ICMS 1/1999, PRORRGADO PELO CONV 28/21 ATE 31/03/2022 Item = 00243 Anexo Unico do Convenio ICMS 1/1999, PRORRGADO PELO CONV 28/21 ATE 31/03/2022 Item = 00071	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



- ACESSÓRIOS - Linha Intervencionista



NEOMEX
Hospitalar Ltda

Rua Manoel Francisco Mendes, 73 - Jd. do Trevo - CEP 13030-110 - Campinas - SP
Fone (19) 3274-0044 - Fax (19) 3274-0055
vendas@neomex.com.br

www.neomex.com.br

NEOMEX
Hospitalar Ltda

EASY VALVE

Tulip-Medical b.v.
MEDICAL DEVICES

Válvula Hemostática



- Conector Y com sistema "Push-Pull"
- Diâmetro máximo a ser inserido: 7F
- Diâmetro mínimo a ser inserido: 0,53F
- Pressão máxima com Cateter PTCA e Fio Guia: 6000 mmHg / 8atm
- Pressão máxima de resistência sem dispositivos: 16000 mmHg / 21 atm


Referência	Descrição
110001	Easy Valve – Padrão
110002	Easy Valve Plus – Com torque
110004	Easy Valve 20 Plus – Com torque e extensão de 20 cm

N-FLATOR

Insuflador 30 ATM QL2030




- Mecanismo "Quick Latch" permite a rápida deflação, mesmo em alta pressão
- Manômetro angular para fácil leitura
- Cilindro Transparente
- CE Marked e FDA



Fios Guia Accoat

Hidrofilico e Teflonado



Guia Teflonado

- Aço Inoxidável AISI 304 com revestimento em PTFE

Guia Hidrofilico – POSEIDON

- Em Nitinol revestido em Poliuretano

Modelos	Diâmetros	Comprimento	Ponta	Rigidez
Hidrofilico	0,025" / 0,63 mm	150 cm	Reta	Standard
	0,032" / 0,81 mm	180 cm	Angular	Stiff (Heavy Duty)
	0,035" / 0,89 mm	260 cm		Standard
Teflonado	0,018" / 0,46 mm	150 cm	Reta	Standard
	0,021" / 0,53 mm	150 cm		Super Stiff (Extra Heavy Duty)
	0,025" / 0,63 mm	260 cm	J3	

