

Of. nº. 5497/2023 - SEAFI

Fortaleza-CE, 15 de Dezembro de 2023

Ilmº. Sr. (a)


Alexandre Fontenele Bizerril
Pregoeiro (a) da Procuradoria-Geral do Estado
Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 – Edson Queiroz
Centro Administrativo Bárbara de Alencar
60811-500 – Fortaleza/CE

Assunto: Pregão 20230904

Senhor (a) Pregoeiro (a),

Atendendo solicitação de V.Sª, formulada por meio do e-mail da Central de Licitações, estamos encaminhando em anexo o Parecer Técnico conclusivo, atinente ao Pregão Eletrônico Registro de Preços de nº 20230904.

Atenciosamente,

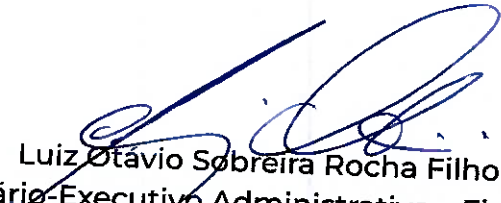

Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
Secretário-Executivo Administrativo – Financeiro

0F.5497

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 6110/2023

Item	Código	QTD	Especificação
08	635309	1.093	TUBO ENDOTRAQUEAL (3,5MM) – COM BALÃO CONFECCIONADO EM PVC, DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL E SEM EFEITO MEMÓRIA, COM LINHA RADIOPACA EM SUA EXTENSÃO, PROVIDO DE CONECTOR, BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA ADAPTÁVEL A BICO LUER E COM DISPOSITIVO ACIONÁVEL PARA ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALÃO, DEMARCADOR DE CORDAS VOCAIS, ESCALONAMENTO DE 1 EM 1 CENTÍMETRO AO LONGO DO TUBO, BORDA COM CURVATURA E ATRAUMÁTICA, NUMERAÇÃO DO DIÂMETRO DO TUBO E MARCA EM LOCAL VISÍVEL PRÓXIMO AO CONECTOR. ESTÉRIL, EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA
11	372440	1.550	TUBO ENDOTRAQUEAL (5,5MM) – COM BALÃO, CONFECCIONADO EM PVC, DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL E SEM EFEITO MEMÓRIA, COM LINHA RADIOPACA EM SUA EXTENSÃO, PROVIDO DE CONECTOR, BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA ADAPTÁVEL A BICO LUER E COM DISPOSITIVO ACIONÁVEL PARA ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALÃO, DEMARCADOR DE CORDAS VOCAIS, ESCALONAMENTO DE 1 EM 1 CENTÍMETRO AO LONGO DO TUBO, BORDA COM CURVATURA E ATRAUMÁTICA, NUMERAÇÃO DO DIÂMETRO DO TUBO E MARCA EM LOCAL VISÍVEL PRÓXIMO AO CONECTOR. ESTÉRIL, EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.
14	372514	895	TUBO ENDOTRAQUEAL (9,0MM) – COM BALÃO, CONFECCIONADO EM PVC, DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL E SEM EFEITO MEMÓRIA, COM LINHA RADIOPACA EM SUA EXTENSÃO, PROVIDO DE CONECTOR, BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA ADAPTÁVEL A BICO LUER E COM DISPOSITIVO ACIONÁVEL PARA ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALÃO, DEMARCADOR DE CORDAS VOCAIS, ESCALONAMENTO DE 1 EM 1 CENTÍMETRO AO LONGO DO TUBO, BORDA COM CURVATURA E ATRAUMÁTICA, NUMERAÇÃO DO DIÂMETRO DO TUBO E MARCA EM LOCAL VISÍVEL PRÓXIMO AO CONECTOR. ESTÉRIL, EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA

EMPRESA: DE PAULI

MARCA: SOLIDOR

REFERÊNCIA: ITEM 08- 640, ITEM 11- 644, ITEM 14-651

FABRICANTE: BONREE

REGISTRO MS: 10369460219

LOTE: 28223051 ITEM 08, 28620051 ITEM -11, 29322011 ITEM 14

VALIDADE: 05/2025, 05/2027, 01/2027

CONCLUSÃO



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde

PARECER TÉCNICO 3634/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20230904
PROCESSO Nº 01483015/2023
OFÍCIO PGE/CELIC Nº 6110/2023
DATA: 12/12/2023

☐ FAVORÁVEL

☒ DESFAVORÁVEL

Justificativa: Os itens não atendem. Após análise da amostra, constatamos que o conector se desprende do tubo com facilidade, podendo causar interrupção do fluxo de entrada de oxigênio para o paciente intubado, causando dessaturação, como consequência poderá causar parada cardiorrespiratória e principalmente se o paciente estiver em uma condição de dependência de ventilação mecânica, bem como não possui a marca em local visível próximo ao conector. Portanto, indeferimos a aquisição do produto, pois o material ofertado não corresponde ao solicitado nas especificações do termo de referência do edital.

Elaborado por:


Emannuella Arruda Rangel

ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 479.070
Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras

Elaborado por:


COREN 550963

Raquel Fernandes Alves de Almeida
ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 550963
Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras

Elaborado por:



Lícia Silva Teixeira

ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 488.884
Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras

Elaborado por:


COREN 634.672

Danielly dos Santos Rodrigues
ENF. do Parecer Técnico - MMH/ COREN 634.672
Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras

Check list Análise de parecer técnico - Lei 14.133/2021

A licitante deverá anexar no sistema junto à proposta de preços:

C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
x			Nome comercial e técnico do produto;	
x			Documento ANVISA pertinente;	
x			Referência e marca do produto;	
x			Registro do produto;	
		x	Declaração de Isenção do Registro;	
x			Cadastro do produto;	
		x	Notificação simplificada;	
		x	Cópia legível da publicação no Diário Oficial da União do mesmo;	
		x	Documento pertinente à ANVISA vencido ? Anexar cópia do protocolo de revalidação emitido à ANVISA, dentro do prazo previsto de 6 (seis) meses de antecedência ao vencimento;	
		x	Produto não sujeito ao Regime da Vigilância Sanitária? Apresentada Declaração formal da sua não sujeição ao Regime da Vigilância Sanitária, sob as penas cabíveis;	
		x	Diligência realizada a empresa ?	
x			Manual, catálogos figurativos ou folders do fabricante, impressos ou eletrônicos em língua portuguesa, contendo informações técnicas e instruções de uso completas dos materiais ofertados.	

LEGENDA:

C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde

PARECER TÉCNICO 3634/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20230904
PROCESSO Nº 01483015/2023
OFÍCIO PGE/CELIC Nº 6110/2023
DATA: 12/12/2023

Qualificação Técnica

C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
x			Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica em nome da matriz ou da filial do licitante, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado com somatório equivalente a, no mínimo, 8% do quantitativo total por item.	
x			Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE para a(s) atividade(s) que desempenha dentro da cadeia de suprimentos para saúde	
		x	Produto importado? Acrescentado AFE de importação devendo ter sido expedida pela ANVISA nos termos do art. 50 a 52 da Lei Federal No 6.360/1976 e em conformidade com a RDC nº 16 de 1º de Abril de 2014/ANVISA - Seção III Abrangência	
x			Licença de funcionamento, emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede da licitante, de acordo com art. 51 da Lei Federal No 6.360/1976.	

LEGENDA:

C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA

Danielly dos Santos Rodrigues
Enfermeira
COREN-CE 634.672-ENF

Emanuella Arruda Rangel
Enfermeira
COREN-CE 479 070

Lígia Silva Teixeira
Enfermeira
COREN - CE 488.864

Paquel Fernandes A. Almeida
Enfermeira
COREN-CE 555553

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/SESA

ATA DE REUNIÃO

Secretaria Executiva Administrativa Financeira/SEAFI
Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras /COPLA

1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO

Nº ATA	DATA	HORÁRIO DE INÍCIO	HORÁRIO DE TÉRMINO	LOCAL
106	08/12/2023	13:00	13:30	COPLA/SESA - Sala de Reunião

2. PAUTA DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
Análise da amostra referente ao PE 20230904 ITENS 08, 11 E 14 DE PAULI

3. RELATO DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
Às 13:00h do dia 12/12/2023, no setor COPLA/SESA - Sala de Reunião, esteve presente os Srs.(as) Emanuella Rangel, Raquel Fernandes, Danielly Rodrigues a fim de emitir parecer técnico referente ao PE N° 20230904, itens 08, 11 e 14 licitante DE PAULI. Uma vez realizada a análise da amostra nos moldes da cláusula 14.133/2021 do edital, foi emitido parecer técnico, o qual é parte integrante desta ata como anexo. Deu-se por encerrada a reunião às 13:30h e, para constar, eu, Emanuella Rangel, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada por mim e pelos participantes.

4. PARTICIPANTES

EQUIPE TÉCNICA	SETOR	ASSINATURA
Emanuella Rangel	COPLA/SESA	Emanuella Arruda Rangel Enfermeira CREM-CE 479 07
Danielly dos Santos Rodrigues	COPLA/SESA	Danielly dos Santos Rodrigues COREN-CE 634.672-ENF
Raquel Fernandes A. de Almeida	COPLA/SESA	Raquel Fernandes A. Almeida Enfermeira COREN-CE 479 07



SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/SESA

ATA DE REUNIÃO

Secretaria Executiva Administrativa Financeira/SEAFI
Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras /COPLA

NOME DO REPRESENTANTE/INTERESSADO	EMPRESA	ASSINATURA

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 – Praia de Iracema • CEP: 60060-440
Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123



DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Rua: RUA SÃO FRANCISCO DO VERMELHO, 90 BAIRRO: ENG° GOULART
CEP: 03725-130 SÃO PAULO - SP
Telefone: (11)2621-8884
CNPJ: 03.951.140/0001-33 IE: 115.994.044.112
Email: licita02.depauli@terra.com.br

Ao Órgão 943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 904/2023

PROCESSO Nº: 01483015/2023

Item	Descrição	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
8	TUBO ENDOTRAQUEAL (3,5MM) - COM BALÃO CONFECCIONADO EM PVC, DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL E SEM EFEITO MEMÓRIA, COM LINHA RADIOPACA EM SUA EXTENSÃO, PROVIDO DE CONECTOR, BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA ADAPTÁVEL A BICO LUER E COM DISPOSITIVO ACIONÁVEL PARA ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALÃO, DEMARCADOR DE CORDAS VOCAIS, ESCALONAMENTO DE 1 EM 1 CENTÍMETRO AO LONGO DO TUBO, BORDA COM CURVATURA E ATRAUMÁTICA, NUMERAÇÃO DO DIÂMETRO DO TUBO E MARCA EM LOCAL VISÍVEL PRÓXIMO AO CONECTOR. ESTÉRIL, EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVIOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. PROCEDÊNCIA: CHINA RMS: 10369460219 MARCA: SOLIDOR FABRICANTE: BONREE MODELO/VERSÃO: COM BALÃO 3,5	1.093,00	3,63	3.967,59
11	TUBO ENDOTRAQUEAL (5,5MM) - COM BALÃO, CONFECCIONADO EM PVC, DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL E SEM EFEITO MEMÓRIA, COM LINHA RADIOPACA EM SUA EXTENSÃO, PROVIDO DE CONECTOR, BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA ADAPTÁVEL A BICO LUER E COM DISPOSITIVO ACIONÁVEL PARA ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALÃO, DEMARCADOR DE CORDAS VOCAIS, ESCALONAMENTO DE 1 EM 1 CENTÍMETRO AO LONGO DO TUBO, BORDA COM CURVATURA E ATRAUMÁTICA, NUMERAÇÃO DO DIÂMETRO DO TUBO E MARCA EM LOCAL VISÍVEL PRÓXIMO AO CONECTOR. ESTÉRIL, EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVIOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. PROCEDÊNCIA: CHINA RMS: 10369460219 MARCA: SOLIDOR FABRICANTE: BONREE MODELO/VERSÃO: COM BALÃO 5,5	1.555,00	3,63	5.644,65



DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Rua: RUA SÃO FRANCISCO DO VERMELHO, 90 BAIRRO: ENGº GOULART
CEP: 03725-130 SÃO PAULO - SP
Telefone: (11)2621-8884
CNPJ: 03.951.140/0001-33 IE: 115.994.044.112
Email: licita02.depauli@terra.com.br

Ao Órgão 943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 904/2023
PROCESSO Nº: 01483015/2023

Item	Descrição	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
13	TUBO ENDOTRAQUEAL (6,5MM) - COM BALÃO, CONFECCIONADO EM PVC, DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL E SEM EFEITO MEMÓRIA, COM LINHA RADIOPACA EM SUA EXTENSÃO, PROVIDO DE CONECTOR, BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA ADAPTÁVEL A BICO LUER E COM DISPOSITIVO ACIONÁVEL PARA ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALÃO, DEMARCADOR DE CORDAS VOCAIS, ESCALONAMENTO DE 1 EM 1 CENTÍMETRO AO LONGO DO TUBO, BORDA COM CURVATURA E ATRAUMÁTICA, NUMERAÇÃO DO DIÂMETRO DO TUBO E MARCA EM LOCAL VISÍVEL PRÓXIMO AO CONECTOR. ESTÉRIL, EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. PROCEDÊNCIA: CHINA RMS: 10369460219 MARCA: SOLIDOR FABRICANTE: BONREE MODELO/VERSÃO: COM BALÃO 6,5	1.720,00	3,63	6.243,60
Valor total da proposta:				15.855,84

O valor total dessa proposta é de R\$15.855,84 (quinze mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Dados Comerciais:

Validade da Proposta: 90 dias
Prazo de entrega : 10 dias Contados
Prazo de Pagamento: 30 dias
Validade dos Produtos: 70%


Dados Bancários

Banco Bradesco / Agência: 2750 / Conta Corrente: 8670-3

Observações:

Dados do responsável para assinatura da ATA SRP:
Nome completo: JOÃO DE SOUZA GUERREIRO
Estado Civil : Viúvo
C.P.F:756.075.738-34
R.G: 9.782.815-4 SSP
CARGO: SÓCIO - DIRETOR
Rua Catateus , nº 13-A - Jardim Piratininga - São Paulo Cep: 03716-050

SÃO PAULO , 1 de Dezembro de 2023

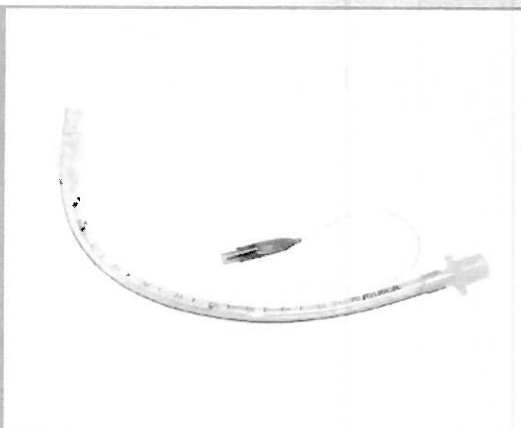

LINHA:
HOSPITALAR
MARCA:
SOLIDOR®
FABRICANTE:
BONREE MEDICAL CO. LTD
ORIGEM:
CHINA
REGISTRO ANVISA:
10369460219
CLASSE DE RISCO
II

Características Técnicas

- Acopla facilmente em material intermediário permitindo conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação.
- Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco.
- Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco.
- Modelo com Cuff (Balão).
- Produto siliconizado, facilitando a entubação.
- Ponta atraumática.
- Curva de Magil.
- Olho de Murphy.
- Marcação escalonada a cada 1 centímetro.
- Possui curvatura anatômica.
- Esterilizado por óxido de etileno.
- Produto de uso único.
- Embalados individualmente em Papel grau Cirúrgico.

Composição

- Conector: polipropileno
- Válvula ABS com mola inoxidável
- Tubo: PVC
- Manguito: PVC elástico

Indicação de Uso

Tubo de material plástico utilizado para entubação endotraqueal.

Código	Descrição	Apresentação
639	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 C/BAL C/10 SOL(BO)	Caixa com 10 unidades
640	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 C/BAL C/10 SOL(BO)	Caixa com 10 unidades
641	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.0 C/BAL C/10 SOL(BO)	Caixa com 10 unidades
642	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 C/BAL C/10 SOL(BO)	Caixa com 10 unidades
643	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 C/BAL C/10 SOL(BO)	Caixa com 10 unidades
644	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 C/BAL C/10 SOL(BO)	Caixa com 10 unidades
645	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 C/BAL C/10 SOL(BO)	Caixa com 10 unidades
646	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 C/BAL C/10 SOL(BO)	Caixa com 10 unidades
647	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 C/BAL C/10 SOL(BO)	Caixa com 10 unidades
648	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 C/BAL C/10 SOL(BO)	Caixa com 10 unidades
649	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 C/BAL C/10 SOL(BO)	Caixa com 10 unidades
650	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 C/BAL C/10 SOL(BO)	Caixa com 10 unidades
651	TUBO ENDOTRAQUEAL 9.0 C/BAL C/10 SOL(BO)	Caixa com 10 unidades
652	TUBO ENDOTRAQUEAL 9.5 C/BAL C/10 SOL(BO)	Caixa com 10 unidades



Labor Import © - Todos direitos reservados.

CNPJ: 01.005.728/0001-79 | Inscrição Estadual: 492.315.879.112 | Sede: Rua Padre Damaso, 173 | Osasco - SP | CEP: 06016-010 | Fone/SAC: (11) 3652-2525



DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Rua: RUA SÃO FRANCISCO DO VERMELHO, 90 BAIRRO: ENGº GOULART
CEP: 03725-130 SÃO PAULO - SP
Telefone: (11)2621-8884
CNPJ: 03.951.140/0001-33 IE: 115.994.044.112
Email: licita02.depauli@terra.com.br

Representante Legal

JOAO DE
SOUZA
GUERREIRO:75
607573834

Assinado de forma digital
por JOAO DE SOUZA
GUERREIRO:75607573834
Dados: 2023.12.01
09:41:40 -03'00'

JOÃO DE SOUZA GUERREIRO

RG:9.782.815-4 SSP/SP

CPF:756.075.738-34

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA COLEGIADA

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.418, DE 6 DE SETEMBRO DE 2001 (*)

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere a Portaria nº 724, do Diretor-Presidente, de 10 de outubro de 2000, considerando o inciso V do art. 44 e o § 3º do art. 111 do Regulamento Interno aprovado pela Portaria nº 593, de 25 de agosto de 2000, republicada no DOU de 22 de dezembro de 2000; considerando o art. 2º, da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, resolve:

Art. 1º Conceder as alterações na autorização de funcionamento das empresas constantes no anexo desta resolução.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

GONZALO VECINA NETO

ANEXO

Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde
Alteração na Autorização de Funcionamento

Nome da Empresa / Razão Social	No. Autorização	Dt. Autorização
No. CGC	No. Processo	Bairro
Endereço	Numero	UF
CEP	Município	

Classe
Atividades:

ACUSTICA AMPLIVOX LTDA	103.932-8
90.817.0004/0001-34	31/03/1999
AV ADOLFO FETTER	LARANJAL
95.083-000	RS
ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/RESPONSÁVEL TÉCNICO	

CORRELATO
DISTRIBUIR IMPORTAR

A C DE ANDRADE SOARES & CIA LTDA	102.781-3
00.089.343/0001-74	09/06/1995
RUA MINAS GERAIS	CENTRO
85.002-690	PR
ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL/RESPONSÁVEL TÉCNICO	

CORRELATO
ARMAZENAR EMBALAR DISTRIBUIR ESTERILIZAR
TRANSPORTAR

AMETECH TRADING LTDA	103.340-2
01.207.189/0001-50	05/11/1997
AV JOAO GUALBERTO	ALTO DA GLORIA
60.030-001	PR
ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO	

CORRELATO
ARMAZENAR DISTRIBUIR EXPORTAR IMPORTAR

MAYKI COMERCIAL LTDA	104.247-9
02.649.090/0001-71	12/07/1999
RUA MORGADO DE MATEUS	VILA MARIANA
04.015-051	SP
ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL	

CORRELATO
DISTRIBUIR

TOTAL DE EMPRESAS IMPRESSAS - 04

(*) Republicada por ter sido com incorreção, do original, no D.O. nº 173-E, de 10/9/2001, Seção 1, pág. 71.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.419, DE 6 DE SETEMBRO DE 2001 (*)

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere a Portaria nº 724, do Diretor-Presidente, de 10 de outubro de 2000, considerando o inciso V do art. 44 e o § 3º do art. 111 do Regulamento Interno aprovado pela Portaria nº 593, de 25 de agosto de 2000, republicada no DOU de 22 de dezembro de 2000; considerando o art. 2º, da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, resolve:

Art. 1º Conceder os pedidos de autorização de funcionamento das empresas constantes no anexo desta resolução.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

GONZALO VECINA NETO

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.979-9
Av. Presidente Dutra, 140 - Sala 101 - Centro - Curitiba - PR - CEP 81.530-000 - Fone: (41) 324.0001

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do Art. 1º e 5º da Lei Federal 8.932/1994 e Art. 5º da Lei 11.140/2005, substituído a presente impressão digitalizada, reprodução fiel do documento original e assinado por: O. Azevedo Bastos, O. A.

Cód. Autenticação: 64552108170902550055-1; **Data:** 21/08/2017 09:09:1

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C - AFO51328-ZSR5.
Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Gerência-Geral
Concessão de A

Nome da Empresa
No. CGC
Endereço
CEP

No. Processo
Número
Município

UF
Bairro

Classe
Atividades:

BRASHEED IMPLANTES ESPECIALIZADOS LTDA	800.827-4
01.774.565/0001-76	02829/01-52
AV PRESIDENTE KENNEDY	1341/34
54.420-050	JABOATÃO DOS GUARARAPES
	PE

CORRELATO
ARMAZENAR DISTRIBUIR IMPORTAR

BIOEXTRA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	800.828-8
04.309.665/0001-60	25559/01-39
RUA DA PRATA	1008
06.410-000	BARUERI
	JARDIM DOS CAMARGOS
	SP

CORRELATO
ARMAZENAR EMBALAR DISTRIBUIR TRANSPORTAR
EXPEDIR

CIEHLABOR IND COM INF EXP PROD HOSP E ESCOLARES LTDA	800.829-1
02.814.380/0001-05	0079/01-74
RUA GERALDO COSTA	382
58.038-130	JOÃO PESSOA
	PB

CORRELATO
ARMAZENAR EMBALAR DISTRIBUIR EXPORTAR
IMPORTAR REEMBALAR TRANSPORTAR EXPEDIR

CIRURGICA CLIMAZA COM REP E ASSIST TECNICA LTDA	800.830-3
01.551.303/0001-41	01609/01-68
RUA AGUAS MORNAS	025
68.110-520	SAO JOSE
	BELA VISTA I
	SC

CORRELATO
DISTRIBUIR

DE PAULI COM REP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	800.831-7
03.951.140/0001-33	21352/01-48
RUA SAO FRANCISCO DO VERMEIRO 90	ENGENHEIRO GOULART
03.725-130	SAO PAULO
	SP

CORRELATO
ARMAZENAR DISTRIBUIR IMPORTAR

DIAGNOLINE PROD DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA	800.832-0
68.668.417/0001-60	25112/01-97
ESTRADA DE JACAREPAGUA	7705/307
22.753-045	RIO DE JANEIRO
	JACAREPAGUA
	RJ

CORRELATO
ARMAZENAR DISTRIBUIR EXPORTAR IMPORTAR

EDM COMERCIAL LTDA - ME	800.833-4
37.173.515/0001-01	24438/01-89
SCS QUADRA 01 BL L	17/BLJ 21
70.300-500	BRASILIA
	ASA SUL
	DF

CORRELATO
DISTRIBUIR

GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA	800.834-8
03.142.794/0002-95	021035/01-04
AV NOBRA SRA DE FATIMA	2363
30.710-020	MELO HORIZONTE
	CARLOS PRATES
	MG

CORRELATO
ARMAZENAR EMBALAR DISTRIBUIR EXPORTAR
FABRICAR REEMBALAR EXPEDIR TRANSPORTAR

GONZALO VECINA NETO

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

de pauli comercio representação importação e exportação ltda

CNPJ

03.951.140/0001-33

Nome Fantasia**Endereço na Internet****SAC****Endereço Completo**RUA SAO FRANCISCO DO VERMELHO 90 - ENGENHEIRO
GOULART CEP: 07.055-170**Cidade/UF**

SÃO PAULO/SP

Responsável Técnico*[sem dados cadastrados]***Responsável Legal***[sem dados cadastrados]*

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.00831-7

Data do Cadastro

17/09/2001

Situação

Ativa

Nº do Processo2155201.48**Cadastro**8 - Produtos para Saúde
(Correlatos)**Atividades / Classes****Armazenar**

- Correlato

Distribuir

- Correlato

Importar

- Correlato

Voltar




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 03.951.140/0001-33, com sede na Rua São Francisco do Vermelho, 90 – Engenheiro Goulart – São Paulo/SP, forneceu a esta entidade, os produtos abaixo discriminado:

QTD	UNIDADE	MATERIAL	PERÍODO	NF	EMPENHO
240	Unid.	Curativo Hidrocoloide 15x15	10/02/2015	26.836	2015NE00881
1.982	Unid.	Seringa desc.50/60 ml s/ag cateter	12/02/2015	26.885	2015NE00498
12.000	Unid.	Luva vinil sem talco Pequena	04/03/2015	27.193	2015NE04582
1.200	Unid.	Sonda endotraqueal 7.0	04/03/2015	27.194	2015NE04708
1.400	Unid.	Scalp 19 c/disp. Segurança	06/03/2015	27.239	2015NE04805
2.700	Unid.	Sonda uretral 08	19/03/2015	27.432	2015NE05586
170	Unid.	Sonda uretral 14	19/03/2015	27.432	2015NE05586
120.000	Unid.	Pulseira adulto branca vinil	23/03/2015	27.489	2015NE05699
800	Unid.	Canula de guedel N-04	08/04/2015	27.751	2015NE07423
50	Unid.	Dreno Kerr N 12	08/04/2015	27.751	2015NE07423
25	Unid.	Sonda aramada PVC 4.0mm	08/04/2015	27.751	2015NE07423
12	Unid.	Canula traqueostomia metal 4 longa	15/04/2015	27.864	2015NE07757
2.600	Unid.	Cateter intravenoso 14G	24/04/2015	28.006	2015NE07845
300	Unid.	Pulseira mãe e RN branca vinil	06/05/2015	28.191	2015NE08216
375	Unid.	Sonda endotraqueal 8.5 med	15/05/2015	28.368	2015NE09802
50	Unid.	Sonda endotraqueal 9.5 med	21/05/2015	28.465	2015NE10004




SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual
DA - Departamento de Administração
Avenida Ibirapuera, 981 - Vila Clementino - Cep: 04029-000




Informamos ainda, que não constam em nossos registros nada que a desabone com referência a qualidade, prazo, condições de negócio, prestação de serviços, manutenção e prazo de entrega dos referidos materiais, restringindo somente para a nota fiscal acima citada.

E, para que produza efeitos legais, firma o presente.

São Paulo, 03 de Julho de 2015.

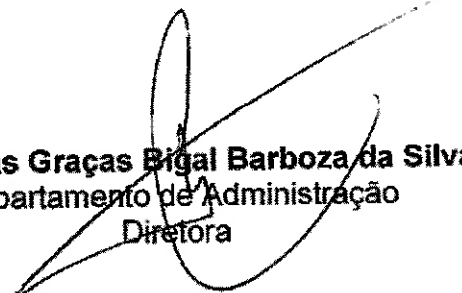
Maria das Graças Bigal Barboza da Silva
Departamento de Administração
Diretora

www.iamspe.sp.gov.br

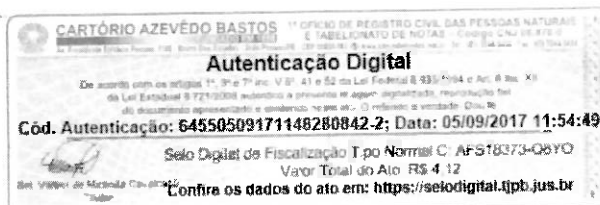

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CMVS: **355030801-464-000126-1-0**

DATA DE VALIDADE: **20/08/2024**

Nº PROCESSO:

Nº PROTOCOLO:

6018.2020/0075558-7

DATA DO PROTOCOLO: **05/11/2020**

SUBGRUPO:

DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA

AGRUPAMENTO:

**COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A
SAÚDE**

ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:

**4645-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO,
CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS**

OBJETO LICENCIADO:

ESTABELECIMENTO

DETALHE:

RAZÃO SOCIAL:

DE PAULI COM. E REPR. IMP. E EXP. LTDA

CNPJ ALBERGANTE:

NOME FANTASIA:

DE PAULI COM. E REPR. IMP. E EXP. LTDA

CNPJ / CPF:

03.951.140/0001-33

LOGRADOURO:

R. SÃO FRANCISCO DO VERMELHO

NÚMERO: **90**

COMPLEMENTO:

BAIRRO:

ENG. GOULART

MUNICÍPIO:

SÃO PAULO

CEP:

03725-130

UF: **SP**

PÁGINA DA WEB:

RESPONSÁVEL LEGAL: **JOÃO DE SOUZA GUERREIRO**

CPF: **75607573834**

CONSELHO REGIONAL: **N/A**

Nº INSCR. CONSELHO PROF:

UF: **SP**

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **IZILDA PILUTTI DE SOUZA**

CPF: **11898157880**

CONSELHO REGIONAL: **COREN**

Nº INSCR. CONSELHO PROF: **320881**

UF: **SP**

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIANº CMVS: **355030801-464-000126-1-0**DATA DE VALIDADE: **20/08/2024****CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS****CLASSE DE PRODUTO:**

PRODUTOS PARA SAÚDE

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

TRANSPORTE PRÓPRIO

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SÃO PAULO

CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRIR-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTES DOCUMENTOS.

ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

SÃO PAULO

LOCAL

20/08/2021

DATA DE DEFERIMENTO

Codigo de Validação: 1629842629259

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: <https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/>



Ofício Almoxarifado nº 001/2012

São Paulo, 18 de Janeiro de 2012.


ATESTADO DE IDONEIDADE E CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de participação de concorrência pública, atendendo ao artigo 3 da Lei Federal de nº 8.666/93, que a empresa **DE PAULI Com. Repr. Imp. e Exp. Ltda**, sediada à Rua São Francisco do Vermelho nº 90, Engº Goular, cidade de São Paulo, inscrita no C.N.P.J sob o nº 03.951.140/001-33, Inscrição estadual nº 115.994.044.112, no ramo de Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, forneceu os materiais abaixo mencionados sendo os mesmos utilizados e constatada a sua qualidade e eficiência, bem como entregue os materiais dentro dos prazos contratados e característicos dos fornecimentos a serem prestados.

Descrição Produto	Unidade	Data Emissão	Nota Fiscal	Qtde.
Canula de Guedel Nº 02	Unid.	08/10/2010	1.521	180
Canula de Guedel Nº 03	Unid.	08/10/2010	1.521	98
Canula de Guedel Nº 04	Unid.	08/10/2010	1.521	120
Canula de Guedel Nº 05	Unid.	08/10/2010	1.521	60
Canula de Traqueo. Desc. Est. c/ Balão Nº 10,0	Unid.	08/10/2010	1.521	09
Canula de Traqueo. Desc. Est. c/ Balão Nº 4,0	Unid.	08/10/2010	1.521	180
Canula de Traqueo. Desc. Est. c/ Balão Nº 5,0	Unid.	08/10/2010	1.521	90
Canula de Traqueo. Desc. Est. c/ Balão Nº 6,5	Unid.	08/10/2010	1.521	178
Canula de Traqueo. Desc. Est. c/ Balão Nº 7,0	Unid.	08/10/2010	1.521	288
Canula de Traqueo. Desc. Est. c/ Balão Nº 7,5	Unid.	08/10/2010	1.521	270
Canula de Traqueo. Desc. Est. c/ Balão Nº 8,0	Unid.	08/10/2010	1.521	175
Canula de Traqueo. Desc. Est. c/ Balão Nº 8,5	Unid.	08/10/2010	1.521	83
Canula de Traqueo. Desc. Est. c/ Balão Nº 9,0	Unid.	08/10/2010	1.521	106
Canula de Traqueo. Desc. Est. s/ Balão Nº 9,5	Unid.	08/10/2010	1.521	40
Canula de Traqueo. Desc. Est. s/ Balão Nº 5,0	Unid.	08/10/2010	1.521	180
Canula de Traqueo. Desc. Est. s/ Balão Nº 5,5	Unid.	08/10/2010	1.521	30

Att.: **Carlos Alberto Gomes Pereira**
Diretor Técnico de Divisão de H.G.V.P.

Av. Ministro Petrônio Portela, 1.642 – Freguesia do Ó – S

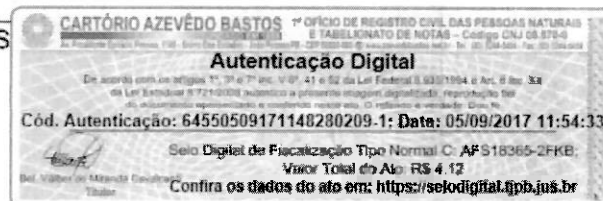



Emanuella Arruda Rangel <emanuella.rangel@saude.ce.gov.br>

INFORMAÇÃO DA ANALISE DE AMOSTRA PE 20230904

1 mensagem

PROPOSTAS <propostas.mmh@saude.ce.gov.br>

8 de dezembro de 2023 às 13:32

Para: licitacao@pge.ce.gov.br, Aline Brauna <aline.brauna@pge.ce.gov.br>

Bom dia,

Informamos que a análise da amostra do PE 20230904, item 08, 11, 13 E 14 , EMPRESA DE PAULI será:

Data da análise: 12/12/2023

Horário: 13H.

Local: Secretaria de saúde do estado do Ceará

Endereço: AV. ALMIRANTE BARROSO, 600, PRAIA DE IRACEMA

FORTALEZA, CE

SALA COPLA/SESA 1º ANDAR -BLOCO A

**Parecer Técnico-MMH
COPLA/SESA**

Fone (85) 31015127

E-mail: propostas.mmh@saude.ce.gov.br

**Secretaria da Saúde do
Estado do Ceará**

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema

CEP: 60060-440 | Fortaleza/CE

Fone: (85) 3101.5123



www.saude.ce.gov.br

