




PREFEITURA DE  
**PACATUBA**

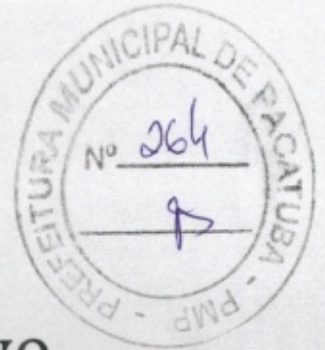

Processo Administrativo  
**PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Nº 09.006/2026-PE**

**IMPUGNAÇÃO 04**  
**EMPRESA: CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL.**

**BLL**

O  
Município de Pacatuba  
Secretaria de Saúde  
Pacatuba/CE

Pregão Eletrônico Nº 09.006/2026-Pe  
Processo Administrativo 09.012/2026

Ref.: Pedido de revisão do Termo de Referência – Lote 02

Ilmo. Pregoeiro(a) e Comissão de Licitação,

A empresa **Canon Medical Systems do Brasil Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº **46.563.938/0014-35**, vem, respeitosamente, à presença desta Comissão, com fundamento no **art. 64, §1º, da Lei nº 14.133/2021**, apresentar pedido de **revisão e esclarecimento** acerca do **Anexo I – Termo de referência – Lote 02 – Tomógrafo Computadorizado Helicoidal**, pelos fundamentos técnicos e jurídicos a seguir expostos.

### 1. Dos ajustes e esclarecimentos

De acordo com as especificações técnicas presentes do termo de referência, há diversas incoerências e solicitações dispensáveis que restringem o certame ou até mesmo impedem que exista, pelo menos, 03 players que possam ofertar soluções compatíveis. Cada fabricante possui seu projeto de equipamento (muitas vezes imutáveis) mas que se adequam totalmente às demandas das instituições hospitalares mundiais.

Nesse contexto, solicitações fora de contexto ou incompatíveis com a rotina de tomografia computadorizada podem comprometer o seguimento do certame além da qualidade do equipamento a ser prospectado pelo órgão público. Note, destacado abaixo, algumas dessas solicitações que trazem interpretações incoerentes:


TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO HELICOIDAL MULTISLICE TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO HELICOIDAL MULTISLICE DE 16 CANAIS DE ALTA PERFORMANCE, EQUIPAMENTO PARA USO GERAL, MULTISLICE, COM MÍNIMO DE 16 CORTES, UTILIZADO PARA GERAR IMAGENS DE TOMOGRAFIA DOS ÓRGÃOS DE PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS, COM SISTEMA DE CONTROLE AUTOMÁTICO DO MAS PARA REDUÇÃO DE DOSE ABERTURA MÍNIMA DE GANTRY DE 65 CM, FAIXA DE ANGULAÇÃO MÍNIMA DE  $\pm 30^\circ$ , SISTEMA DE AQUISIÇÃO DIGITAL, TEMPO DE CORTE TOTAL (360°) DE 1 SEGUNDO OU MENOR, CAPACIDADE PARA AQUISIÇÃO HELICOIDAL CONTÍNUA SEM INTER CORRUPÇÃO, MÍNIMO DE 90% DO TEMPO DO TUBO (360°) DE EXPOSIÇÃO, ÂNGULO DE ROTAÇÃO CONTÍNUO, FAIXA ATIVA MÍNIMA DO FEIXE DE 20 MM, MÁQUINA EQUIPADA COM TUBO DE RAIOS X COM ÂNODO ROTATÓRIO E FOCO NOMINAL DE 0,6 X 1,3 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DO ÂNODO DE 8,0 MHU, CAPACIDADE MÍNIMA DO ÂNODO DE 3,5 MHU, CAPACIDADE MÍNIMA DO GERADOR DE 40 KW, COMPRIMENTO MÍNIMO DO DETECTOR DE 160 CM, SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS DE 16 CORTES MULTISLICE COM, NO MÍNIMO, 16 FILEIRAS DE DETECTORES, CORTES DE 1 MM OU MENOR COM COBERTURA DO DETECTOR DE PLO MENOS 10-1, PITCH MÍNIMO DE 0,6 E MÁXIMO DE 1,8, CAMPO DE VISÃO MÍNIMO DE 50 CM, RECONSTRUÇÃO DE IMAGENS EM TEMPO REAL COM POSSIBILIDADE PARA OUTROS MODOS DINÂMICOS E OTIMIZAÇÃO DE DOSE, SISTEMA DE RECONSTRUÇÃO ITERATIVA, MESA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG E COM DESLOCAMENTO HORIZONTAL E VERTICAL, SISTEMA DE INTERCOMUNICADOR, SISTEMA DE LASER PARA POSICIONAMENTO DO PACIENTE, SISTEMA DE BACKUP DE ENERGIA, SISTEMA DE ANCORAGEM DO PACIENTE, SISTEMA DE DIAGNÓSTICO PRÉ-PROGRAMADO PARA IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS, SISTEMA DE AQUISIÇÃO VOLUMÉTRICA PARA RECONSTRUÇÃO MULTIPLANAR (2D/3D), SOFTWARE DE RECONSTRUÇÃO DE IMAGENS, SOFTWARE DE ANGIOGRAFIA (MIP), SOFTWARE PULMONAR (MRP) E SOFTWARE PARA ESTUDOS DINÂMICOS (DYNAMIC) - ALÉM DE REGISTRO NA ANVISA VIGENTE.

(Captura de tela retirada do termo de referência, página 12)

Dessa forma, visando melhor dimensionamento em conformidade com as necessidades da instituição que, supostamente, desempenhará uma ampla atividade de atendimento relacionado à rotina em tomografia computadorizada, enviamos um sugestivo de termo de referência (sem direcionamento) para que possa ser utilizado, permitindo ampla participação de forma isonômica.

# Canon

CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL

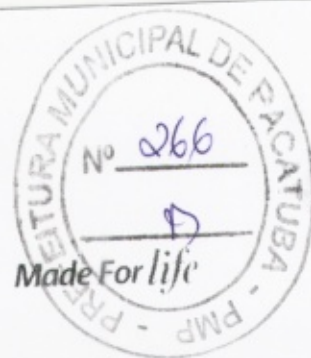

## 2. Prazo de Entrega

**Prazo solicitado:** até **180 (cento e oitenta) dias**, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou documento equivalente.

### Justificativas Técnicas e Administrativas

#### 1. Fabricação sob demanda e customização técnica:

O equipamento em questão é **produzido sob encomenda**, conforme as **especificações técnicas, operacionais e de infraestrutura** definidas pelo órgão contratante. Esse processo inclui a **configuração de hardware e software específica para o ambiente de instalação**, bem como a calibração e os testes de controle de qualidade realizados na origem, o que demanda um prazo de produção estendido.

#### 2. Origem e logística internacional:

Trata-se de **bem de origem japonesa**, cuja **cadeia de suprimentos** depende de **componentes importados de alta precisão tecnológica**. Assim, o prazo solicitado considera:

- o Tempo de **fabricação e montagem na planta industrial no Japão**;
- o **Transporte marítimo ou aéreo internacional**, sujeito a cronogramas logísticos e trâmites alfandegários;
- o **Processos de nacionalização e desembaraço aduaneiro**, etapas que, por sua natureza, não dependem exclusivamente do fornecedor, mas de órgãos de controle e fiscalização federais.

Dessa forma, o prazo de até **180 (cento e oitenta) dias**, revela-se **razoável, proporcional e necessário** para garantir o fornecimento adequado do equipamento, observando-se integralmente os princípios da **eficiência, economicidade e execução contratual responsável**, conforme estabelece a **Lei nº 14.133/2021**.

## 3. Do Pedido

Ante o exposto, requer-se:

1. **A revisão e/ou o devido esclarecimento** dos itens acima mencionados, de forma a garantir condições isonômicas de participação e assegurar ampla competitividade entre os licitantes;
2. **A prorrogação do prazo de entrega para até 180 (cento e oitenta) dias**, conforme fundamentação técnica apresentada.

O atendimento ao presente pleito contribui para a formulação de propostas tecnicamente adequadas às necessidades do órgão contratante, promovendo a seleção da solução mais vantajosa para a Administração Pública, em observância aos princípios da isonomia, competitividade, eficiência, julgamento objetivo e interesse público, conforme dispõe a Lei nº 14.133/2021.

A **Canon Medical Systems do Brasil Ltda.**, empresa de reconhecida atuação no mercado nacional, reitera seu interesse em participar do certame e coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos técnicos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

*Mary Satyri Eichima*  
MARY SATYRI EICHIMA  
GERENTE DE VENDAS PÚBLICAS  
RG Nº 18.157.997-2 SSP/SP  
CPF Nº 110.896.598-90

46.563.938/0014-35  
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA  
Av. Pierre Simon DE Laplace, 965  
Techno Park - CEP 13069-320  
CAMPINAS - SP