


ITEM 01- CAMA FOWLER ELÉTRICA: CAMA ELÉTRICA HOSPITALAR - Apontamento técnico de não conformidade do item (Cama Fowler Elétrica)- Modelo ofertado da marca SALUTEM. (Empresa VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE LTDA CNPJ.: 10.485.989/000124).

1. Não atende. Não deixou comprovado em seu manual registrado na Anvisa a presença de amortecedores no sistema de liberação das grades, o exigido, grades laterais com amortecedores à gás para reduzir o impacto ao baixar.
2. O produto não possui características e tampouco é informado em seu manual o diâmetro dos rodízios, o exigido rodízio antirruídos e antiestéticos, de 150 mm de diâmetro no mínimo.
3. O produto não especifica/comprova a quantidade de motores/atuadores, o exigido ter no mínimo 04 motores/atuadores.
4. Não atende. Altura mínima do produto ofertado é de 52cm, o exigido menor ou igual a 40cm.
5. Não atende. Não possui extensor, o exigido extensor de leito não inferior 15cm.
6. Não atende. Comprimento do produto ofertado é de 1980mm, o exigido mínimo 200cm.
7. Não atende. O produto ofertado possui 12 graus, o exigido mínima 15 graus.

ITEM 09- POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL EM ATÉ 04 POSIÇÕES. Apontamento técnico (Poltrona Hospitalar Reclinável UNIMÓVEIS), atende as exigências. (Empresa ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA – CNPJ.: 40.295.063/0001-37).

ITEM 11- CARRO MACA AVANÇADO. Apontamento técnico (Carro Maca Avançado) não atende as exigências.(Empresa HIGH-TECH MÓVEIS HOSPITALARES LTDA CNPJ.: 28.223.650/0001-15).

1. Não apresentou documentos complementares (catálogo), conforme item 10.23.4 do edital.

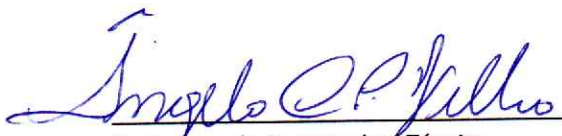

Assinatura do Responsável Técnico

Nome: Ângelo Cândido Pereira Filho

Cargo/Função: Diretor Administrativo do Hospital

Paulista-PB; 24/02/2026.