

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 530409000232025000013

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE - CÂNULAS DE TRAQUEOSTOMIA E SONDAS, por item, em caráter emergencial para atender as necessidades do HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE - HRA.


1. Da Justificativa da Contratação

1.1. Considerando se tratar de produtos para saúde padronizados, bem como a necessidade de suprimento de demanda existente, derivada da **SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 530409000232025000013**, emitida pelo Setor de Farmácia do HRA, com o objetivo de **AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE - SONDAS FOLEY E SONDAS ARAMADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE**, por item, para o período de 03(três) meses.


2. Da Justificativa do Quantitativo

2.2. O quantitativo estimado para a Dispensa de Licitação teve como base a média histórica de consumo mensal dos produtos para saúde utilizados nesta Unidade de Saúde.

ITEM	E-FISCO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNIDADE	QUANTIDADE E PARA 02 MESES
1	176885	SONDA FOLEY - EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, ESTERIL, COM BALAO DE ATE 30 ML, COM 2 VIAS, NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 14, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE	UNIDADE	120
2	176907	SONDA FOLEY - EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, ESTERIL, COM BALAO DE ATE 30 ML, COM 2 VIAS, NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 16, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE	UNIDADE	360
3	875228	SONDA FOLEY - EM COM 2 VIAS N.18, ESTERILIZADA EM BORRACHANATURAL,FLEXIVEL, SILICONIZADA, COM ANTI-, INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA COMDOIS ORIFICIOS CIRCULARES E LISOS, VALVULAS, DE BORRACHA COM DUPLO SEGMENTO PARA INFLARBALAO DE FIXACAO: 12-30 CH/FR, BALAO PARA, COM BALAO DE VOLUME DE 20 A 25 ML, COM CALIBRE E CAPACIDADEDO BALAO ESTAMPADOS EM LOCAL VISIVEL., COM EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU FILME, NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL TERMPLASTICO QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICACONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA,, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO TIPO DE ESTERILIZACAO, LOTE, VALIDADE EREGISTRO NO MS.	UNIDADE	360
4	176931	SONDA FOLEY - EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, ESTERIL, COM BALAO DE ATE 30 ML, COM 2 VIAS, NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 20, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE	UNIDADE	180
5	176940	SONDA FOLEY - EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, ESTERIL, COM BALAO DE ATE 30 ML, COM 2 VIAS, NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 22, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE	UNIDADE	120
6	177008	SONDA FOLEY - EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, ESTERIL, COM BALAO DE ATE 30 ML, COM 3 VIAS, NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 16, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE	UNIDADE	30
7	177024	SONDA FOLEY - EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, ESTERIL, COM BALAO DE ATE 30 ML, COM 3 VIAS, NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL	UNIDADE	30

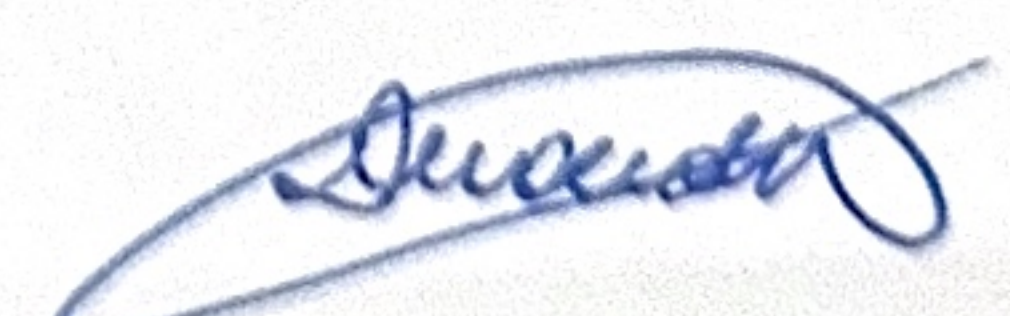

		CALIBRE 18, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE		
8	1224883	SONDA FOLEY - EM COM 3 VIAS N.20, ESTERILIZADA EM BORRACHA NATURAL, FLEXIVEL, SILICONIZADA, COM ANTI-, INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CIRCULARES E LISOS, VALVULAS, DE BORRACHA COM DUPLO SEGMENTO PARA INFLAR BALAO COM FIXACAO: 12-30 CH/FR, BALAO PARA, COM BALAO DE VOLUME DE 20 A 25 ML, COM CALIBRE E CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADOS EM LOCAL VISIVEL., COM EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU FILME, NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL TERMOPLASTICO QUE PERMITA ABERTURA ASEPTICA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA,, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO TIPO DE ESTERILIZACAO ,LOTE, VALIDADE,E REGISTRO NO MS.	UNIDADE	30
9	875260	SONDA FOLEY - EM 100% SILICONE, SILICONIZADA, ESTERIL, COM BALAO DE 05 ML, COM 3 VIAS, NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE NO.22, ESTAMPADA NA EXTREMIDADE DISTAL, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE	UNIDADE	30
10	2250284	SONDA ENDOTRAQUEAL - 4,5 ARAMADA, REUSAVEL COM CUFF, BORRACHA NATURAL, ATOXICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE	UNIDADE	30
11	3817768	SONDA ENDOTRAQUEAL - N° 5,0, ARAMADA,DESCARTAVEL, FLEXIVEL, COM CUFF,EM PVC, ATOXICA, REFORCADA INTERNAMENTE COM FIO DE ACO INOX,ROTULO COM N. LOTE, DATA FABRICAO/VALIDADE E PROCEDENCIA	UNIDADE	30
12	3817806	SONDA ENDOTRAQUEAL - N° 5,5, ARAMADA,DESCARTAVEL, FLEXIVEL, COM CUFF,EM PVC, ATOXICA, REFORCADA INTERNAMENTE COM FIO DE ACO INOX,APRESENTANCAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.	UNIDADE	50
13	3817822	SONDA ENDOTRAQUEAL - N° 6,0, ARAMADA,DESCARTAVEL, FLEXIVEL, COM CUFF,EM PVC, ATOXICA, REFORCADA INTERNAMENTE COM FIO DE ACO INOX,A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE.	UNIDADE	60
14	3817849	SONDA ENDOTRAQUEAL - N° 6,5, ARAMADA,DESCARTAVEL, FLEXIVEL, COM CUFF,EM PVC, ATOXICA, REFORCADA INTERNAMENTE COM FIO DE ACO INOX,A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	UNIDADE	60
15	1888102	CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA - TUBO ARAMADO EM SILICONE, BALONETE FLEXIVEL, ATOXICO, DE BAIXA PRESSAO, BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO, CALIBRE DE 7.0, INDIVIDUAL, ESTERIL, APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 MS, ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 MS	UNIDADE	60
16	1888110	CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA - TUBO ARAMADO EM SILICONE, BALONETE FLEXIVEL, ATOXICO, DE BAIXA PRESSAO, BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO, CALIBRE DE 7.5, INDIVIDUAL, ESTERIL, APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 MS, ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 MS	UNIDADE	60
17	2009080	CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA - TUBO ARAMADO EM SILICONE, BALONETE	UNIDADE	40

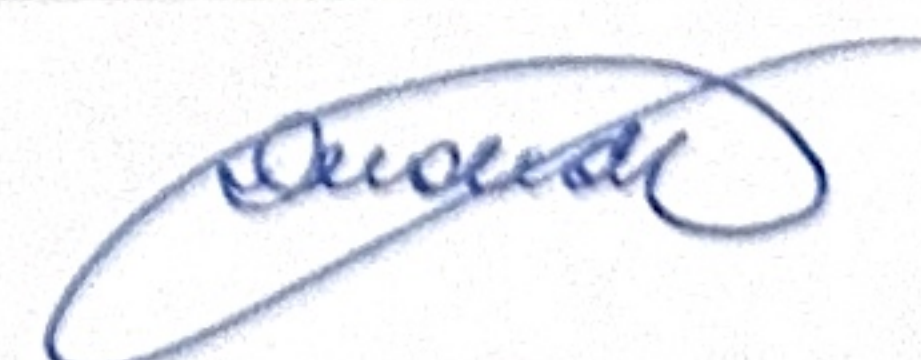

		FLEXIVEL, ATOXICO, DE BAIXA PRESSAO, BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO, CALIBRE DE 8,0, INDIVIDUAL, ESTERIL, APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 MS, ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 MS		
--	--	--	--	--

3. Do Prazo de Entrega

3.1. O prazo de entrega será de até **08 (oito) dias úteis**, a contar do recebimento da Nota de Empenho ou da Ordem de Fornecimento, **ressalvados** os casos que a Lei exija a formalização do instrumento contratual.

4. Especificações e/ou Condições Complementares

4.1. O acondicionamento e o transporte dos produtos para saúde, deverão ser realizados de acordo com o exigido para cada produto, devidamente protegido do pó e variação de temperatura, especialmente para garantir a qualidade e integridade do produto;

4.2. As embalagens externas devem mencionar as condições corretas de armazenagem do produto.

4.3. Todo objeto da contratação entregue que não for compatível com as especificações deverá ser substituído pelo fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da data da modificação a ser emitida pelo setor competente.

4.4. Substituições de marcas de produtos apenas serão aceitas, em casos de descontinuidade do produto no mercado junto à ANVISA, bem como falta de matéria prima comprometendo a fabricação, certificada pelo respectivo fabricante. Em ambos os casos deverá ser emitido pelo Fornecedor documento comprovando situação semelhante em outras instituições de mesmo porte. A marca oferecida para substituição deverá atender às especificações técnicas estabelecidas.

4.5. Arcar com todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, taxas e fretes;


4.6. Entregar o objeto do certame no **prazo máximo de 08 (oito) dias úteis**, contados a partir da comunicação via e-mail, com cópia da respectiva Nota de Empenho;

5. Prazo de Validade da Proposta

5.1. O prazo de validade da proposta será de no mínimo **120 (cento e vinte) dias**.

6. Conclusão

6.1. Desse modo, a formalização da presente DISPENSA DE LICITAÇÃO auxiliará no suprimento da demanda em questão do Hospital Regional do Agreste - HRA.

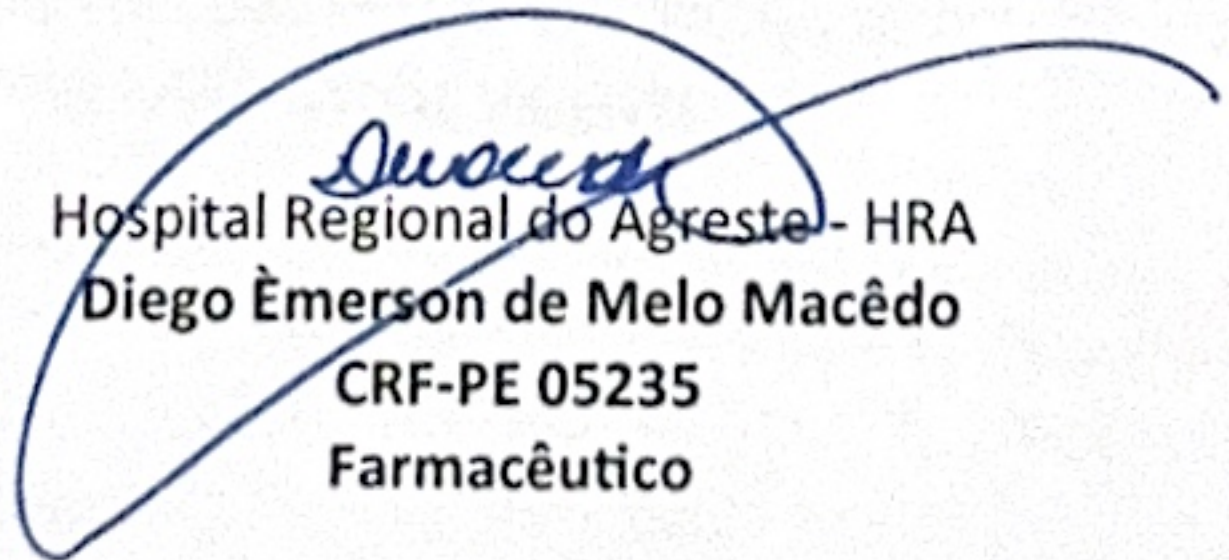
Hospital Regional do Agreste - HRA
Diego Emerson de Melo Macêdo
CRF-PE 05235
Farmacêutico

E-mail: hracaf1@gmail.com
Telefone: (81)3719.9367

Caruaru, 04/06/2025