

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria n.º 012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.		DATA: 17/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC		
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024		

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024 MEDIANTE O PA.015.CISAMREC.2024

Abaixo segue relação de itens analisados minuciosamente, conforme descritivo e em anexo (ANEXO I) as fotos da análise dos itens reprovados. Após análise chegamos aos pareceres por empresa, itens e marcas dos produtos.

Item	Descrição	Unid	Empresa	Marca/Modelo	Aprovado/Reprovado	Motivo
3	Avental descartável. Características: avental de manga longa, punho de malha ou elástico e abertura posterior, com tiras para amarrar na cintura, confeccionado em TNT (100% polipropileno) gramatura mínima 30g/m 2, cor branca, tamanho único, não esteril. Deve ser confeccionado de material de boa qualidade, atóxico, hidro/hemorrepelente, hipoalérgico, com baixo desprendimento de partículas. Apresentar junto à proposta ficha técnica do produto.	Unid	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	ANADONA	REPROVADO	PRODUTO NÃO ATENDE A GRAMATURA MÍNIMA E COM BAIXA QUALIDADE, RASGOU COM FACILIDADE.
5	Equipo tipo Macrogotas para solução parental: Com câmara flexível, gotejadoras macrogotas (20 gotas/ml) transparente, filtro de partículas de 15u que retém partículas em suspensão, regulador de fluxo de alta precisão que permite rigoroso controle de gotejamento (pinça rolete), sem dano ou deterioração entre o regulador do fluxo e o tubo, entrada de ar com filtro de partículas, hidrófobo e bacteriológicos de 0,22u, lanceta perfurante trifacetada, padrão ISO, para conexão ao recipiente de solução com tampa protetora, tubo flexível em pvc, sem efeito memória, transparente de 1,5m, atóxico e epirrogênio, injetor lateral em y com suporte para os dedos protegendo assim o profissional, item de segurança conforme NR 32, conexão distal luer slip ou luer lock rotativo, dispositivo de acesso venoso , atender na integra a portaria n° 502, de 29/12/2011 - INMETRO. A embalagem deverá conter na rotulagem dados como: equipo de uso único, data de validade, data de fabricação, lote, esteril, embalado em papel grau cirúrgico, não permitindo colar após abertura. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Unid	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DESCARPACK	APROVADO	PRODUTO CONFORME DESCRITIVO.

PARA: Setor de Licitações do CISAMREC

ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024

20	Oxímetro de pulso, clipe de dedo, portátil. Com display de LED, Intervalo de medição de SpO2 entre 70-99% com precisão de ±2%. Possuir frequência de Pulso: Intervalo de medição: 30-250 BPM. Funcionamento com duas pilhas tipo "AAA" com possibilidade de duração de 18 horas de monitorização contínua. Equipamento deverá possuir barras laterais para maior precisão de leitura em locais com grande luminosidade. Equipamento deverá realizar leitura em unha com esmalte. Possuir e apresentar junto à proposta o registro na ANVISA. Apresentar junto à proposta, catálogo do produto identificando o mesmo.	Unid	ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	G-TECH	APROVADO	PRODUTO CONFORME DESCRIPTIVO.
30	Compressa de Gaze Hidrófila Estéril 7,5 x 7,5 cm c/ 13 fios, pacote c/ 10 unidades. Características: confeccionada com fios 100% algodão em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechada e 15x30 quando aberta. Cor branca, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Inodoras e insípidas. Dobradas para dentro em toda a sua extensão para evitar o desfiamento, isento de quaisquer defeitos prejudiciais a sua perfeita utilização, embaladas em pacote com 10 unidades, constando externamente os dados de identificação e procedência e demais características conforme ABNT 13843:2009. Esterilizados por irradiação gama ou por óxido de etileno, sem o filamento radiopaco. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Pacote com 10 unidades (pedido por pacote)	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	COTTONMAX - ERIMAX	REPROVADO	PRODUTO APRESENTADO NÃO ATENDE AO TAMANHO E GRAMATURA SOLICITADA.

PARA: Setor de Licitações do CISAMREC

ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024

31	Compressa de gaze Hidrófila 7,5 X 7,5 com 13 fios, pacote com 500und. Características: confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras, com dimensão de 7,5 x 7,5cm quando fechadas e 15x30 cm quando abertas. Cor branca, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Inodoras e insípidas. Dobradas para dentro em toda a sua extensão para evitar o desfiamento, isento de quaisquer defeitos prejudiciais a sua perfeita utilização, embaladas em pacote plástico com 500 unidades, constando externamente os dados de identificação e procedência, sem fios radiopacos e demais características conforme ABNT 13843:2009. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Pacote com 500 unidades (pedido por pacote)	CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI	SP BIOTECTION	REPROVADO	PRODUTO NÃO ATENDEU AO TAMANHO E GRAMATURA SOLICITADA.
37	Máscara de oxigênio com bolsa reservatório e de não reinalação Infantil. Transparente, de vinil macio, para conforto do paciente e avaliação visual. Completa, com tubo de suprimento de oxigênio de 2,10 A 2,20m. Presilha ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável. Possuir registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Unid	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	DESCCLASSIFICA- DO	FORNECEDOR SOLICITOU A DESCCLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR SOLICITOU A DESCCLASSIFICAÇÃO

PARA: Setor de Licitações do CISAMREC

ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024

53	Luva Cirúrgica estéril no.6,5. Características: Látex, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Nº. 6,5. Espessura mínima: 0,22 mm. Comprimento mínimo: 280 mm. Cor natural. Superfície antiderrapante. Lubrificadas com Pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama). Esterilizadas por Raios Gama (Cobalto 60). Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico. Possuir e apresentar junto a proposta certificado de aprovação – CA, para risco biológico, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego e registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Par (pedido por par, ou seja virão 2 luvas)	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO LTDA	LEMGRUBER - LIFE PLUS	APROVADA	PRODUTO CONFORME DESCRIPTIVO.
54	Luva Cirúrgica estéril no.7,0. Características: Látex, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Nº. 7,0. Espessura mínima: 0,22 mm. Comprimento mínimo: 280 mm. Cor natural. Superfície antiderrapante. Lubrificadas com Pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama). Esterilizadas por Raios Gama (Cobalto 60). Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico. Possuir e apresentar junto a proposta certificado de aprovação – CA, para risco biológico, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego e registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Par (pedido por par, ou seja virão 2 luvas)	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO LTDA	LEMGRUBER - LIFE PLUS	APROVADA	PRODUTO CONFORME DESCRIPTIVO.

PARA: Setor de Licitações do CISAMREC

ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024

55	Luva Cirúrgica estéril no.7,5. Características: Látex, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Nº. 7,5. Espessura mínima: 0,22 mm. Comprimento mínimo: 280 mm. Cor natural. Superfície antiderrapante. Lubrificadas com Pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama). Esterilizadas por Raios Gama (Cobalto 60). Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico. Possuir e apresentar junto a proposta certificado de aprovação – CA, para risco biológico, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego e registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Par (pedido por par, ou seja virão 2 luvas)	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO LTDA	LEMGRUBER - LIFE PLUS	APROVADA	PRODUTO CONFORME DESCRIPTIVO.
56	Luva Cirúrgica estéril no.8,0. Características: Látex, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Nº. 8,0. Espessura mínima: 0,22 mm. Comprimento mínimo: 280 mm. Cor natural. Superfície antiderrapante. Lubrificadas com Pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama). Esterilizadas por Raios Gama (Cobalto 60). Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico. Possuir e apresentar junto a proposta certificado de aprovação – CA, para risco biológico, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego e registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Par (pedido por par, ou seja virão 2 luvas)	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO LTDA	LEMGRUBER - LIFE PLUS	APROVADA	PRODUTO CONFORME DESCRIPTIVO.

PARA: Setor de Licitações do CISAMREC

ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024

70	Esparadrapo Impermeável, com capa, 5cmx4,5m. Características: Composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Esparadrapo de boa fixação e aderência. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, sondas, drenos, cateteres. Largura 5cm x 4,5m comprimento. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e cópia impressa do registro na ANVISA/MS. Com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Rolo	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COPERTINA	APROVADO	PRODUTO CONFORME DESCRIPTIVO.
72	Aguilha preta 22G1 , para coleta múltipla de sangue a vácuo, medindo 25x7 (22G1), uso pediátrico/geriátrico, canhão de cor preto com bisel trifacetado, silicônico, esterilizado a Oxido de Etileno (ETO). Com dispositivo emborrachado que permite perfeito encaixe de adaptadores. Embaladas individualmente em cápsulas hermeticamente fechadas que contenha: calibre da agulha, número de lote e validade. Com dispositivo de segurança. Produto de uso único. Apresentação: Caixas em papelão com 100 unidades cada. De acordo com a NR 32/Portaria GM nº 939 que estabelece o uso de Materiais Perfuro Cortantes com Dispositivo de Segurança.	Caixa com 100 unid (pedido por caixa)	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	WILTEX	APROVADO	PRODUTO CONFORME DESCRIPTIVO.

PARA: Setor de Licitações do CISAMREC

ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024

91	Detector de batimento cardíaco fetal digital portátil. Indicado para detectar e auscultar os batimentos cardíaco – fetal, a partir da 10ª semana de gestação, por Doppler de ultrassonografia, detectando movimentos e fluxos em frequências próximas de 2 MHz. Alto-falante embuído. Características técnicas: Painel frontal com display LCD - cristal líquido tes, capa protetora, fone de ouvido. Alimentação: bateria 9V. Ritmo e Frequência Cardíaca e Iluminação do display: frequência dos batimentos cardíacos: 30~240 bpm, precisão da FCF: ±2% da faixa~; Frequência do ultra-som: 2 MHz Intensidade do ultra-som: <10 mW/cm2. Potência de saída do alto-falante: 1,2 W (alto-falante embuído). Botão - Liga/desliga com ajuste de volume. Acessórios Inclusos: 01 Transdutor de ultra-som Transdutor BCF, 01 Fone de ouvido, 01 Bolsa para transporte, Frasco de gel, 01 Manual operacional em português. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto/catálogo e registro na ANVISA/MS.	Unit	CIRURGICA CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA - ME	DESCLASSIFI- CADO	DESCLASSIFICADO	DESCLASSIFICADO POR AUSÊNCIA DE AMOSTRA.
111	Atadura de crepom medindo 06 cm de largura por 1,80m de comprimento em repouso, com densidade de 18 fios/cm² tipo II, com peso de 18g por unidade, confeccionada em tecido mínimo 90% algodão acrescido de elastano, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, aparência uniforme, bordas devidamente bem acabadas, isenta de impurezas, rasgos, fiapos, fios soltos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Apresentar registro ms e AFE do fabricante na proposta. Embaladas individualmente, pacote com 12 unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da ABNT 14.056. Apresentar Amostra.	Pacote com 12 unit (pedido por pacote)	METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	MEDHOUSE	APROVADO	PRODUTO CONFORME DESCRIPTIVO.

PARA: Setor de Licitações do CISAMREC

ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024

112	Atadura de crepom medindo 10 cm de largura por 1,80m de comprimento em repouso, com densidade de 18 fios/cm² tipo II, com peso de 30g por unidade, confeccionada em tecido mínimo 90% algodão acrescido de elastano, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, aparência uniforme, bordas devidamente bem acabadas, isenta de impurezas, rasgos, fiapos, fios soltos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Apresentar registro ms e AFE do fabricante na proposta. Embaladas individualmente, pacote com 12 unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da ABNT 14.056. Apresentar Amostra.	Pacote com 12 unid (pedido por pacote)	NETMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDHOUSE	APROVADO	PRODUTO CONFORME DESCRIPTIVO.
113	Atadura de crepom medindo 15 cm de largura por 1,80m de comprimento em repouso, com densidade de 18 fios/cm² tipo II, com peso de 45g por unidade, confeccionada em tecido mínimo 90% algodão acrescido de elastano, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, aparência uniforme, bordas devidamente bem acabadas, isenta de impurezas, rasgos, fiapos, fios soltos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Apresentar registro ms e AFE do fabricante na proposta. Embaladas individualmente, pacote com 12 unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da ABNT 14.056. Apresentar Amostra.	Pacote com 12 unid (pedido por pacote)	METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	MEDHOUSE	APROVADO	PRODUTO CONFORME DESCRIPTIVO.

PARA: Setor de Licitações do CISAMREC

ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024

114	Atadura de crepom medindo 20 cm de largura por 1,80m de comprimento em repouso, com densidade de 18 fios/cm² tipo II, com peso de 60g por unidade, confeccionada em tecido mínimo 90% algodão acrescido de elastano, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, aparência uniforme, bordas devidamente bem acabadas, isenta de impurezas, rasgos, fiapos, fios soltos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Apresentar registro ms e AFE do fabricante na proposta. Embaladas individualmente, pacote com 12 unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da ABNT 14.056. Apresentar Amostra.	Pacote com 12 unid (pedido por pacote)	METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	MEDHOUSE	APROVADO	PRODUTO CONFORME DESCRITIVO.
119	Esparradrapo Impermeável e HIPOALÉRGICO, com capa, 2,5cmx4,5m. Características: Composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva hipoalergênica, ISENTO DE LÁTEX. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, sondas, drenos, cateteres. Largura 2,5m x 4,5m comprimento. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e cópia impressa do registro na ANVISA/MS. Com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Unid	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	COPERTINA	APROVADO	PRODUTO CONFORME DESCRITIVO.
148	Caixa porta lâminas. 25 lâminas. Fabricada em polipropileno rígido, sistema de travamento por pressão, fechamento da tampa por dobradiças, ranhuras para identificação, capacidade para 25 lâminas de microscopia.	Unid	VNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	CRAL	APROVADO	PRODUTO CONFORME DESCRITIVO.

PARA: Setor de Licitações do CISAMREC

ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024

164	Protetor cutâneo. Frasco spray com no mínimo 50mL. Características mínimas: Solução polimérica líquida de secagem rápida, resistente à água e sem álcool. Embalagem unitária contendo identificação de marca, lote, data de fabricação, validade e procedência. Deve apresentar registro no MS. O fabricante deverá fornecer as orientações por escrito, em português. Validade de no mínimo 12 meses, contada a partir da data de emissão da NF.	Frasco	VUELO PHARMA LTDA	VUELO	APROVADO	PRODUTO CONFORME DESCRITIVO.
165	Membrana porosa de celulose. Tamanho 7,5cm X10cm, permitindo uma variação de +/- 1cm em cada medida. Características mínimas: membrana porosa composta por fibras de celulose, com poros médios (1 a 2mm) que permitem a troca gasosa, transpondo o excesso de umidade para a gaze secundária. Utilizada no tratamento de feridas crônicas e queimaduras, agindo como substituto temporário da pele. Não necessita trocas diárias. Estéril. Embalagem unitária contendo identificação de marca, lote, data de fabricação, validade e procedência. Deve apresentar registro no MS. O fabricante deverá fornecer as orientações por escrito, em português. Validade de no mínimo 12 meses, contada a partir da data de emissão da NF.	Unid	CPC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	MEM-BRACEL VUELO	APROVADO	PRODUTO CONFORME DESCRITIVO.
176	Bolsa de Colostomia Intestinal de uma peça, drenável, com barreira a prova de odor e vazamento, transparente/opaca, placa de barreira de pele de resina a base de hidrocolóides (pectina, gelatina e arboximetilcelulose sódica) placa com diâmetro recortável de 19 a 64 mm. Caixa com 10 unidades.	Caixa com 10 unid (pedido por caixa)	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	CASEX	APROVADO	PRODUTO CONFORME DESCRITIVO.
183	Cuba redonda para assepsia, profundidade 5cm, diâmetro 10cm, bordas arredondadas. Confeccionado em aço inoxidável AISI-420, em embalagem plástica individual, devendo na embalagem externa nome do fabricante, nº do lote e nº registro na Anvisa. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT. Garantia de 10 anos.	Unid	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CUB059 - AÇONOX RIO	APROVADO	PRODUTO CONFORME DESCRITIVO.

PARA: Setor de Licitações do CISAMREC

ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024

185	Compressa de Gaze Hidrófila Estéril 7,5 x 7,5 cm c/ 13 fios, pacote c/ 5 unidades. Características: confeccionada com fios 100% algodão em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechada e 15x30 quando aberta. Cor branca, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Inodoras e insípidas. Dobradas para dentro em toda a sua extensão para evitar o desfiamento, isento de quaisquer defeitos prejudiciais a sua perfeita utilização, embaladas em pacote com 10 unidades, constando externamente os dados de identificação e procedência e demais características conforme ABNT 13843:2009. Esterilizados por irradiação gama ou por óxido de etileno, sem o filamento radiopaco. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Pacote com 5 unidades (pedido por pacote)	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	HÉRIKA 13 FIOS	APROVADO	PRODUTO CONFORME DESCRITIVO.
188	Abocath n°24 , dispositivo para acesso venoso, apirrogênico, esterilizado por óxido de etileno, não contém PVC. Sem dispositivo de segurança.	Unid	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	POLYMED MEDICAL DEVICES	APROVADO	PRODUTO CONFORME DESCRITIVO.
195	Andador adulto. Confeccionado em alumínio, dupla barra de sustentação, dobrável, pés emborrachados. 5 níveis de regulação de altura, com pino trava. Função fixo e articulado. Produto dobrável para facilitar o armazenamento.	Unid	METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	D10 DELLAMED	APROVADO	PRODUTO CONFORME DESCRITIVO.

PARA: Setor de Licitações do CISAMREC

ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024

201	Otoscópio com Iluminação halógena por Fibra Ótica. Iluminação halógena: Possuir engate com sistema de rosca, cabo em metal cromado para duas pilhas C (médias) comuns, recoberto por capa antiderrepante. Ter cabecote com lâmpada halógena, regulador de alta e baixa luminosidade. Alimentação através de duas pilhas C. Deverá acompanhar: 05 espelhos sendo: 01 jogo com 04 espelhos reutilizáveis nos tamanhos 2,5mm - 3mm - 4mm e 5mm (Esterilizáveis em autoclave ou solução para esterilização) + 01 speculo padrão de 04mm; 01 lâmpada halógena reserva. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto/catálogo e registro na ANVISA/MS.	Unid	URSA COMERCIAL LTDA	DESCLASSIFI-CADA	DESCLASSIFI-CADA	DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAR AMOSTRAS.
203	Ataduras de Crepom 8cm. Características: Confeccionadas com tecido 100% algodão cru ou misto, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm² , possuindo elasticidade longitudinal mínima de 50%. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. Tamanho: 08 cm de largura 1.80 m de comprimento (em repouso). De acordo com a NBR 14056. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Unid	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NEVE - INA	REPROVADA	PRODUTO NÃO ATENDE A GRAMATURA. NA PRÓPRIA EMBALAGEM CONTÉM A INFORMAÇÃO 8G E A ABNT SOLICITA 17,8G.
204	Ataduras de Crepom 10cm. Características: Confeccionadas com tecido 100% algodão cru ou misto, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm² , possuindo elasticidade longitudinal mínima de 50%. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. Tamanho: 10 cm de largura 1.80 m de comprimento (em repouso). De acordo com a NBR 14056. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Unid	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NEVE - INA	REPROVADA	PRODUTO NÃO ATENDE A GRAMATURA. NA PRÓPRIA EMBALAGEM CONTÉM A INFORMAÇÃO 9G E A ABNT SOLICITA 21,8G.

PARA: Setor de Licitações do CISAMREC

ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024

206	Ataduras de Crepom 15cm. Características: Confeccionadas com tecido 100% algodão cru ou misto, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm² , possuindo elasticidade longitudinal mínima de 50%. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. Tamanho: 15 cm de largura 1.80 m de comprimento (em repouso). De acordo com a NBR 14056. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Unid	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NEVE - INA	REPROVADA	PRODUTO NÃO ATENDE A GRAMATURA. NA PRÓPRIA EMBALAGEM CONTÉM A INFORMAÇÃO 13,5G E A ABNT SOLICITA 32,7G.
207	Ataduras de Crepom 20cm. Características: Confeccionadas com tecido 100% algodão cru ou misto, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm² , possuindo elasticidade horizontal mínima de 50%. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. Tamanho: 20 cm de largura 1.80 m de comprimento (em repouso). De acordo com a NBR 14056. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	Unid	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NEVE - INA	REPROVADA	PRODUTO NÃO ATENDE A GRAMATURA. NA PRÓPRIA EMBALAGEM CONTÉM A INFORMAÇÃO 18G E A ABNT SOLICITA 42,8G.
217	Compressa de Gaze em Rolo Tipo Queijo, confeccionada com 13 fios por cm², medindo 91cm X 91m. Não estéril. Tecido 100% algodão com 04 dobras e 08 camadas, cor branca, baixa densidade de fios por cm, ligamento tafetá. Isenta de manchas, falhas, impureza e imperfeições, altamente absorvente. Acondicionada individualmente em embalagem plástica contendo número de lote, dados de identificação, procedência, validade e demais informações conforme NBR 14108:2017. Peso mínimo de 1900g por rolo. Apresentar registro no Ministério da Saúde/ANVISA.	Unid	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	AMED - NATALY SOFT	REPROVADA	PRODUTO NÃO ATENDE AO PESO E A LARGURA.

PARA: Setor de Licitações do CISAMREC

ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024

218	Garrote em tecido elástico, fecho em PVC para ajuste fácil e confortável, processo de auto trava e regulação de tensão, deverá proporcionar ajuste preciso, evitando o desconforto dos garrotes e torniquetes tradicionais, permitindo ser utilizado com apenas uma das mãos, para uso adulto e infantil.	Unid	ALFALAGOS LTDA	ACCUMED GLICOMED	APROVADO	PRODUTO CONFORME DESCRITIVO.
229	Indicador Biológico 1262 CAIXA C/ 100 - Indicador Biológico do tipo auto-contido, com tempo de resposta de no máximo 48 horas, composto de uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e calibrados de Geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953, com certificado de Qualidade Assegurada), para controle biológico dos processos de esterilização à vapor saturado. A tira contendo esporos está armazenada em uma ampola plástica que também acondiciona uma ampola de vidro contendo um caldo nutriente próprio para o cultivo dos microorganismos. A ampola plástica é fechada por uma tampa marrom perfurada e protegida por um papel de filtro hidrofóbico. Cada ampola possui um rótulo externo que informa o lote e a data da fabricação do produto, contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não-processadas.	Caixa com 100 Unidades (pedido por caixa)	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	BIOLOGICAL TEST	APROVADO	PRODUTO CONFORME DESCRITIVO.

Durante a realização da análise técnica do material, foram avaliados todos os requisitos obrigatórios, conforme especificações editalícias, bem como a qualidade, segurança e eficácia dos materiais.

Deste modo, como membros da comissão técnica, no uso das atribuições que nos conferem, nos posicionamos pela **aprovação** dos itens 5, 20, 53, 54, 55, 56, 70, 72, 111, 112, 113, 114, 119, 148, 164, 165, 176, 183, 185, 188, 195, 218 e 229, vez que atende ao solicitado em edital, **reprovação** dos itens 3, 30, 31, 203, 204, 206, 207 e 217, uma vez que não atende (diverge) ao solicitado, e **desclassificação** dos itens 37, 91, 201, por não enviar amostras para análise, conforme motivo já explicado a cima.

Segundo resultado da análise acima para cada item, o Setor de Licitações do CISAMREC pode dar prosseguimento ao PE.007/2024 com a habilitação para os itens aprovados e desclassificação para os itens que formam reprovados.

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria n.º 012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 17/07/2024
---	-------------------------

PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
--	--

ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024
--

Criciúma, 17 de julho de 2024.


ALINE NEVES BONETTI
Farmacêutica do Município de Criciúma


JANETE DE FÁTIMA DOS SANTOS BORDIN
Enfermeira do Município de Morro da Fumaça


RAVENA PAVEI JACINTO
Enfermeira do Município de Treviso


MIKAELLA ROSA MANENTI
Assistente de Logística do CISAMREC, graduada em Enfermagem

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 17/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

ANEXO I

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 17/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

ITEM 03 -



DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 17/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

ITEM 30 –



DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 17/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

ITEM 31 –




DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 17/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

ITEM 203 –




DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 17/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

ITEM 204 –

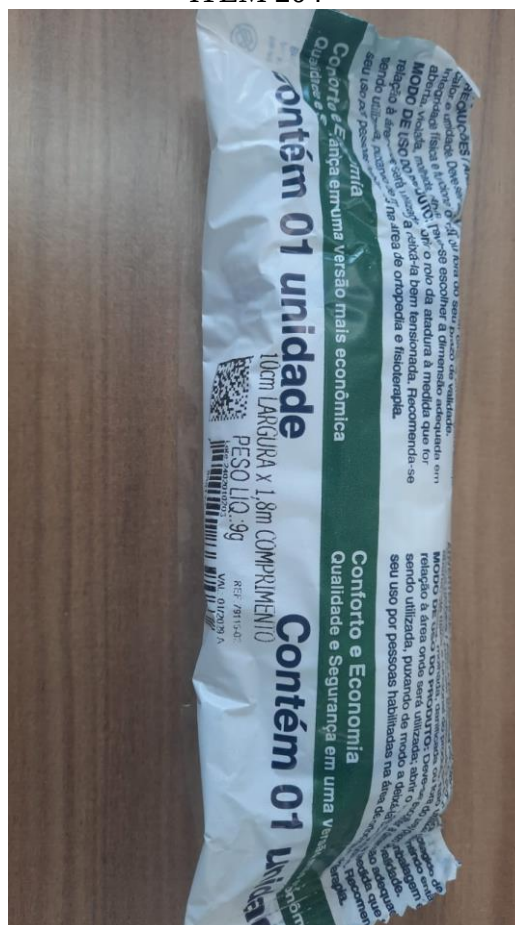


DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 17/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

ITEM 206 –

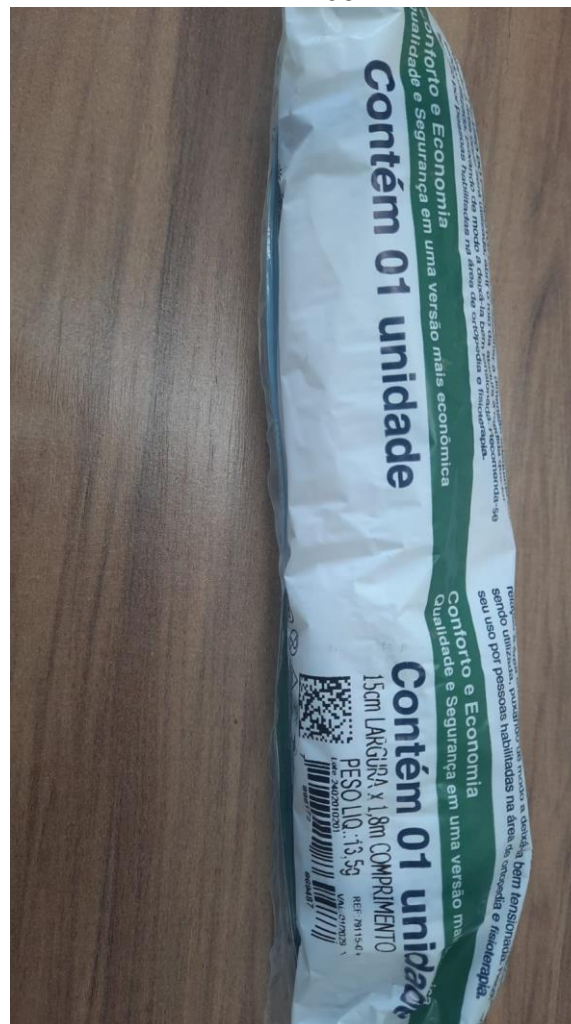

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 17/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

ITEM 207 –

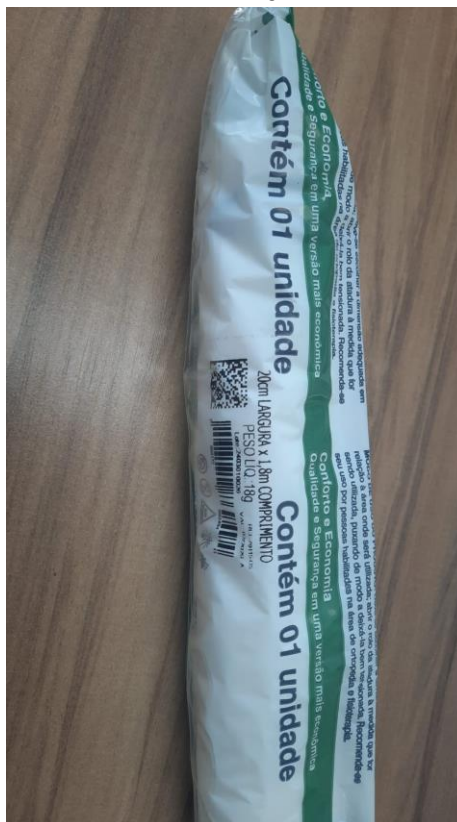


DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.

DATA: 17/07/2024

PARA: Setor de Licitações do CISAMREC

ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024

ITEM 217 –

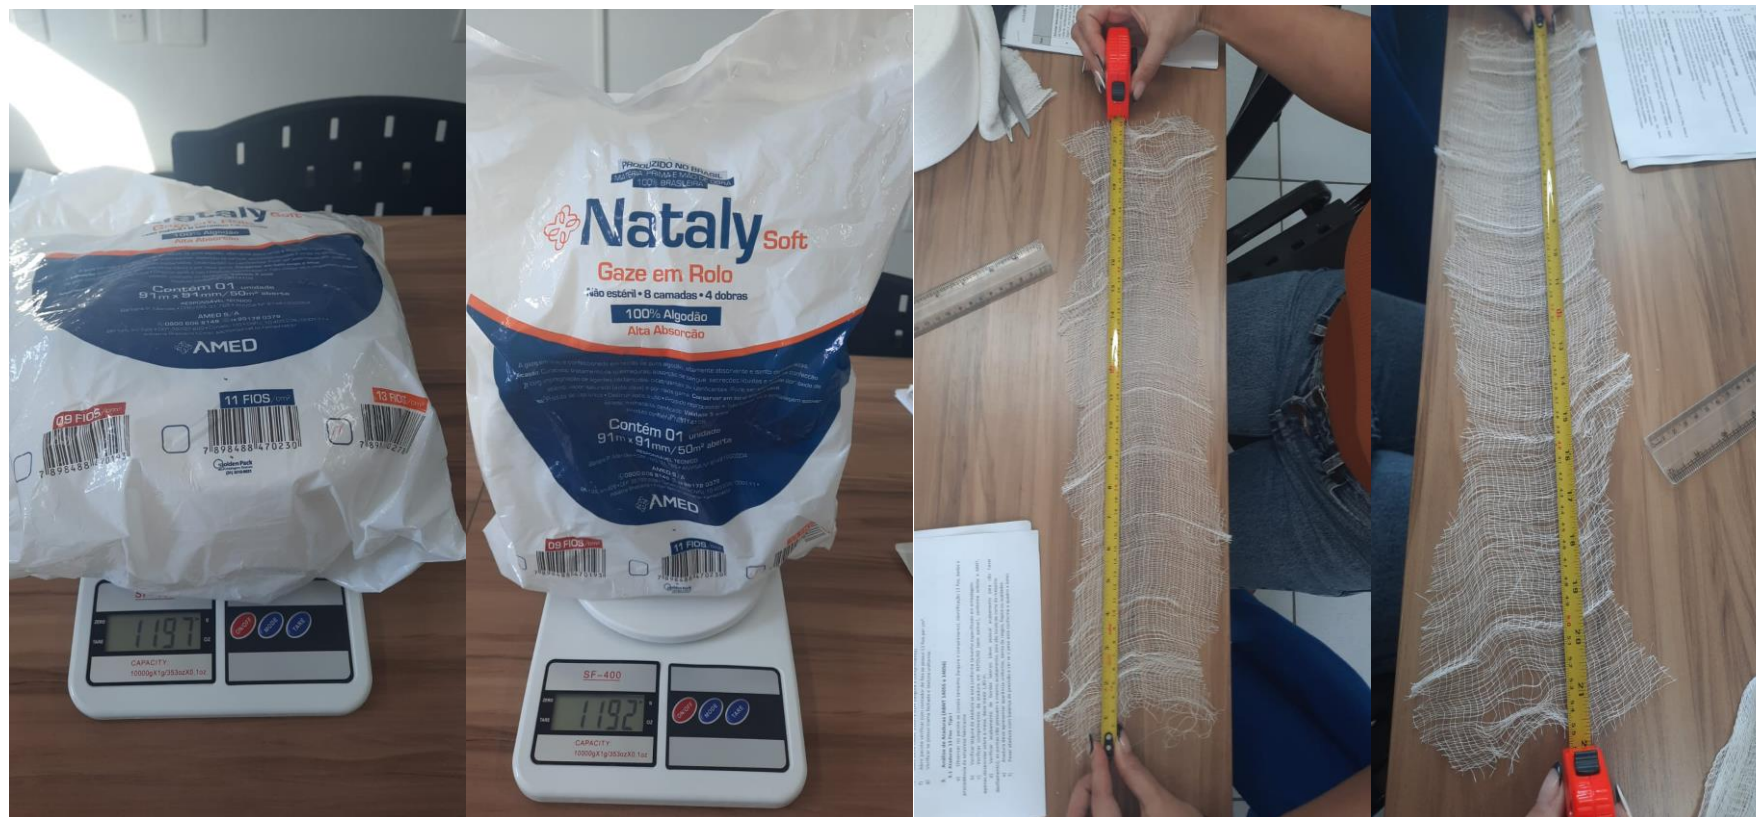

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.012/CISAMREC/2024 – Responsável pela análise de itens de marca não aprovadas do PE.007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, do CISAMREC.	DATA: 17/07/2024
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 007/2024 – Materiais Médico-Hospitalares em geral e Insumos para Saúde, mediante PA.015.CISAMREC.2024	

ITEM 217 –

