



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Adelino Bornelli, n° 741 - Fone 3293 2895 - 999358776

CEP: 37.140-000 - A R E A D O - Minas Gerais

e-mail: visa@areado.mg.gov.br

OFÍCIO VISA 024/2025

Areado, 28 de julho de 2025.

Prefeitura Municipal de Areado
Setor de Licitação
Areado-MG
37140-000

Assunto: Justificativa de inadequação técnica da proposta para o Termonebulizador.

Prezado Responsável,

Após análise técnica da proposta apresentada verificou-se que o equipamento ofertado não atende às especificações técnicas descritas no Termo de Referência, comprometendo sua compatibilidade com a finalidade prevista para a aquisição.

Foram constatadas diversas divergências em relação aos parâmetros exigidos conforme descrito a seguir:

1. Capacidade dos tanques:

O Termo de Referência exige que o equipamento possua:

- Tanque de calda com capacidade entre 8 a 10 litros;
- Tanque de combustível com capacidade entre 1,8 e 2 litros.

No entanto, o equipamento ofertado apresenta: Tanque de calda com 6 litros e tanque de combustível com 1,2 litros.

Valores inferiores ao mínimo exigido, o que inviabiliza o cumprimento dos requisitos técnicos.

2. Sistema de Nebulização:


Conforme descrito no Termo e Referência, o equipamento deve possuir:

- Ressonador com saída dupla e bico curvo com entradas para injeção de calda;
- Possibilidade de configuração para aplicação convencional (espacial) e subterrânea;
- Kit de peças para conversão na aplicação subterrânea.

No entanto a proposta ofertada não atende a esses requisitos, pois o equipamento não possui saída dupla e não apresenta possibilidade de conversão ou configuração para aplicação subterrânea, sendo restrito apenas à aplicação espacial.


Diante do exposto, e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e na necessidade de garantir a adequada execução do objeto licitado, justifica-se a desclassificação da proposta apresentada pela referida licitante por não atender aos requisitos técnicos mínimos exigidos no processo licitatório.

Atenciosamente

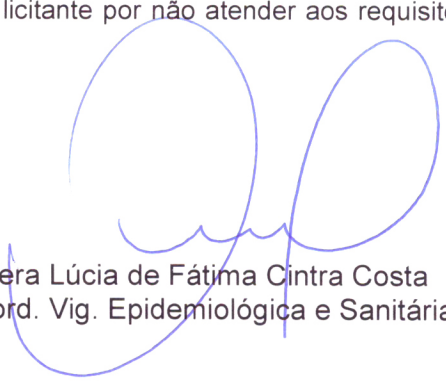
Vera Lúcia de Fátima Cintra Costa
Coord. Vig. Epidemiológica e Sanitária

KAWASHIMA

3. Componentes

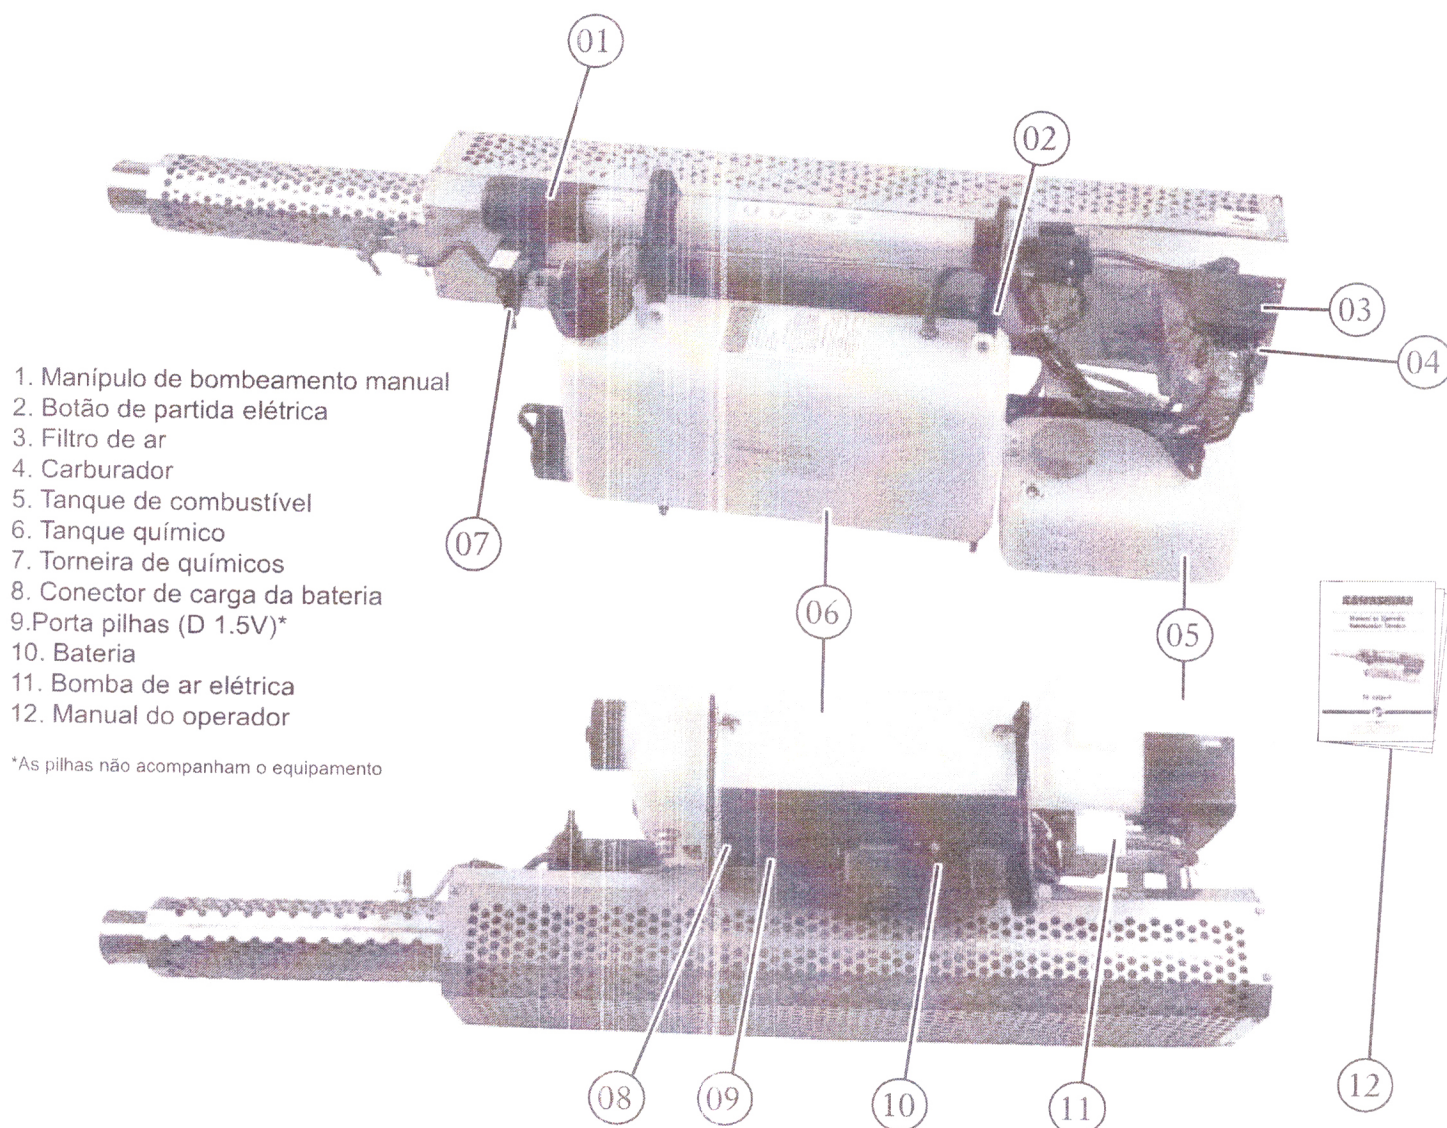

Itens que acompanham

1. Funil para químicos (branco)
2. Funil para gasolina (vermelho)
3. Cinto de sustentação
4. Kit reparo
5. Chave de fenda/cruzada
6. Fonte transformadora (bivolt - 127V - 220V)
7. Escova de aço

