



Pouso Alegre, 13 de agosto de 2024.

Pregão Eletrônico 34/2024, referente à AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS HOSPITALARES DO SISTEMA DIGESTÓRIO E INSUMOS ESPECIAIS PARA TERAPIA ENDOVENOSA DOMICILIAR.

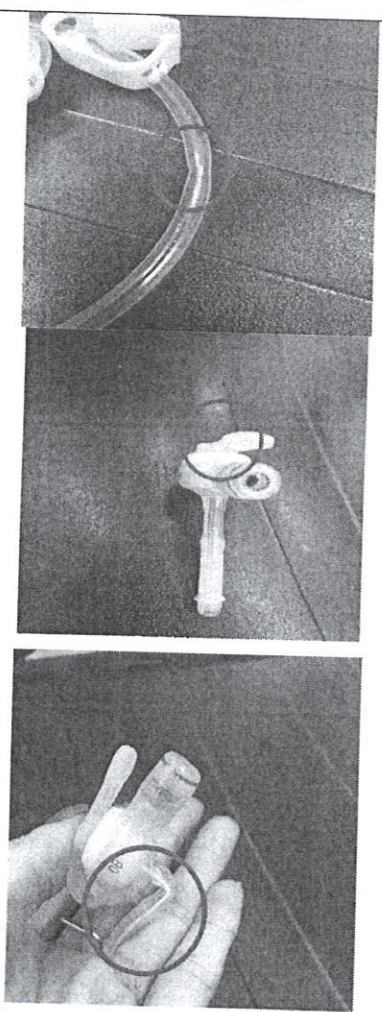
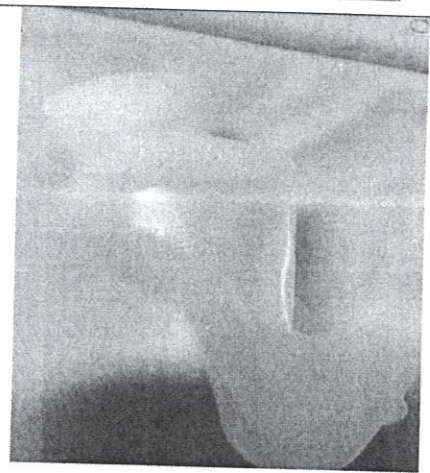
DA ANÁLISE:

ITEM	EMPRESA	ANÁLISE	MARCA
Item 17 - sonda de gastrostomia para alimentação de baixo perfil fr 14 x 1,5 cm. Item 18 - sonda de gastrostomia para alimentação de baixo perfil fr 14 x 2,0 cm. Item 19 - sonda de gastrostomia para alimentação de baixo perfil fr 14 x 3,0 cm. Item 20 - sonda de gastrostomia para alimentação de baixo perfil fr 16 x 1,5 cm. Item 21 - sonda de gastrostomia para alimentação de baixo perfil fr 16 x 2,0 cm. Item 22 - sonda de gastrostomia para alimentação de baixo perfil fr 16 x 2,5 cm. Item 23 - sonda de gastrostomia para alimentação de baixo perfil fr 16 x 3,0 cm. Item 25 - sonda de gastrostomia para alimentação de baixo perfil fr 18 x 2,5 cm. Item 27 - sonda de gastrostomia para alimentação de baixo perfil fr 18 x 3,0 cm. Item 28 - sonda de gastrostomia para alimentação de baixo perfil fr 18 x 3,5 cm. Item 30 - sonda de gastrostomia para alimentação de baixo perfil fr 20 x 2,5 cm.	NUTRICIONAL FARMA LTDA CNPJ: 08.316.438/0001-95	REPROVADA Sistema de trava: sonda extensora para alimentação em bolus não trava firmemente, o que pode ocasionar vazamentos ou desconexões durante a alimentação. Ao pinçar e soltar, a sonda fica deformada (sem memória), o que pode diminuir sua vida útil de uso. Cateter: silicone muito maleável, que dobra facilmente. Cateteres muito moles dificultam a troca, devido à falta de firmeza do tubo extensor, durante a introdução no estoma. Tampa e pino do conector do cateter: Encaixe difícil, sem ajuste perfeito.	G-FLEX
Item 32 - frasco para dieta enteral – 300 ml.	FARMA 2 CNPJ: 24.826.631/0003-94	REPROVADA Material pouco resistente ao manuseio, pois amassa facilmente e não apresenta memória. Ao teste com equipo, reduz o tempo de gotejamento, chegando a interromper.	BIOBASE
ITEM 33 - Equipo macrogotas para nutrição enteral.	FARMA 2 CNPJ: 24.826.631/0003-94	APROVADA	DESCARPACK


Ana Cristina da Silva - Matrícula 16382
Enfermeira Estomaterapeuta



ANÁLISE FOTOGRÁFICA

ITEM	EMPRESA	MARCA G-FLEX
Item 17 - sonda de gastrostomia para alimentação de baixo perfil fr 14 x 1,5 cm. Item 18 - sonda de gastrostomia para alimentação de baixo perfil fr 14 x 2,0 cm. Item 19 - sonda de gastrostomia para alimentação de baixo perfil fr 14 x 3,0 cm. Item 20 - sonda de gastrostomia para alimentação de baixo perfil fr 16 x 1,5 cm. Item 21 - sonda de gastrostomia para alimentação de baixo perfil fr 16 x 2,0 cm. Item 22 - sonda de gastrostomia para alimentação de baixo perfil fr 16 x 2,5 cm. Item 23 - sonda de gastrostomia para alimentação de baixo perfil fr 16 x 3,0 cm. Item 25 - sonda de gastrostomia para alimentação de baixo perfil fr 18 x 2,5 cm. Item 27 - sonda de gastrostomia para alimentação de baixo perfil fr 18 x 3,0 cm. Item 28 - sonda de gastrostomia para alimentação de baixo perfil fr 18 x 3,5 cm. Item 30 - sonda de gastrostomia para alimentação de baixo perfil fr 20 x 2,5 cm.	NUTRICIONAL FARMA LTDA CNPJ: 08.316.438/0001-95	
Item 32 - frasco para dieta enteral – 300 ml	FARMA 2 CNPJ: 24.826.631/0003-94	

Ana Cristina da Silva - Matrícula 16382
Enfermeira Estomaterapeuta