



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA  
Secretaria Municipal de Saúde



RELATORIO DE ANÁLISE TÉCNICA DOS DESCRITIVOS CONSTANTES DO EDITAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº027/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2025, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA M. DE SAÚDE, CONFORME APRESENTAÇÃO DOS PROSPECTOS DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS:

ITEM 64:POLTRONA PARA HEMODIALISE

MARCA: RENASCER MODELO: RN11001L

VENCEDORA: 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 15.631.700/0001-51

| ANALISE CATALOGO / MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXIGENCIA DO EDITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROSPECTO APRESENTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>POLTRONA PARA HEMODIALISE:</b> estrutura tubular em aço carbono ou galvanizado mínimo 1,5", pintura epox; capacidade mínima 150 kg; reclinável em diversas posições, trendelemburg, sistema de reclino simultâneo encosto e peseira, permite reclino negativo; mecanismo de reclinção instalado no braço, acionado através de puxador, que permita parar e travar na posição desejada; rodízios com sistema de trava; dupla camada de espuma do assento e encosto, densidade mínimo D33; espuma dos braços densidade mínima D28, Ziper na parte traseira. Referencia New Life, Vexer, Novarte. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar folder/prospecto/ficha técnica. | <b>RN11001L – POLTRONA MULTIMED LUXO</b> - Estrutura em tubo de aço redondo de 1" x 1.20mm e 1" ¼ x 1.20mm - Encosto, assento e descansa pés estofados em espuma D26R com 70mm de espessura, revestidos em Courvim - Movimentos simultâneos do encosto e descansa pés comandados por meio de alavanca lateral - Reclinável em até 04 posições - Movimentos trendelemburger com reclino negativo - Indicada para hemodiálise, quimioterapia e coleta de sangue - Apoios dos braços em chapa de aço inox com altura ajustável por meio manípulos laterais - Acabamento em pintura epóxi com tratamento antiferruginoso Dimensão aprox.: 1600(C) x 750(L) x 550(A) mm – Capacidade Aprox.: Até 150Kg Largura Assento (Interno): 530 mm Registro MS: 80430259002 |

Com base na análise técnica comparativa, observa-se que o produto descrito **diverge de forma significativa dos requisitos obrigatórios estabelecidos**, conforme detalhado a seguir:



### PONTOS EM QUE O DESCRITIVO NÃO ATENDE AOS REQUISITOS EXIGIDOS

- Estrutura inferior ao exigido:

A estrutura é descrita como tubo de aço redondo de 1" x 1.20mm e 1" ¼ x 1.20mm, enquanto o edital exige mínimo de 1,5". Portanto, **NÃO ATENDE** à especificação mínima de diâmetro do tubo.

- Densidade da espuma abaixo do mínimo exigido:

Assento e encosto são em espuma D26R, enquanto o edital exige dupla camada de espuma com densidade mínima D33. Isso impacta diretamente no conforto e na durabilidade da poltrona.

- Reclinação limitada:

A Multimed Luxo oferece apenas 04 posições de reclino, enquanto o edital exige reclinável em diversas posições com possibilidade de travamento em qualquer ponto. Isso limita o ajuste fino necessário para conforto durante sessões prolongadas de hemodiálise.

- Sistema de acionamento não conforme:

A poltrona utiliza alavanca lateral, enquanto o edital exige acionamento instalado no braço com puxador, o que facilita o acesso ao paciente e à equipe.

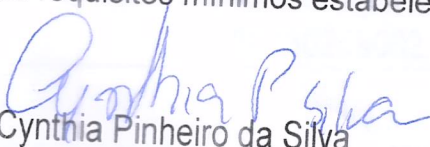
- Braços não conformes:

Os braços são em chapa de aço inox, com ajuste por manípulo, sem menção ao uso de espuma D28 ou zíper na parte traseira, como requerido no edital. Assim, **não atende ao conforto exigido para uso prolongado.**

### Conclusão Técnica

A poltrona RN11001L – Multimed Luxo **NÃO ATENDE** a diversos critérios essenciais do edital, especialmente no que diz respeito à estrutura física (tubo inferior a 1,5"), densidade das espumas (D26 vs D33/D28 exigidos), sistema de reclino (limitado a 4 posições e sem puxador no braço) e ausência de características obrigatórias nos apoios de braço.

Portanto, a proposta com este modelo deve ser desclassificada por não conformidade técnica com os requisitos mínimos estabelecidos.

  
Cynthia Pinheiro da Silva

Técnica em Enfermagem – Matrícula: 8618

Hospital Municipal de Januária