



FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO	
01788	2024

À
SS-6

Encaminhamos nesta data o presente expediente para que seja elaborado o parecer conclusivo sobre o(s) catálogo(s) acima discriminado(s) às fls. 116 até 117.

Lembramos que em caso de reprovação de qualquer uma da(s) marca(s) analisada(s), o parecer deverá informar o(s) motivo(s) pelo(s) qual(is) esta(s) não atende(m) à especificação constante do Edital.

Catálogo(s) encaminhado(s) junto com o presente expediente:

ITEM	MARCA	LICITANTE
1	DELLAMED	MIXSANTE HOSPITALAR LTDA
2	DELLAMED	MIXSANTE HOSPITALAR LTDA
3	DELLAMED	MIXSANTE HOSPITALAR LTDA
4	DELLAMED	MIXSANTE HOSPITALAR LTDA
5	ALO	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
6	ALO	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
7	ALO	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Após retornar para que possamos dar continuidade a sessão pública.

SA-211, 18 de setembro de 2024.

FRANCISCO MIGUEL SANTOS BEZERRA
Pregoeiro



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde
Centro Especializado em Reabilitação- CER IV

São Bernardo do Campo, 26 de setembro 2024.

Para: SS-6

Em resposta ao **processo 01788/2024** com relação a empresa licitante para o fornecimento de equipamento/material – Bengala longa branca e verde para deficiência visual com baixa visão ou com cegueira total segue esclarecimentos com relação ao catálogo apresentado pela empresa **AAZ SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA – marca ALO** com relação aos itens 5 a 7 do edital.

A empresa oferece catálogo com a descrição e a ilustração do seguinte material (BENGALA PARA DEFICIENTE VISUAL – verde – para baixa visão – ALO)

1) Descrição do material apresentado pela empresa licitante

Pequeno – 98cm

Médio – 113cm

Grande – 125cm

A medida padrão é feita a partir da altura que vai do chão até a extremidade inferior do osso esterno (processo xifoide), mas podem ocorrer variações dependendo da marcha.

Sobre o produto:

Extremamente leve, fácil de abrir, em alumínio, com película reflexiva. Elástico duplo entre os gomos, não descasca, cabo emborrachado, elástico de segurança e ponteira em nylon.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde
Centro Especializado em Reabilitação- CER IV

2) Ilustração do catálogo pela empresa licitante



Motivos que nos orientam a informar a não aceitação do equipamento apresentado pela empresa **AAZ SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA – marca ALO com relação aos itens 5 a 7 do edital:**

O material descrito em edital diz respeito a bengala para uso de pessoas com deficiência visual com baixa visão ou com cegueira total, sendo para tanto necessário os seguintes componentes técnicos:

1) Descrição do material do edital

Bengala de alumínio dobrável;

Medida: bengala branca 1,15m (item1); bengala branca 1,20m (item2); bengala branca 1,30m (item3); bengala verde 1,0m (item4); bengala verde 1,10m (item 5); bengala verde 1,20m (item 6); bengala verde 1,30m (item 7);

peso aproximado 300 gramas

Gomos são montados com cordões elásticos que garantem rigidez e segurança, evitando que se desmonte durante o uso.


Além disto, os elásticos permitem que a bengala seja dobrada, facilitando seu armazenamento em locais pequenos. Com cabo emborrachado com elástico de segurança para prender ao pulso. Com ponteira roller de nylon, corpo cilíndrico com diâmetro de 13 mm, com alta resistência.

Tinta resistente ao impacto.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde
Centro Especializado em Reabilitação- CER IV

2) Ilustração do material do edital

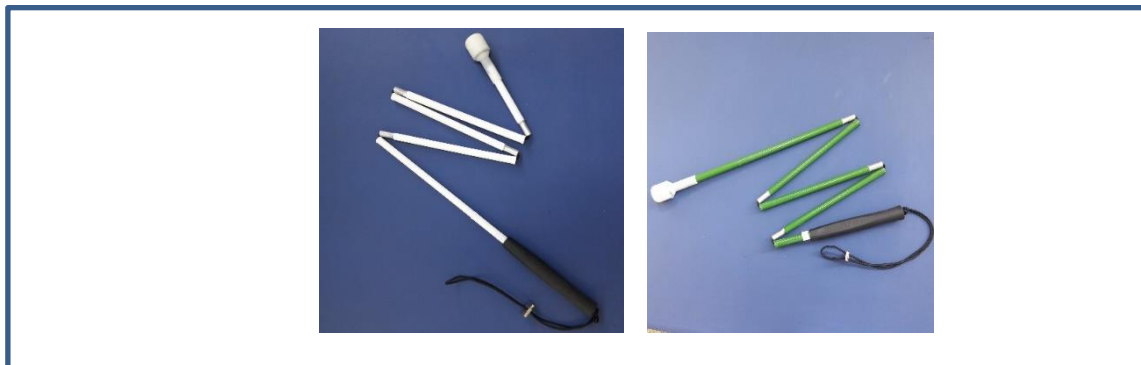

Em resumo:

- o equipamento apresentado pela empresa licitante diz respeito a equipamento sem ponteira em roller (necessitamos que seja com ponteira roller para melhor adequação a necessidade do paciente em piso tátil).
- o equipamento apresentado pela empresa licitante no catálogo indica uma bengala na cor verde que compreende o fornecimento para pacientes apenas com cegueira em um olho e/ou visão subnormal em outro. Necessitamos também de bengala na cor branca para usuários com cegueira ambos os olhos.
- os tamanhos informados pela empresa licitante classificam em pequeno (98cm); médio (113cm) e grande (125cm).

Necessitamos que seja fornecido os seguintes tamanhos e cores:

- Na cor branca, tamanhos: 1,15m; 120m, 130m
- Na cor verde os seguintes tamanhos: 1,0m, 1,10m; 1,20m e 1,30m

IMPORTANTE: necessitamos que a empresa licitante seja, PREFERENCIALMENTE, fornecedora DE TODOS os itens informados no edital (itens de 1 a 7) devido a necessidade de equipamentos em cores e tamanhos diferentes para atender a demanda de usuários do município de São Bernardo do Campo e suas necessidades clínicas e de reabilitação.

CRISTINA DE SOUZA SARDANO
Coordenação CER IV



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde
Centro Especializado em Reabilitação- CER IV

São Bernardo do Campo, 26 de setembro 2024.

Para: SS-6

Em resposta ao **processo 01788/2024** com relação a empresa licitante para o fornecimento de equipamento/material – Bengala longa branca e verde para deficiência visual com baixa visão ou com cegueira total segue esclarecimentos com relação ao catálogo apresentado pela empresa **MIXSANTE HOSPITALAR LTDA - marca DELLAMED com relação aos itens 1 a 4 do edital.**

A empresa oferece catálogo com a descrição e a ilustração do seguinte material (BENGALA TIPO D8 - 5396)


1) Descrição do material apresentado pela empresa licitante

Comprimento: 12,5cm
Largura 3,5cm
Altura 75 a 100cm
Peso líquido 0,3Kg
Garantia: 3 meses
Peças e componentes: 1 estrutura, pé ajustável, anel antirruído, pino click, ponteira 19mm (preta)
Funcionalidade: suporta até 10kg, 10 níveis de altura de regulação interior, estrutura em alumínio antiferrugem, ponteira com sistema antirruído.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde
Centro Especializado em Reabilitação- CER IV

2) Ilustração do catálogo pela empresa licitante

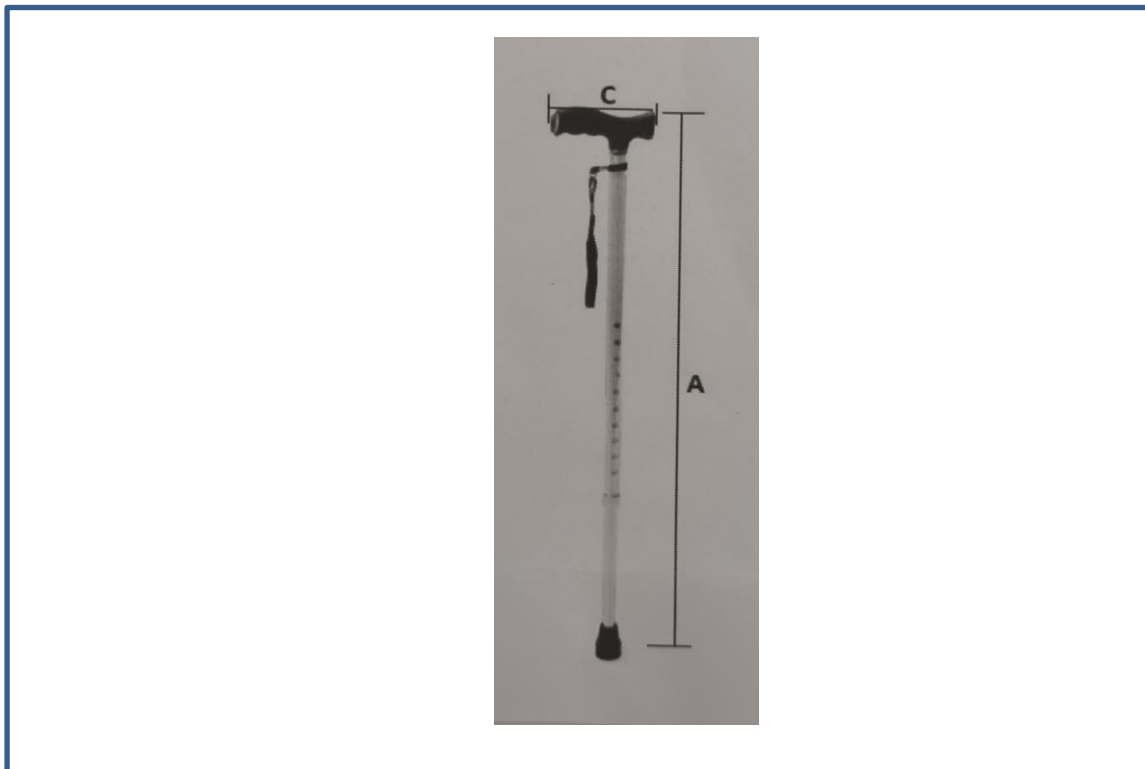

Apresentado pela empresa **MIXSANTE HOSPITALAR LTDA – marca DELLAMED com relação aos itens de 1 a 4 do edital.**

O material descrito em edital diz respeito a bengala para uso de pessoas com deficiência visual com baixa visão ou com cegueira total, sendo para tanto necessário os seguintes componentes técnicos:

1) Descrição do material do edital

Bengala de alumínio dobrável;

Medida: bengala branca 1,15m (item1); bengala branca 1,20m (item2); bengala branca 1,30m (item3); bengala verde 1,0m (item4); bengala verde 1,10m (item 5); bengala verde 1,20m (item 6); bengala verde 1,30m (item 7);

peso aproximado 300 gramas

Gomos são montados com cordões elásticos que garantem rigidez e segurança, evitando que se desmonte durante o uso.

Além disto, os elásticos permitem que a bengala seja dobrada, facilitando seu armazenamento em locais pequenos


Com cabo emborrachado com elástico de segurança para prender ao pulso. Com ponteira roller de nylon, corpo cilíndrico com diâmetro de 13 mm, com alta resistência.

Tinta resistente ao impacto.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde
Centro Especializado em Reabilitação- CER IV

2) Ilustração do material do edital

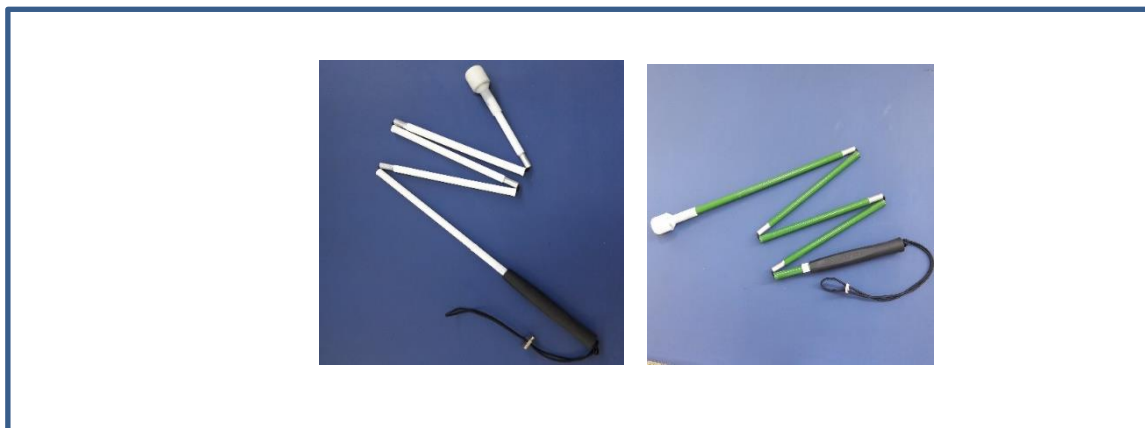

Em resumo: a empresa apresenta catálogo com equipamento distinto do proposto em edital e, portanto, para finalidade de uso e reabilitação também diferentes.

IMPORTANTE: necessitamos que a empresa licitante seja, PREFERENCIALMENTE, fornecedora DE TODOS os itens informados no edital (itens de 1 a 7) devido a necessidade de equipamentos em cores e tamanhos diferentes para atender a demanda de usuários do município de São Bernardo do Campo e suas necessidades clínicas e de reabilitação.

CRISTINA DE SOUZA SARDANO
Coordenação CER IV