

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Saúde

Departamento de Atenção Básica e Gestão do Cuidado – SS.1

São Bernardo do Campo, 24 de outubro de 2025

À SS-6

ASSUNTO: Avaliação de amostra referente ao Pregão Eletrônico PE nº019/2025- Avaliação para eventual aquisição de Tira Reagente para Glicemia Capilar para Secretária de Saúde

Sra. Diretora,

Em atenção ao encaminhamento solicitado, segue abaixo o parecer em relação a amostra apresentada pela proponente no Pregão acima citado.

EMPRESA	MARCA	REGISTRO	ITEM	PARECER	JUSTIFICATIVA
HOLPEMED COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	G. TECH VITA	80275310089	01	REPROVADA	NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL

Como pode ser observado, a amostra apresentada para o item acima citado foi REPROVADA por não atenderem as seguintes especificações do edital:

- Possui duas baterias de lítio, sendo que o edital pede uma única bateria;
- As fitas não vieram acondicionadas em frasco, diferindo do Edital;
- Não apresenta bolsa com zíper para transporte, diferindo do Edital;
- Não apresenta solução de controle com 3 níveis de concentração, constando número do registro, caso a empresa tenha solicitado.
- Garantia descrita no manual do usuário do produto é de período de 03 anos,

www.saobernardo.sp.gov.br | (11) 2630-6142 | (11) 2630-6172

diretoria.ss1@saobernardo.sp.gov.br

Rua João Pessoa, nº 59, 2º Andar, Centro – São Bernardo do Campo – CEP 09715-000

prefsbc

pref_sbc

sendo que o edital descreve que deve ser no mínimo 05 anos;

- Intervalo de contagem de hematócrito é entre 10 % a 65% diferindo do solicitado no Edital que é entre 20% a 60%;
- O tempo de leitura descrito no manual do usuário é de 6 segundos, diferindo do Edital que descreve que deve ser em até 5 segundos;
- Amostra armazena até 500 resultados de medições em sua memória, no Edital pede armazenamento até 1000 medições


Mantemo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos,



TAMIRES KELLEN SILVA CARVALHO

Enfermeira

COREN-SP: 625208

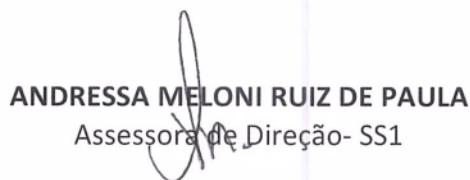

ANDRESSA MELONI RUIZ DE PAULA

Assessora de Direção- SS1