



Maria Eduarda Madeira Benini <eduarda.benini@unesp.br>

Polissonógrafo UNESP

Graziela Passareli Rosano <grazielapassareli@gmail.com>
Para: Maria Eduarda Madeira Benini <contratos.ict@unesp.br>

6 de setembro de 2024 às 16:52

Oi Maria Eduarda,

O valor do equipamento adulto e Neonatal é o mesmo.
Segue a proposta com o kit Neonatal incluso

Atenciosamente

Graziela Passareli Rosano
+55 11 98124-0679 Whatsapp

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Orçamento Polissonógrafo Finder Série 900 - Reduzido -Neonatal 2.pdf
312K

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO POLISSONÍGRAFO FINDER SÉRIE 900

PROPOSTA Nº:	---►
CLIENTE:	---► A/C Maria Eduarda
QUANTIDADE:	---► 01 (UM)
OBJETO:	---► POLISSONÍGRAFO FINDER SÉRIE 900
MODELO:	---► EQUIPAMENTO DENOMINADO FINDER SÉRIE 900
	---► MARCA MEDSUPPLY – PROCEDÊNCIA NACIONAL
	---► REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE 80986669001
	---► CERT. DE CALIBRAÇÃO E CONFORMIDADE INMETRO
	---► BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO - ANVISA

O Finder Série 900 é um equipamento registrador de sinais fisiológicos portátil, usado em pacientes adultos ou infantis, para diagnóstico de distúrbios do sono.

Tem como principal característica o registro de parâmetros respiratórios e oximetria (Polissonografia tipo III e IV).

Pode ser utilizado em hospitais que tenham centro diagnóstico, clínicas do sono, clínicas de neurofisiologia e em ambiente domiciliar, seguindo protocolos descritos pelo profissional.


Equipamento é alimentado com bateria e grava todos os sinais fisiológicos sincronizados em um cartão de memória removível (padrão SD).


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 01 Canal para Airflow/Termistor;
- 01 Canal para microfone de ronco;
- 01 Canal para sensor de oximetria (saturação de oxigênio, frequência cardíaca e curva plestimográfica);
- 01 Canal marcador;
- 02 Canais para esforço respiratório - Torácico e Abdominal;
- Sensor de posição - Integrado ao equipamento;
- 01 Porta de comunicação serial para PC;
- Entrada para cartão de memória MicroSD;
- 01 Porta de comunicação de dados serial;
- Bateria recarregável - Li-ion + carregador;
- Software de análise e relatórios automatizados.


Acessórios que Acompanham o Produto:

- Airflow/Termistor – 01 unidade;
- Microfone de Eletreto – 01 unidade;
- Faixa Torácica – 01 unidade;
- Faixa Abdominal – 01 unidade;
- Sensor de Oximetria – 01 unidade;
- Bateria Recarregável – 01 unidade;
- Carregador de Bateria – 01 unidade.
- obs: Kit de acessórios para Neonatal

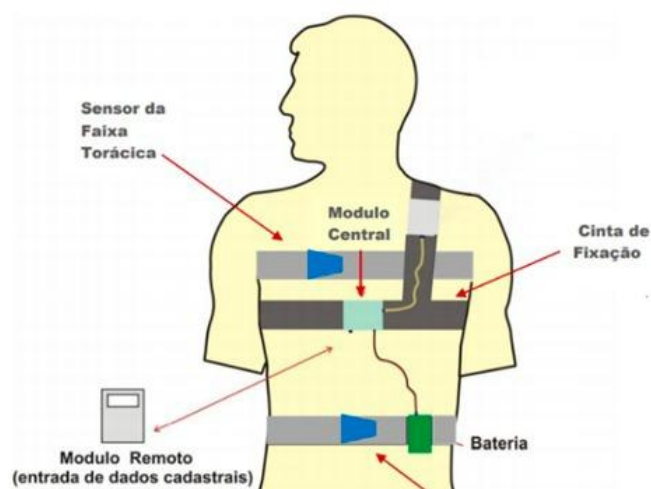

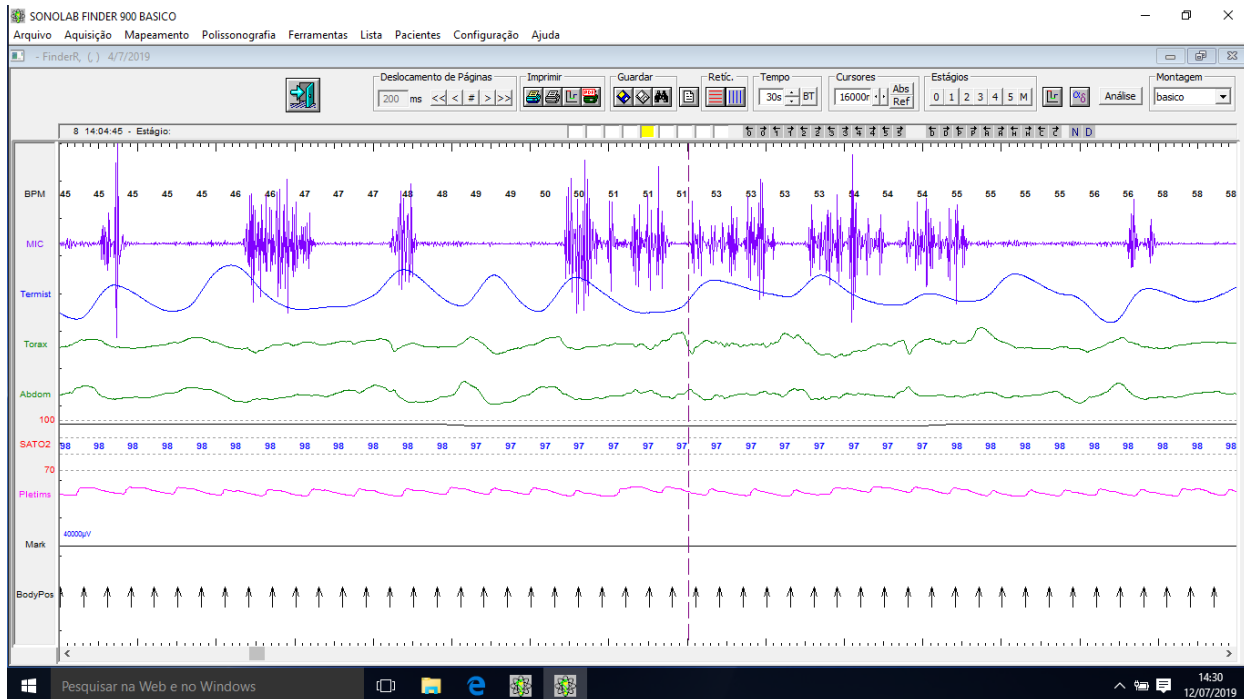

- Presença de Ronco Intenso.

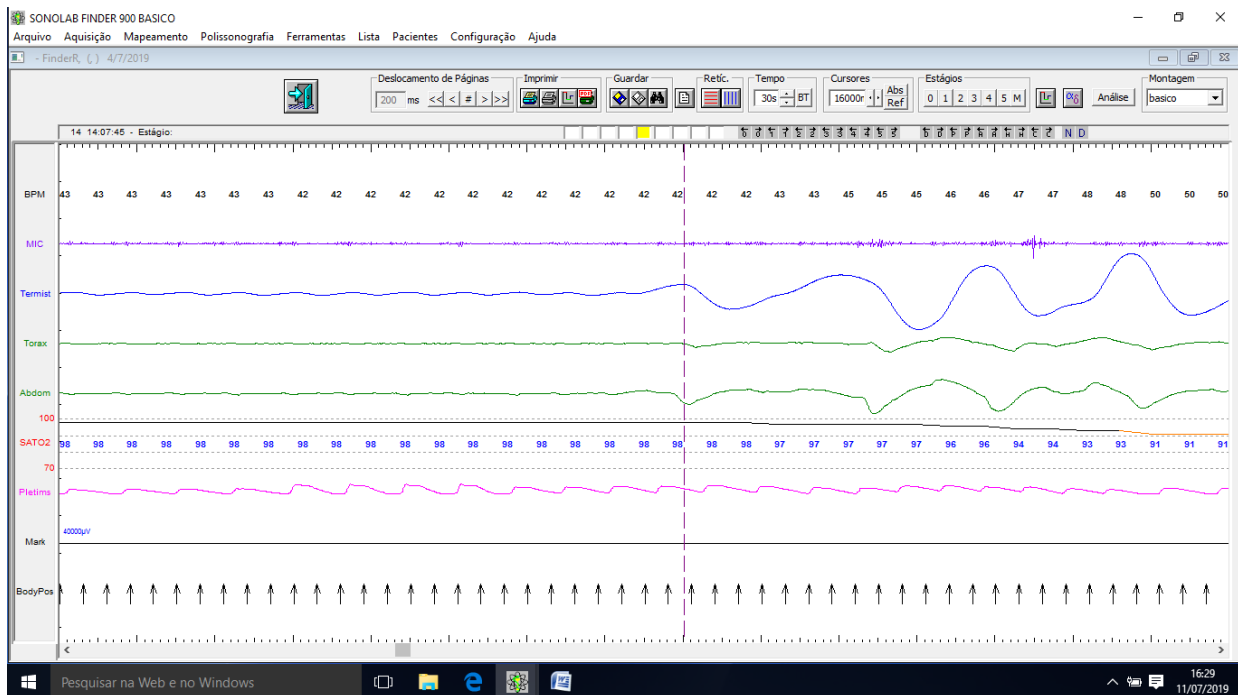

- Final de uma Apneia e início da dessaturação.

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO	
Polissonígrafo Finder Série 900	---► R\$ 12.500,00 - Parcelado (30% de entrada e mais 5 parcelas via boleto bancário) ---► R\$ 10.000,00 – PREÇO PROMOCIONAL - À vista – boleto ou depósito bancário ---► Cartão BNDES - Parcelamento em até 48x
Validade da Proposta:	---► 30 dias.
Despesas com frete:	---► Frete: FOB – consultar valores com departamento comercial ---► Prazo de entrega: 10 dias
Garantia:	---► 12 meses da data de instalação. Exceto uso indevido comprovado.
Treinamento operacional/instalação:	---► OFERECEMOS ACESSO REMOTO GRATUITO PARA INSTALAÇÃO DO SOFTWARE. Para treinamento presencial, deverá ser agendado previamente em local e data determinados pelo cliente assim que for recebido o equipamento, contato através do telefone – (11) 5510-7400 ou pelo e-mail – suporte@meditron.com.br . Despesas de locomoção e estadia serão pagas pelo cliente quando o treinamento for fora de Santa Rita do Sapucaí-MG e São Paulo-SP.
Assistência técnica:	---► Santa Rita do Sapucaí-MG e São Paulo-SP.

Cotia, SP, 06 de Setembro de 2024.

Graziela Passareli Rosano (Grazi)
grazielapassareli@gmail.com
diretoria@trate aqui.com
(55)(11) 98124-0679