



PARECER TÉCNICO DA AVALIAÇÃO CATALAGO

Pregão Eletrônico N° 22/2024, item 1.

Em análise a proposta da empresa LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTD, CNPJ: 04.187.384/001-54, através do Catalago / Certificado BPF ISO 13485:2016 R04-02 Rev 07 apresentado á comissão de apoia de licitação, foi possivel notar juntamente com o exigido tecnicamente no presente edital, que a mesma não atende algumas solicitações do termo de referencia, com os seguintes requisitos:

- Não especifica se apresenta rodízios giratórios de no mínimo 100mm com travas nas rodas dianteiras;
- Não especifica se apresenta sistema de segurança contra hipóxia que garanta uma mistura de no mínimo 25% de O₂;
- Não apresenta fluxo direto de oxigênio até 35l/m;
- Não especifica se apresenta capacidade de pelo menos 1500 ml, ajuste de pressão da válvula APL de 5 a 50 cmH₂O no sistema by-pass;
- Não apresenta tela 15" touch screen, com braço articulado permitindo ajustes no mínimo laterais de até 180°, ou seja não possui ajustes de posicionamento para melhor ergonomia; o manual e catalogo do fabricante não consta o braço articulado e a possibilidade de giro, e imagem do equipamento a tela é fixa; não possibilitando o solicitado;
- Não especifica se apresenta parâmetros Volume Corrente: Intervalo: 10~300 ml, para pacientes pediátricos; 100~1500ml, para pacientes adultos;
- Não apresenta Pressão Inspiratória: Intervalo: 5~70 cm H₂O; (proposta apresentada pelo fabricante 0,40 a 10 s) portanto em desacordo ao solicitado.
- Não apresenta Tempo Inspiratório: Intervalo: 0,1~10,0 s; (proposta apresentada pelo fabricante 0,4 a 10 segundos) portanto em desacordo ao solicitado.
- Não apresenta Relação I:E:, Intervalo: 4:1~1:10; foi proposto apresentada pelo fabricante 4:8 ~ 1:5; portanto em desacordo ao solicitado.

Por estar em desacordo com o solicitado prosseguimos com o seguinte parecer: DESCLASSIFICAR a presente empresa.

Sem mais para o momento, atenciosamente.


Terra Boa, 03 de Abril de 2024




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERRA BOA
ESTADO DO PARANÁ
C.N.P.J./M.F. 75.793.786/0001-40
Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves, 240 - Fone |44|3641-8000 - CEP 87240-000
E-mail: compras@terraboia.pr.gov.br
TERRA BOA - PARANÁ



Leuktenbergg Meneghetti da Costa
Secretário de Saúde
Município de Terra Boa

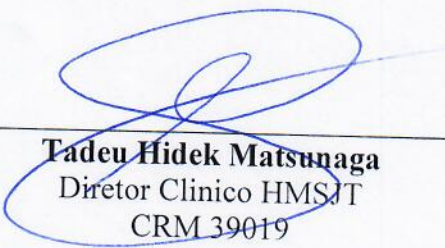


Tadeu Hidek Matsunaga
Diretor Clínico HMSJT
CRM 39019

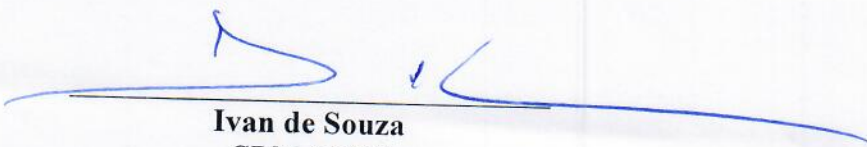

Ivan de Souza
CRM 11829
Médico



Ivone Cristina Fernandes Canassa
Diretora de Administrativa
HMSJT



Fabiana Fernandes da dos Maina
Diretora de Enfermagem
HMSJT



Lorena Martins Rodrigues Soler
Farmacêutica
HMSJT